

System BOND

PLNE AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM FARBENIA IHC A ISH

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BOND 7

(NIE JE určené na použitie v Číne)



CE

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

Právne vyhlásenia

Táto príručka sa vzťahuje na BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME a riadiace zariadenie systému BOND



Nie všetky moduly spracovania sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Ochranné známky

Leica a logo Leica sú registrované ochranné známky spoločnosti Leica Microsystems IR GmbH a používajú sa na základe licencie. BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer a Oracle sú ochranné známky spoločnosti Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Ostatné ochranné známky sú majetkom ich vlastníkov.

Copyright

Spoločnosť Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd vlastní autorské práva k tomuto dokumentu a akémukoľvek pridruženému softvéru. Podľa zákona je pred vytvorením kópie, reprodukcie, prekladu alebo konverzie dokumentácie alebo softvéru do elektronickej alebo inej strojovo čitateľnej formy, či už úplne alebo čiastočne, potrebné naše písomné povolenie.

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Identifikácia produktu

Dok. 49.7556.534 A06

Výrobca



Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mount Waverley VIC 3149
Australia

Dôležité informácie pre všetkých používateľov

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní systému BOND. Najnovšie informácie o produktoch a službách Leica Biosystems nájdete na www.leicabiosystems.com.

Vzhľadom na svoju politiku neustáleho zlepšovania si spoločnosť Leica Biosystems vyhradzuje právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce pojmy:

- Leica Biosystems – označuje spoločnosť Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
- BOND - platforma Leica Biosystems, ktorá obsahuje systémy BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME
- BOND-III – typ automatizovaného prístroja na farbenie v rámci imunohistochemického rozboru a in situ hybridizácie
- BOND-MAX – typ automatizovaného prístroja na farbenie v rámci imunohistochemického rozboru a in situ hybridizácie
- BOND-PRIME – typ automatizovaného prístroja na farbenie v rámci imunohistochemického rozboru a in situ hybridizácie
- Softvér BOND – softvérová aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu používatelia konfigurovať a prevádzkovať systém BOND-III, BOND-MAX alebo BOND-PRIME

Určení používateľa

Určeními používateľmi systému BOND sú primerane vyškolení laboratórni pracovníci.

Osoby prevádzkujúce modul spracovania BOND musia byť dostatočne zaškolené, aby sa zabezpečilo, že sa používa v súlade s týmto dokumentom, a pred prevádzkou modulu spracovania musia byť plne oboznámené s akýmikoľvek potenciálnymi nebezpečenstvami alebo nebezpečnými postupmi. Z modulu spracovania môžete odstrániť kryty alebo časti, iba ak je to uvedené v tejto príručke.

Inštalácia a opravy

Inštaláciu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál autorizovaný spoločnosťou Leica Biosystems.

Záručné reklamácie je možné uplatniť iba v prípade, ak bol produkt použitý pre špecifikovanú aplikáciu a prevádzkovaný podľa pokynov v tomto dokumente. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a/alebo nesprávnym použitím produktu ruší platnosť záruky. Spoločnosť Leica Biosystems nenesie zodpovednosť za takéto škody.

Hlásenie závažných udalostí

Výskyt akejkoľvek závažnej udalosti, ktorá viedla alebo môže viesť k smrti pacienta alebo používateľa alebo k dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta či používateľa, sa musí nahlásiť miestnemu zástupcovi spoločnosti Leica Biosystems a príslušnému miestnemu regulačnému orgánu.

Leica Biosystems protokoly

Systém BOND je dodávaný so súpravou preddefinovaných protokolov Leica Biosystems, ktoré nemožno upravovať alebo odstrániť. Tieto preddefinované protokoly boli overené spoločnosťou Leica Biosystems. Je však možné vytvoriť prispôbované protokoly skopírovaním a úpravou existujúcich preddefinovaných protokolov. Všetky prispôbované protokoly musia byť overené v súlade s miestnymi laboratórnymi postupmi a požiadavkami. Možnosť vytvoriť a uložiť protokol neznamena, že je vhodný na použitie. Zásady prevádzky a výkonnostné charakteristiky nájdete v príslušnom návode na použitie testu (IFU).

Vyhlásenie o bezpečnosti a ochrane osobných údajov používateľov

Spoločnosť Leica Biosystems rešpektuje a zaväzuje sa chrániť bezpečnosť a súkromie osobných údajov. Nižšie uvedené oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Leica Biosystems opisuje osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať, používať a uchovávať.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Držiteľ licencie bude pri spracúvaní osobných údajov pomocou systému BOND dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane osobných údajov a súkromia pomocou systému vrátane systému BOND-ADVANCE, okrem iného aj tým, že pred spracovaním svojich údajov vykoná všetky požadované oznámenia a získa všetky požadované súhlasy od pacientov a iných dotknutých osôb.

Nasledujúce osobné údaje sú uložené v databáze v riadiacom zariadení BOND:

- Meno pacienta
- Meno lekára
- Číslo záznamu
- Doctor comments (Komentáre lekára)
- Poznámka o pacientovi
- Komentár k sklíčku
- Case comments (Komentáre k prípadu)
- Údaje o používateľskom účte
- Názov úlohy
- Snímky sklíčok
- Komentáre k udalostiam systému LIS
- Obrazy prístroja

Nasledujúce správy systému BOND môžu bežne obsahovať chránené zdravotné údaje

- Udalosti cyklu
- Detaily cyklu
- Správa o prípade
- Stručná história sklíčok
- Export údajov
- Súhrn nastavenia sklíčka

Kontaktovanie spoločnosti Leica Biosystems

Ak potrebujete servis alebo podporu, obráťte sa na svojho miestneho zástupcu spoločnosti Leica Biosystems alebo pozrite si časť www.leicabiosystems.com.

Záznam revízie

Rev.	Vydaná	Dotknuté sekcie	Detail
A06	December 2023	Všetky	Drobné opravy
A05	-	-	Nezverejnené
A04	Január 2023	Všetky	Nová verzia pre systémy BOND so softvérom BOND 7.
A01 - A03	-	-	Nezverejnené

Všeobecné výstrahy

Výstrahy sú oznámenia o nebezpečenstvách, ktoré by mohli viesť k zraneniu osôb alebo k riziku straty, poškodenia alebo nesprávnej identifikácie vzoriek pacientov. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili zraneniu, poškodeniu, strate alebo chybnej identifikácii vzoriek pacienta a poškodeniu zariadenia.

Výstrahy používajú symboly s čiernym okrajom a žltým pozadím.

Všeobecné výstrahy týkajúce sa systému BOND sú uvedené nižšie. Ostatné výstrahy sú uvedené v príslušných sekciách príručky.

Používanie modulu spracovania



Na predchádzanie kontaminácii reagensí a sklíčok sa modul spracovania musí prevádzkovať v čistom prostredí tak, aby bol čo najviac zbavený prachu a pevných častíc.



Aby ste zabezpečili správnu prevádzku modulu spracovania, vložte každú nádobu na nebalené reagensie do jeho správnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne označených štítkoch s názvom. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu farbenia.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti [2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál](#)



Skontrolujte hladinu v nádobe na nebalený materiál a podľa potreby ich naplňte alebo vyprázdňte na začiatku každého dňa (v prípade potreby častejšie – pozrite si časť [12.2.1 Kontrola hladín v nádobách](#)). V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu farbenia pri odstraňovaní nádob, čo môže ohroziť farbenie.



Ak sa pri spracovaní v rámci prístroja BOND-MAX musí nádoba na nebalený materiál naplniť, vždy skontrolujte obrazovku **Protocol status** (Stav protokolu) a skontrolujte, či sa nádoba nepoužíva alebo nie je plánované jej použitie. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu spracovania sklíčok. Ihneď po naplnení nádobu vráťte – pozrite si časť [12.2.2.5 Počas cyklov](#). Aby sa predišlo tejto situácii, skontrolujte hladiny nádob na nebalený materiál medzi jednotlivými protokolmi – pozrite si časť [12.2.1 Kontrola hladín v nádobách](#).

Nádoby na nebalený materiál BOND-III sa nemusia na účely plnenia vyberať – pozrite si časť [12.2.2.1 Doplňenie nebalených reagensí – BOND-III](#). S cieľom vyhnúť sa tejto situácii každý deň skontrolujte hladinu v nádobách (častejšie, ak je to potrebné – pozrite si časť [12.2.1 Kontrola hladín v nádobách](#)).



Systém BOND nevyžaduje prístup k sieti na fungovanie a vykonanie určeného použitia. Ak chcete zabrániť škodlivému alebo neoprávnenému prístupu, nainštalujte systém BOND bez akéhokoľvek pripojenia k vašej sieti/infraštruktúram.

Ak chcete sieťové pripojenie, preferovanou metódou je pripojenie systému BOND k virtuálnej lokálnej sieti (VLAN) s bránou firewall. Prípadne môžete zaviesť a overiť svoje vlastné mechanizmy zabezpečenia siete v súlade so štandardnými prevádzkovými postupmi.

Ďalšie informácie nájdete v Príručke k informačným systémom pre systém BOND 5.1+ (49.6062.811).



Malvérová infekcia na riadiacom zariadení BOND môže viesť k neočakávanému správaniu v prevádzke vrátane deaktivácie modulov spracovania. Pred pripojením úložných zariadení USB k riadiacemu zariadeniu BOND sa uistite, že neobsahujú vírusy. Okrem toho berte na vedomie, že spoločnosť Leica Biosystems nenainštaluje žiadne antivírusové riešenie. Odporúčame vám nainštalovať vlastný podnikový antivírusový produkt. Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Leica Biosystems, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Riadiace zariadenia



MUSIA sa zaviesť a dodržiavať primerané laboratórne kontrolné opatrenia, aby sa zabezpečil vhodný výsledok farbenia pre každé sklíčko. Spoločnosť Leica Biosystems dôrazne odporúča umiestniť vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké sklíčka ako tkanivo pre pacienta.

Chemické nebezpečenstvá



Niektoré z reagensí používaných v imunohistochemickom rozbere a in situ hybridizácii sú nebezpečné. Pred pokračovaním sa uistite, že ste absolvovali primerané školenie pre tento postup:

- Pri manipulácii s reagensiami alebo čistení modulu spracovania používajte latexové alebo nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iný vhodný ochranný odev.
- S reagensiami a kondenzátom manipulujte a likvidujte ich v súlade so všetkými postupmi a štátnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratóriu.



Nádoby na reagencie sa môžu počas prepravy nakláňať, pričom zostanú zvyšky reagencie okolo uzáveru. Pri otváraní nádob na reagencie vždy používajte schválenú ochranu očí, rukavice a ochranný odev.



Potenciálne nebezpečné reagencie sa môžu zhromažďovať okolo zostáv na farbenie sklíčok a kontaminovať podnosy na sklíčka. Pri manipulácii s podnosmi na sklíčka vždy používajte schválený ochranný odev a rukavice.



Niektoré reagencie použité na moduloch spracovania BOND sú horľavé:

- Neumiestňujte plameň ani zdroj zapálenia do blízkosti modulov spracovania.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádob na nebalený materiál riadne uzavreté.



Moduly spracovania majú ohrievače a vyhrievané povrchy, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo vznietenia, ak sa do ich blízkosti umiestnia horľavé materiály.

- Na ohrievače ani blízko nich nekladte horľavé materiály.
- Na modul spracovania nekladte horľavé materiály.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.

Mechanické nebezpečenstvá



Pri zatváraní veka modulu spracovania buďte opatrní a uistite sa, že máte čisté ruky, aby nedošlo k zraneniu.



Počas prevádzky sa hlavný robot, nasávací sonda, pumpy injekčných striekačiek a roboty na nebalenú tekutinu (BOND-III) môžu pohybovať bez varovania a rýchlosťou, ktorá môže spôsobiť zranenie.

- Nepokúšajte sa otvoriť veko modulu spracovania, keď prebieha cyklus.
- Nepokúšajte sa obísť blokovanie, ktoré bráni činnosti modulu spracovania, keď je veko otvorené.
- Počas prevádzky sa uistite, že sú kryty pumpy injekčných striekačiek na svojom mieste.



Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklíčok a ich okolím. Môžu byť horúce a spôsobiť vážne popáleniny. Po ukončení činnosti nechajte zostavy na farbenie sklíčok a ich okolie vychladnúť dvadsať minút.



Ak chcete premiestniť modul spracovania na veľkú vzdialenosť alebo ho prepraviť na účely opravy alebo likvidácie, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka. Modul spracovania je ťažký a nie je navrhnutý tak, aby ho presúval jeden používateľ.



Skontrolujte, či sú počas normálnej prevádzky dvierka injekčných striekačiek zatvorené (BOND-MAX) alebo je nasadený kryt injekčných striekačiek (BOND-III). Ak dôjde k uvoľneniu injekčnej striekačky alebo príslušenstva injekčnej striekačky, môže z injekčnej striekačky vystreknúť reagentia pod tlakom.



Ak hlavný robot a/alebo roboty na nebalenú tekutinu naďalej fungujú dlhšie ako päť sekúnd po otvorení veka modulu spracovania, okamžite sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.



Pokiaľ je modul spracovania zapnutý, nepohybujte hlavným ramenom robota. Robot sa môže vyrovnať, čo má za následok zlé farbenie.

Ak bol robot presunutý: vypnite modul spracovania, počkajte 30 sekúnd a potom ho znovu inicializujte.



Pri vykonávaní úloh čistenia alebo údržby vždy vypnite modul spracovania (s výnimkou automatizovaných čistiacich úloh, ako je čistenie nasávacej sondy).



Roboty na nebalenú tekutinu BOND-III sa pohybujú pozdĺž zostáv na farbenie sklíčok, aby umožnili používateľom prístup na čistenie. Tento postup by mali vykonávať iba operátori, ktorí boli upozornení na potenciálne nebezpečenstvo a ktorí absolvovali primeranú odbornú prípravu.



Zostavy na farbenie sklíčok obsahujú pohyblivé časti, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie. Počas prevádzky modulu spracovania udržiavajte prsty mimo otvoru zostavy na farbenie sklíčok.

Predtým, ako sa pokúsite ručne odomknúť zostavy na farbenie sklíčok: vypnite hlavný vypínač modulu spracovania, vypnite sieťovú zástrčku a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.



Modul pumpy injekčných striekačiek (BOND-III) je ťažký a po uvoľnení môže spadnúť. Tento postup by mali vykonávať iba operátori, ktorí boli upozornení na potenciálne nebezpečenstvo a ktorí absolvovali primeranú odbornú prípravu.



Na zdvihnutie modulu spracovania nepoužívajte dve čierne rukoväti na zadnom obale systému BOND-III.

Elektrické nebezpečenstvá



Neodstraňujte kryty modulu spracovania ani sa nesnažte získať prístup k vnútorným komponentom. Vo vnútri modulu spracovania BOND sú nebezpečné napätia a tieto úlohy by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici schválení spoločnosťou Leica Biosystems.



Nemeňte prevádzkové napätie modulu spracovania. Ak je modul spracovania pripojený k nesprávnejmu napájaciemu napätiu, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu. Ak chcete nastavenie zmeniť, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.



Modul spracovania musí byť pripojený k uzemnenej sieťovej zásuvke a musí byť umiestnený tak, aby pracovníci mohli ľahko odpojiť sieťový kábel bez toho, aby museli pohybovať modulom spracovania.



Poistky neprepájajte ani neskratujte.

Pred výmenou poistiek modul spracovania vypnite a odpojte napájací kábel. Poistky vymeňte iba za štandardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Všeobecné upozornenia

Upozornenia sú oznámenia o nebezpečenstvách, ktoré by mohli viesť k poškodeniu vybavenia systému BOND alebo mať iné nepriaznivé následky, ktoré neohrozujú ľudí.

Upozornenia používajú symboly s čiernym okrajom a bielym pozadím:

Všeobecné upozornenia BOND sú uvedené nižšie. Ostatné upozornenia sú uvedené v príslušných sekciách príručky.

Nebezpečenstvá pri inštalácii



Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom obale modulu spracovania. Nezakrývajte tiež vetracie otvory umiestnené na dverkách injekčných striekačiek (BOND-MAX).

Prevádzkové nebezpečenstvá



Umiestnite všetky časti štítka sklíčka ku všetkým okrajom sklíčka. Odkrytý lepkavý povrch môže spôsobiť, že sa štítok sklíčka (a posúvač) prilepí na obal alebo iné zariadenie a poškodí sklíčko Covertile.



Nevyberajte malý kryt snímača hladiny kvapaliny z nádoby na nebalený materiál (BOND-MAX), pretože sa môže poškodiť. Nádoby na nebalený materiál vyprázdňujte a doplňujte iba cez veľký kryt na plnenie/vyprázdňovanie.



Všetky vymeniteľné komponenty čistite iba rukou. V automatickej umývačke riadu neumývajte žiadne súčasti, aby ste predišli poškodeniu. Nečistite žiadnu časť rozpúšťadlami, tvrdými ani drsnými čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými či drsnými utierkami.



Nepoužívajte vatové tyčinky ani iné aplikátory s hrotmi z bavlny na čistenie vnútorných otvorov premývacieho bloku alebo v mazacích stĺpkoch zostavy na farbenie sklíčok, pretože sa môže vatový konček uvoľniť a spôsobiť upchatie.



Nádoby na nebalený materiál nenasúvajte späť na svoje miesto, pretože to môže poškodiť nádobu a snímač kvapaliny.



Nepoužívajte poškodené sklíčka. Pred vložením do modulu spracovania sa uistite, že sú všetky sklíčka správne zarovnané na podložkách a že sú všetky krycie sklíčka Covertile správne umiestnené (pozrite si časť [2.6.2 Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles](#)).



Pred spustením cyklu alebo inicializáciou modulu spracovania sa uistite, že je modul injekčných striekačiek (BOND-III) úplne zatvorený (pozrite si časť [12.4.1 Ručné odomykanie zostáv na farbenie sklíčok](#)). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu injekčných striekačiek počas prevádzky.



Pred čistením alebo odstránením hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenú tekutinu (BOND-III) v pôvodnej polohe v zadnej časti modulu spracovania a aby neboli umiestnené pred zostavami na farbenie sklíčok.

Nebezpečenstvo súvisiace s reagentami



Ak sa povolí, aby sa vzájomne nekompatibilné roztoky dostali navzájom do styku, môžu sa vyskytnúť neuspokojivé výsledky farbenia a potenciálne poškodenie modulu spracovania. Obráťte sa na spoločnosť Leica Biosystems, aby určila, či sú roztoky kompatibilné.



Na moduloch spracovania BOND nepoužívajte xylén, chloroform, acetón, silné kyseliny (napr. 20 % HCl), silné zásady (napr. 20 % NaOH). Ak sa niektorá z týchto chemikálií vyleje na modul spracovania BOND alebo v jeho blízkosti, prístroj okamžite vyčistite 70 % etanolom, aby ste predišli poškodeniu krytov modulu spracovania.



Na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX používajte iba roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution na moduloch spracovania BOND-PRIME. Nepoužívajte xylén, náhradky xylénu a iné reagenty, ktoré môžu degradovať časti systému BOND a spôsobiť únik tekutiny.

Regulačné vyhlásenia

Zamýšľané použitie



BOND automatizuje klinické protokoly na imunofarbenie patologických vzoriek nachádzajúcich sa na mikroskopických sklíčkach. Mikroskopické sklíčka následne podstúpia interpretáciu kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom na pomoc pri diagnostike.

Zhoda s FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy A podľa časti, 15 podčasti B pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením, keď sa zariadenie prevádzkuje v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na obsluhu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej štvrti pravdepodobne spôsobí škodlivé rušenie. V takom prípade bude používateľ povinný rušenie na svoje vlastné náklady opraviť.

Na zachovanie zhody používajte iba káble dodávané s prístrojom.



VÝSTRAHA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Leica Biosystems, môžu zrušiť platnosť oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Označenie CE



Označenie CE označuje súlad s platnými smernicami EÚ, ako je to uvedené vo vyhlásení výrobcu o zhode.

Pokyny pre diagnostické vybavenie in vitro na profesionálne použitie

Toto IVD zariadenie spĺňa požiadavky na emisie a odolnosť podľa noriem IEC 61326 časť 2-6 a IEC 60601 časť 1-2.

Elektromagnetické prostredie by sa malo vyhodnotiť pred uvedením zariadenia do prevádzky.

Toto zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti zdrojov silného elektromagnetického žiarenia (napr. netienené úmyselné zdroje RF), ktoré môžu rušiť správnu činnosť.



VÝSTRAHA: Toto zariadenie bolo navrhnuté a testované podľa normy CISPR 11 triedy A. V domácom prostredí môže spôsobiť rádiové rušenie. V takom prípade bude pravdepodobne potrebné prijať opatrenia na zníženie tohto rušenia.

Regulačné požiadavky na počítač: uvedené na zozname UL (UL 60950), certifikované podľa normy IEC 60950.



POZOR: Federálny zákon obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj zdravotníckym profesionálom s licenciou alebo predaj na základe ich objednávok.

Klasifikácia zariadení podľa CISPR 11 (EN 55011)

Toto zariadenie je klasifikované ako skupina 1 triedy A podľa CISPR 11 (EN 55011). Vysvetlenie skupiny a triedy je opísané nižšie.

Skupina 1 – platí pre všetky zariadenia, ktoré nie sú klasifikované ako zariadenie skupiny 2.

Skupina 2 – platí pre všetky vysokofrekvenčné zariadenia ISM, v ktorých sa vysokofrekvenčná energia vo frekvenčnom rozsahu 9kHz až 400GHz úmyselne generuje a používa alebo len používa vo forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby na spracovanie materiálov alebo na účely inšpekcie/analýzy.

Trieda A – platí pre všetky zariadenia vhodné na použitie vo všetkých zariadeniach iných ako domácnosť a tých, ktoré sú priamo pripojené k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá zásobuje budovy používané na domáce účely.

Trieda B – platí pre všetky zariadenia vhodné na použitie v domácich prevádzkach a v zariadeniach priamo pripojených k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá zásobuje budovy používané na domáce účely.

Vymedzenie pojmov

ISM: priemyselné, vedecké a lekárske

RF: rádiová frekvencia

Slovník symbolov

Táto časť popisuje regulačné a bezpečnostné symboly používané na označení produktu.

Regulačné symboly

Vysvetlenie regulačných symbolov používaných pre produkty spoločnosti Leica Biosystems.












Tento slovník poskytuje obrázky symbolov, ako sú uvedené v príslušných normách, niektoré symboly sa však môžu líšiť farbou.

Nasleduje zoznam symbolov použitých na označení výrobku a ich význam.

ISO 15223-1





Zdravotnícke pomôcky – symboly používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a poskytovanie informácií – časť 1: Všeobecné požiadavky.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	ISO 15223-1	5.1.1	Výrobca Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky.
	ISO 15223-1	5.1.2	Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve Označuje splnomocneného zástupcu v Európskom spoločenstve.
	ISO 15223-1	5.1.3	Dátum výroby Označuje dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená.
	ISO 15223-1	5.1.4	Spotrebovať do (dátum expirácie) Označuje dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nebude používať.
	ISO 15223-1	5.1.5	Kód šarže Označuje kód šarže výrobcu, aby bolo možné identifikovať šaržu alebo dávku.
	ISO 15223-1	5.1.6	Katalógové číslo/referenčné číslo Označuje katalógové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať zdravotnícku pomôcku.
	ISO 15223-1	5.1.7	Sériové číslo Označuje sériové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať konkrétnu zdravotnícku pomôcku.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	ISO 15223-1	5.1.8	Dovozca Označuje subjekt dovážajúci zdravotnícku pomôcku do Európskej únie.
	ISO 15223-1	5.1.9	Distribútor Označuje subjekt distribuujúci zdravotnícku pomôcku v regióne.
	ISO 15223-1	5.3.1	Krehké, manipulujte opatrne Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa môže zlomiť alebo poškodiť, ak sa s ňou nezaobchádza opatrne.
	ISO 15223-1	5.3.4	Chráňte pred dažďom Označuje, že prepravný balík sa má uchovávať mimo dažďa a v suchých podmienkach.
	ISO 15223-1	5.3.7	Teplotné obmedzenie Označuje teplotné obmedzenia, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.
	ISO 15223-1	5.4.2	Nepoužívajte opakovane Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená na jedno použitie, alebo na použitie u jedného pacienta počas jedného zákroku.
	ISO 15223-1	5.4.3	Prečítajte si návod na použitie Označuje, že je potrebné, aby si používateľ preštudoval návod na použitie.
	ISO 15223-1	5.4.4	Pozor Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal návod na použitie s dôležitými varovnými informáciami, ako sú varovania a bezpečnostné opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť uvedené na samotnej zdravotníckej pomôcke.
	ISO 15223-1	5.5.1	Diagnostická zdravotná pomôcka in vitro Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená na použitie ako diagnostická zdravotná pomôcka in vitro.






ISO 7000







Grafické symboly používané na zariadení – registrované symboly.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	ISO 7000	1135	Recyklácia Označuje, že označená položka alebo jej materiál je súčasťou procesu obnovy alebo recyklácie.
	ISO 7000	1640	Technická príručka; návod na servis Identifikuje miesto, kde je príručka uložená, alebo informácie, ktoré sa týkajú pokynov na servis pomôcky. Na označenie toho, že pri údržbe zariadenia v blízkosti umiestnenia symbolu je potrebné vziať do úvahy servisnú príručku alebo návod.
	ISO 7000	2594	Otvorená ventilácia Identifikuje ovládač, ktorý umožňuje prienik vzduchu do interiéru.
	ISO 7000	3650	USB Identifikuje port alebo konektor ako konektor, ktorý spĺňa všeobecné požiadavky univerzálnej sériovej zbernice (USB). Označuje, že zariadenie je pripojené k portu USB alebo je kompatibilné s portom USB.







IEC 60417







Grafické symboly používané na zariadení.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	IEC 60417	5007	On (Zap) Na označenie zapojenia do siete, aspoň v prípade sieťových spínačov alebo ich pozícií, a v prípadoch, keď ide o bezpečnosť
	IEC 60417	5008	Off (Vyp) Indikuje odpojenie od elektrickej siete, minimálne pre sieťové vypínače alebo ich polohy, a všetky prípady, keď ide o bezpečnosť
	IEC 60417	5009	Pohotovostný režim Určuje prepínač alebo polohu spínača, pomocou ktorej je časť zariadenia zapnutá, aby bola uvedená do pohotovostného stavu
	IEC 60417	5016	Poistka Identifikuje poistkové skrine alebo ich umiestnenie.
	IEC 60417	5019	Ochranné uzemnenie: ochranné uzemnenie Svorka, ktorá je určená na pripojenie k externému vodiču na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo svorka ochrannej (uzemňovacej) elektródy.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	IEC 60417	5032	Jednofázový striedavý prúd Označuje na typovom štítku, že zariadenie je vhodné len pre striedavý prúd; na identifikáciu príslušných svoriek.
	IEC 60417	5134	Elektrostatické citlivé zariadenia Balíky obsahujúce pomôcky citlivé na elektrostatický výboj alebo zariadenie alebo konektor, ktorý nebol testovaný na odolnosť voči elektrostatickému výboju.
	IEC 60417	5988	Počítačová sieť Identifikuje samotnú počítačovú sieť alebo na označenie pripojovacích terminálov počítačovej siete.
	IEC 60417	6040	Výstraha: Ultrafialové žiarenie Dávajte pozor na prítomnosť UV svetla v kryte výrobku, ktorá môže byť dostatočne veľká na to, aby pre operátora predstavovala riziko. Pred otvorením vypnite UV lampu. Počas servisu používajte UV žiarenie a ochranu pokožky.
	IEC 60417	6057	Pozor: pohyblivé časti Inštruktážny ochranný kryt, ktorý chráni pred pohyblivými časťami.
	IEC 60417	6222	Informácie; všeobecné Identifikuje kontrolu na preskúmanie stavu pomôcky, napr. multifunkčných kopírovacích prístrojov

Iné symboly a označenia

Symbol	Norma/Nariadenie	Opis
	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	<p>Len na lekársky predpis</p> <p>Uznané americkým úradom FDA ako alternatíva k upozorneniu: Federálny zákon obmedzuje predaj tohto zariadenia na predaj zdravotníckym profesionálom s licenciou alebo predaj na základe ich objednávok.</p>
	Vyhlásenie o zhode prístroja uvádza smernice, ktorým systém vyhovuje.	<p>Európska zhoda</p> <p>Vyhlásenie o zhode prístroja uvádza smernice, ktorým systém vyhovuje.</p>
	Smernica 2012/19/ES EÚ: odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)	<p>Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)</p> <p>Elektronický produkt by sa nemal likvidovať ako netriedený odpad, ale musí sa odoslať do zberných zariadení na recykláciu a recykláciu.</p> <p>Prítomnosť tohto označenia znamená, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zariadenie bolo uvedené na európsky trh po 13. auguste 2005. • Zariadenie sa nesmie likvidovať prostredníctvom zberného systému komunálneho odpadu žiadneho členského štátu Európskej únie. <p>Zákazníci musia poznať a dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa správnej dekontaminácie a bezpečnej likvidácie elektrických zariadení.</p>
	AS/NZS 4417.1	<p>Označenie zhody s predpismi (RCM)</p> <p>Označuje súlad s požiadavkami austrálskeho úradu pre komunikačné médiá (ACMA) (bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita) pre Austráliu a Nový Zéland.</p>
	Elektronický priemyselný štandard Čínskej ľudovej republiky SJ/T11364	<p>Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS 2)</p> <p>Označuje, že tento elektronický informačný výrobok obsahuje určité toxické alebo nebezpečné prvky a môže sa bezpečne používať počas obdobia používania ochrany životného prostredia. Číslo uprostred loga označuje dobu používania produktu z hľadiska ochrany životného prostredia (v rokoch). Vonkajší kruh označuje, že výrobok možno recyklovať. Logo tiež znamená, že výrobok by sa mal recyklovať ihneď po uplynutí doby na ochranu životného prostredia. Dátum na štítku označuje dátum výroby.</p>
	Elektronický priemyselný štandard Čínskej ľudovej republiky SJ/T11364	<p>Obmedzenie používania nebezpečných látok (RoHS 2)</p> <p>Označuje, že tento elektronický informačný produkt neobsahuje žiadne nebezpečné látky alebo neprekračuje limity koncentrácie uvedené v GB/T 26572. Ide o ekologický výrobok, ktorý možno recyklovať.</p>
	Hlava 47 Kódex federálnych predpisov Spojených štátov amerických, časť 15	<p>Federálna komisia pre komunikáciu (FCC)</p> <p>Tento produkt bol testovaný a vyhovuje obmedzeniam podľa časti 15 pravidiel FCC.</p>

Symbol	Norma/Nariadenie	Opis
	–	Certifikačná známka spoločnosti Underwriters Laboratory (UL) Spoločnosť Underwriter Laboratories potvrdila, že uvedené produkty spĺňajú bezpečnostné požiadavky USA aj Kanady.
	Medzinárodné CSA	Uvedenie zariadenia v testovacej agentúre skupiny CSA Skupina CSA potvrdila, že uvedené produkty spĺňajú bezpečnostné požiadavky USA aj Kanady.
	–	Uvedenie zariadenia v testovacej agentúre Intertek Testovacia agentúra Intertek potvrdila, že uvedené produkty spĺňajú bezpečnostné požiadavky USA aj Kanady.
	Nariadenie o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (IVDO) zo 4. mája 2022.	Švajčiarsky autorizovaný zástupca Označuje švajčiarskeho autorizovaného zástupcu.
	–	Rozsah relatívnej vlhkosti Uveďte prijateľné horné a dolné limity relatívnej vlhkosti pri preprave a skladovaní. Tento symbol je doplnený príslušnými limitmi relatívnej vlhkosti.
	–	Nepripojený port Tento produkt má na injekčnej pumpe nepripojený port.





Bezpečnostné symboly

Vysvetlenie bezpečnostných symbolov používaných pre produkty spoločnosti Leica Biosystems.

ISO 7010

Grafické symboly – bezpečnostné farby a bezpečnostné značky – registrované bezpečnostné značky.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	ISO 7010	W001	Všeobecné upozornenie Označuje, že je potrebné, aby si používateľ prečítal návod na použitie s dôležitými varovnými informáciami, ako sú varovania a bezpečnostné opatrenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť uvedené na samotnej zdravotníckej pomôčke.
	ISO 7010	W004	Výstraha: laserový lúč Nebezpečenstvo laserového žiarenia. Možnosť vážneho poškodenia očí. Vyvarujte sa priameho kontaktu očí s laserovými lúčmi.
	ISO 7010	W009	Výstraha: biologické nebezpečenstvo Biologické nebezpečenstvo. Potenciálne vystavenie biologickému riziku. Postupujte podľa pokynov v sprievodnej dokumentácii, aby ste zabránili expozícii.
	ISO 7010	W012	Upozornenie: riziko úrazu elektrickým prúdom Elektrické nebezpečenstvo. Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom. Postupujte podľa pokynov v sprievodnej dokumentácii, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu vybavenia.
	ISO 7010	W016	Výstraha: toxický materiál Nebezpečenstvo toxicity. Možné vážne zdravotné následky pri nedodržaní náležitých postupov manipulácie s chemikáliami. Pri manipulácii s reagentami používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.
	ISO 7010	W017	Výstraha: horúci povrch Nebezpečenstvo tepla. Horúce povrchy spôsobia pri dotyku popáleniny. Nedotýkajte sa častí označených týmto symbolom.
	ISO 7010	W020	Výstraha: ostrý prvok Nadzemná prekážka. Dávajte pozor, aby ste sa vyhli nárazu do prekážky nad hlavou alebo ste do nej nevkročili.
	ISO 7010	W021	Výstraha: horľavý materiál Nebezpečenstvo požiaru. Horľavé materiály sa môžu vznietiť, ak sa nedodržiavajú príslušné bezpečnostné opatrenia.

Symbol	Norma/Nariadenie	Referencia	Opis
	ISO 7010	W022	Výstraha: ostrý prvok Ostrý prvok. Dávajte pozor, aby ste sa neporanili ostrými predmetmi (napr. ihly, čepele).
	ISO 7010	W023	Výstraha: žieravá látka Chemické nebezpečenstvo spôsobené leptavou látkou. Pri nedodržaní náležitých bezpečnostných opatrení hrozia vážne zdravotné následky. Vždy noste ochranný odev a rukavice. Rozliaty produkt okamžite vyčistite pomocou štandardných laboratórných postupov.
	ISO 7010	W024	Výstraha: pomliaždenie rúk Nebezpečenstvo pomliaždenia. Ruky alebo časti tela sa môžu pomliaždiť zatváraním mechanických častí zariadenia.
	ISO 7010	W072	Výstraha: Nebezpečenstvo pre životné prostredie Nebezpečenstvo pre životné prostredie. Látka alebo zmes, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Obsah

1	Úvod	30
1.1	Prehľad systému	30
1.2	Získanie pomoci	31
1.3	Prvé kroky	32
1.4	Spustenie protokolu – pracovné postupy	33
1.4.1	BOND-III a BOND-MAX	33
1.4.2	BOND-PRIME	35
2	Hardvér	36
2.1	Systém BOND	37
2.1.1	Doplnkové produkty BOND	38
2.2	Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX	39
2.2.1	Hlavné komponenty	39
2.2.2	Inicializácia modulu spracovania	44
2.2.3	Veko	44
2.2.4	Hlavný robot a snímač identifikátorov	45
2.2.5	Zostavy na farbenie sklíčok	45
2.2.6	Predný kryt	47
2.2.7	Priehradka na nádoby na nebalený materiál	50
2.2.8	Nasávací sonda	57
2.2.9	Premývací blok a zmiešavacia stanica	58
2.2.10	Roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III)	59
2.2.11	Injekčné striekačky	61
2.2.12	Vypínač	62
2.2.13	Zadný kryt	62
2.3	Riadiace zariadenie a terminály BOND	65
2.4	Ručná čítačka čiarových kódov	66
2.4.1	Používanie ručnej čítačky čiarových kódov	66
2.5	Značkovač sklíčok	67
2.6	Pomocné vybavenie	68
2.6.1	Sklíčka	68
2.6.2	Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles	69

2.6.3	Systémy a nádoby na reagenty	71
2.7	Premiestnenie modulu spracovania	72
2.8	Vyradenie z prevádzky a likvidácia prístroja	72
3	Prehľad softvéru (na riadiacom zariadení BOND)	73
3.1	Architektúra systému	74
3.1.1	Konfigurácia s jednou stanicou	74
3.1.2	BOND-ADVANCE	75
3.2	Spustenie a vypnutie softvéru BOND	77
3.2.1	Spustenie softvéru BOND	77
3.2.2	Nastavenie alebo zmena PIN kódu modulu spracovania BOND-PRIME	78
3.2.3	Vypnutie softvéru BOND	80
3.3	Úlohy používateľa	80
3.4	Prehľad rozhrania klinického klienta	81
3.4.1	Panel funkcií	81
3.4.2	Karty modulu spracovania	83
3.4.3	Zoradenie v tabuľkách	83
3.4.4	Formát dátumu	83
3.5	Ovládací panel BOND-ADVANCE	84
3.5.1	Stav zostavy na farbenie sklíčok	85
3.6	Oznámenia, výstrahy a alarmy	86
3.7	Správa	87
3.7.1	Staré správy	87
3.8	Pomocník	88
3.9	Informácie o systéme BOND	89
3.10	Definície údajov systému BOND	90
3.10.1	Aktualizácie definícií údajov	90
3.11	Aktualizácia softvéru	91
4	Rýchly štart	92
4.1	BOND-III a BOND-MAX	92
4.1.1	Predbežné kontroly a uvedenie do prevádzky	93
4.1.2	Kontroly protokolov a reagentov	93
4.1.3	Nastavenie sklíčok	94
4.1.4	Vkladanie reagentov	100

4.1.5	Spustenie protokolu	103
4.1.6	Dokončenie	104
4.2	BOND-PRIME	105
4.2.1	Predbežné kontroly a uvedenie do prevádzky	105
4.2.2	Kontroly protokolov a reagencií	105
4.2.3	Nastavenie sklíčok	105
4.2.4	Na module spracovania BOND-PRIME:	105
5	Stavové obrazovky BOND-III a BOND-MAX (na riadiacom zariadení BOND)	106
5.1	Stavová obrazovka systému	107
5.1.1	Karty modulu spracovania	108
5.1.2	Stav hardvéru	109
5.1.3	Stav reagencií	111
5.1.4	Informácie o sklíčku	120
5.1.5	Identifikácia sklíčok v systéme	123
5.1.6	Ukazovateľ priebehu cyklu	126
5.1.7	Spustenie alebo zastavenie cyklu	130
5.1.8	Odložený štart	131
5.2	Obrazovka stavu protokolu	132
5.3	Obrazovka údržby	133
5.3.1	Správa o údržbe	135
6	Nastavenie sklíčka (na riadiacom zariadení BOND)	137
6.1	Obrazovka nastavenia sklíčka	138
6.2	Práca s kontrolnými vzorkami	139
6.2.1	Kontrolná vzorka tkaniva	139
6.2.2	Kontrolná reagentia	140
6.3	Práca s prípadmi	140
6.3.1	Kontroly prípadov a informácie o aktívnych prípadoch	140
6.3.2	Identifikácia prípadu	142
6.3.3	Pridanie prípadu	142
6.3.4	Duplikácia, obnovenie a expirácia prípadu	143
6.3.5	Úpravy prípadu	144
6.3.6	Kopírovanie prípadu	145
6.3.7	Možnosť celodenného prípadu	146

6.3.8	Správa o prípade	146
6.4	Správa lekárov	147
6.5	Práca so sklíčkami	147
6.5.1	Opis polí sklíčka a kontrol	148
6.5.2	Vytvorenie sklíčka	149
6.5.3	Kopírovanie sklíčka	152
6.5.4	Úpravy sklíčka	152
6.5.5	Odstránenie sklíčka	152
6.5.6	Manuálna identifikácia sklíčka	153
6.5.7	Pridanie panela sklíčok	153
6.5.8	Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach	154
6.6	Označovanie sklíčok	155
6.6.1	Tlač štítkov a nalepenie na sklíčka	156
6.6.2	Identifikátory sklíčok a identifikátory štítkov	158
6.7	Súhrnná správa o nastavení sklíčok	159
6.8	Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu	160
6.8.1	Vytvorenie nových prípadov a/alebo sklíčok po nasnímaní	160
6.8.2	Možnosti identifikácie sklíčok v systéme	163
6.9	Kompatibilita sklíčok	164
6.9.1	Kompatibilita protokolov	164
7	Protokoly (na riadiacom zariadení BOND)	167
7.1	Typy protokolov	168
7.1.1	Režimy farbenia	168
7.1.2	Sekvencie protokolu	170
7.2	Obrazovka nastavenia protokolu	172
7.2.1	Podrobnosti protokolu	174
7.3	Vytvorenie nových protokolov	176
7.4	Úpravy používateľských protokolov	177
7.4.1	Úpravy krokov protokolu	177
7.4.2	Pridanie a odstránenie krokov protokolu	179
7.4.3	Pravidlá protokolu	186
7.4.4	Viaceré typy modulov spracovania a verzie protokolov	190
7.4.5	Odstraňovanie protokolov	193

7.5	Správy protokolu	194
7.6	Preddefinované protokoly	195
7.6.1	Protokol farbenia	195
7.6.2	Protokoly predbežného farbenia	197
8	Správa reagensí (na riadiacom zariadení BOND)	198
8.1	Prehľad správy reagensí	199
8.1.1	Všeobecné informácie	200
8.2	Obrazovka nastavenia reagensie	204
8.2.1	Pridanie alebo úprava reagensie	206
8.2.2	Odstránenie reagensie	208
8.3	Obrazovka zásob reagensí	209
8.3.1	Stanovenie objemu reagensie	211
8.3.2	Údaje o reagensii alebo systéme reagensí	212
8.3.3	Registrácia reagensí a systémov reagensí	215
8.3.4	Správa s údajmi o zásobách	218
8.3.5	Správa o použití reagensí	219
8.4	Obrazovka panela reagensí	220
8.4.1	Vytvorenie panela	220
8.4.2	Zobrazenie alebo úprava detailov panela	221
8.4.3	Odstránenie panela	221
9	História sklíčok (na riadiacom zariadení BOND)	222
9.1	Obrazovka histórie sklíčok	223
9.2	Výber sklíčok	225
9.3	Vlastnosti sklíčka a opätovné spustenie sklíčka	226
9.3.1	Opätovné spustenie sklíčok	226
9.4	Správa o udalostiach cyklu	227
9.5	Správa s údajmi o cykle	228
9.6	Správa o prípade	230
9.7	Správa protokolu	231
9.8	Súhrn sklíčok	232
9.9	Export údajov	233
9.10	Stručná história sklíčok	235

10 Klient správy (na riadiacom zariadení BOND)	236
10.1 Users (Používatelia)	237
10.2 LIS (Laboratórny informačný systém)	239
10.3 Labels (Štítky)	241
10.3.1 Vytváranie, úprava a aktivácia šablón štítkov	244
10.3.2 Typy informácií	246
10.4 BDD	248
10.4.1 Aktualizácie BDD	249
10.4.2 Záznam z auditu	250
10.5 Nastavenia	250
10.5.1 Laboratórne nastavenia	251
10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka	252
10.5.3 Zálohy databázy	253
10.6 Hardvér	255
10.6.1 Moduly spracovania	255
10.6.2 Súbory	258
10.6.3 Značkovače sklíčok	260
11 Integrovaný balík LIS (na BOND riadiacom zariadení)	274
11.1 Terminológia systému LIS	275
11.2 Ďalšie softvérové funkcie	276
11.2.1 Ikona stavu systému LIS	276
11.2.2 Prípady LIS	276
11.2.3 Sklíčka LIS	277
11.2.4 Názvy verejných značkovačov	278
11.2.5 Prioritné sklíčka	278
11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS	279
11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS	279
11.4 Oznámenia systému LIS	280
11.5 Požiadavky na údaje o prípade a sklíčku	281
11.5.1 Údaje o prípade	281
11.5.2 Údaje sklíčka	282
11.6 Posielanie údajov o sklíčku späť do systému LIS	283
11.7 Značkovače sklíčok	283

11.8	Pracovné postupy	284
12	Čistenie a údržba (len BOND-III a BOND-MAX)	285
12.1	Plán čistenia a údržby	287
12.1.1	Kontrolné zoznamy čistenia a údržby	288
12.2	Nádoby na nebalený materiál	291
12.2.1	Kontrola hladín v nádobách	291
12.2.2	Doplňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál	292
12.2.3	Čistenie nádob na nebalený materiál	296
12.2.4	Nádoba na externý odpad (len BOND-MAX)	298
12.3	krycie sklíčka Covertile	300
12.3.1	Odstránenie zvyšku DAB (voliteľné)	300
12.3.2	Štandardné čistenie (povinné)	300
12.4	Zostava na farbenie sklíčok	301
12.4.1	Ručné odomykanie zostáv na farbenie sklíčok	304
12.5	Reštart modulu spracovania	308
12.6	Nasávací sonda	309
12.6.1	Čistenie nasávacej sondy	309
12.6.2	Spustenie čistenia nasávacej sondy	310
12.7	Premývací blok a zmiešavacia stanica	311
12.8	Kryty, dvere a veko	312
12.9	Snímač identifikátorov	312
12.10	Odkvapkávací podnos	313
12.10.1	BOND-III Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál	313
12.10.2	Odkvapkávací podnos modulu spracovania BOND-III	315
12.10.3	BOND-MAX Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál	316
12.11	Podnosy na sklíčka	316
12.12	Sondy robota na nebalenú tekutinu (len BOND-III)	316
12.12.1	Čistenie sond robota na nebalenú tekutinu	316
12.13	Injekčné striekačky	317
12.13.1	Výmena injekčných striekačiek BOND-III	318
12.13.2	Výmena 9-portovej injekčnej striekačky BOND-MAX	319
12.14	Poistky napájania	321

13 Čistenie a údržba (rôzne)	323
13.1 Ručné čítačky čiarových kódov	323
13.1.1 Čítačka čiarových kódov Honeywell	323
13.1.2 Čítačka čiarových kódov Zebra DS2208	326
13.2 Značkovač sklíčok	329
14 Použitie reagensí BOND	330
14.1 Princíp postupu	330
14.1.1 Detekčné systémy BOND	331
14.2 Príprava vzorky	334
14.2.1 Potrebné materiály	334
14.2.2 Príprava tkaniva	336
14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie	336
14.2.4 Získavanie epitopov	337
14.3 Kontrola kvality	337
14.3.1 Overenie testu	338
14.3.2 Kontrolné vzorky tkanív	339
14.3.3 Negatívna kontrolná reagentia pre IHC	340
14.3.4 Kontrolné reagentie pre ISH	341
14.3.5 Výhody kontroly kvality	342
14.4 Interpretácia farbenia	343
14.4.1 Pozitívna kontrolná vzorka tkaniva	343
14.4.2 Negatívna kontrolná vzorka tkaniva	343
14.4.3 Tkanivo pacienta	344
14.5 Všeobecné obmedzenia	344
14.6 Literatúra	346
15 Správa systému (na riadiacom zariadení BOND)	347
15.1 Manažér systému BOND	347
15.1.1 Prehľad	347
15.1.2 Okno manažéra systému BOND	348
15.1.3 Zastavenie služieb	349
15.1.4 Spúšťanie služieb	349
15.2 Redundancia pevného disku	351

16	Operácie systému BOND-ADVANCE	352
16.1	Reštartovanie systému BOND-ADVANCE	352
16.2	Prepínanie na sekundárne riadiace zariadenie	353
17	Výmena tlačiarň značkovača sklíčok	358
17.1	Výmena tlačiarne Cognitive Cxi systému s jednou stanicou	358
17.2	Výmena tlačiarne Cognitive Cxi systému BOND-ADVANCE	359
17.3	Výmena tlačiarne Zebra za tlačiareň Cognitive Cxi systému s jednou stanicou	363
18	Technické údaje	364
18.1	Špecifikácie systému	364
18.2	Fyzické špecifikácie	365
18.3	Požiadavky na elektrické napájanie a zdroj UPS	365
18.4	Špecifikácie prostredia	365
18.5	Prevádzkové špecifikácie	366
18.6	Mikroskopické sklíčka	367
18.7	Doprava a skladovanie	368

1

Úvod

1.1 Prehľad systému

Gratulujeme ku kúpe vášho plne automatizovaného systému BOND na farbenie pre imunohistochemický rozbor (IHC) a insitu hybridizáciu (ISH). Sme presvedčení, že s ním získate kvalitu farbenia, výkonnosť a ľahké použitie, ktoré potrebujete vo svojom laboratóriu. Cieľovými používateľmi systému BOND sú primerane vyškolení laboratórni pracovníci.

Systém BOND môže obsahovať viac modulov spracovania koordinovaných prostredníctvom riadiaceho zariadenia BOND.

Existujú tri typy modulov spracovania (PM):

- BOND-III a BOND-MAX – každý s kapacitou 30 sklíčok. V prípade potreby sa súčasne môžu spracovávať tri cykly až s desiatimi sklíčkami s použitím rôznych protokolov farbenia, pričom každý pokus sa spúšťa samostatne, aby sa zabezpečilo nepretržité spracovanie. Jeden alebo viac cyklov môže byť nastavených na multiplexové farbenie, zatiaľ čo ďalší môže spracovávať jedno farbenie DAB alebo Red.
- BOND-PRIME – 24 nezávislých protokolov farbenia a nepretržité spracovanie s kapacitou 72 sklíčok.

Softvér BOND uľahčuje nastavenie a farbenie sklíčok. Používajte prísne testované protokoly dodávané so systémom alebo si vytvorte vlastné. Vyberte si zo širokej ponuky hotových reagensí BOND alebo akýchkoľvek iných protilátok alebo sond v kombinácii s veľkou škálou detekčných systémov BOND vysokej kvality. Po vytvorení virtuálnych sklíčok v softvéri – alebo ich importovaní z laboratórneho informačného systému (LIS) – vytlačte štítky (alebo použite štítky vytlačené systémom LIS), nalepte ich na sklíčka a potom ich vložte do modulu spracovania. Systém BOND sa postará zvyšok a dôsledne a spoľahlivo zabezpečí vysoko kvalitné farbenie.



Protokoly a produkty reagensí dodávané spoločnosťou Leica Biosystems sa zobrazia v softvéri tak, ako ich poskytuje spoločnosť Leica Microsystems.

Medzi prvky a vlastnosti systému BOND patria:

- vysoký výkon,
- flexibilita,
- bezpečnosť,
- automatizované farbenie a kontrastné farbenie IHC,
- automatické farbenie a kontrastné farbenie ISH,
- automatické zahrievanie, odvoskovanie a získavanie,
- Automatické multiplexové farbenie


Veríme, že systém BOND bude cenným doplnkom vášho laboratória.

Pozrite si sekcie:

- [1.2 Získanie pomoci](#)
- [1.3 Prvé kroky](#)
- [1.4 Spustenie protokolu – pracovné postupy](#)

1.2 Získanie pomoci

Používateľská príručka BOND (táto príručka) je nainštalovaná vo formáte PDF na všetkých riadiacich zariadeniach (s jednou stanicou) a termináloch (BOND-ADVANCE). Je tiež na kľúči USB dodávanom so systémom.

Túto používateľskú príručku môžete zobrazit' kliknutím na ikonu **Help** (Pomoc)  na paneli funkcií v oboch softvérových klientoch BOND alebo jej otvorením z ikony na pracovnej ploche.

V prípade problémov so systémom BOND sa obráťte na miestneho zástupcu Leica Biosystems alebo si pozrite stránku www.leicabiosystems.com.

1.3 Prvé kroky

Noví používatelia systému BOND v tejto sekcii nájdu informácie o tom, kde môžu nájsť potrebné informácie v používateľskej príručke na získanie úplných pracovných znalostí o produkte.

Krok	Opis	Sekcia manuálu
1	Inštalácia a uvedenie do prevádzky Nastavenie hardvéru, nainštalovaný softvér, skontrolovaný systém. Vykonávané zástupcami spoločnosti Leica Biosystems alebo autorizovaným distribútorom.	–
2	Prečítajte si sekciu Bezpečnosť Zoznámte sa s bezpečnostnými požiadavkami pre systém BOND.	Všeobecné výstrahy a Všeobecné upozornenia
3	Poznajete svoj hardvér Zoznámte sa s názvami a používaním hardvéru BOND.	2 Hardvér
4	Poznajete svoj softvér Získajte všeobecné znalosti o softvéri a o tom, ako ho používať.	3 Prehľad softvéru (na riadiacom zariadení BOND)
5	Skontrolujte protokoly a reagenty Počas inštalácie mohli byť nastavené reagenty a protokoly: <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či boli nastavené protokoly, ktoré chcete spustiť. • Skontrolujte, či sú nastavené reagenty požadované na vašom pracovisku. 	7 Protokoly (na riadiacom zariadení BOND) 8 Správa reagentov (na riadiacom zariadení BOND)
6	Spustenie protokolu Pre veľmi stručný prehľad. Pre podrobnejší prehľad.	1.4 Spustenie protokolu – pracovné postupy 4 Rýchly štart
7	Pokročilé Podľa potreby získajte podrobnejšie informácie o softvéri.	5 Stavové obrazovky BOND-III a BOND-MAX (na riadiacom zariadení BOND) až 9 História sklíčok (na riadiacom zariadení BOND)
8	Práca so systémom LIS Voliteľný balík umožňuje pripojenie k laboratórnemu informačnému systému.	11 Integrovaný balík LIS (na BOND riadiacom zariadení)
9	Starostlivosť o váš systém BOND	12 Čistenie a údržba (len BOND-III a BOND-MAX)

1.4 Spustenie protokolu – pracovné postupy

1.4.1 BOND-III a BOND-MAX



VÝSTRAHA: Na predchádzanie kontaminácii reagensí a sklíčok sa modul spracovania musí prevádzkovať v čistom prostredí tak, aby bol čo najviac zbavený prachu a pevných častíc.

Nasleduje prehľad štandardných krokov, ktoré sa vykonávajú pri farbení podnosu so sklíčkami. Pri rôznych nastaveniach možností sú možné ďalšie pracovné postupy.

1.4.1.1 Počiatočné kontroly a uvedenie do prevádzky

- 1 Skontrolujte, či je modul spracovania čistý a či sú všetky úlohy údržby aktuálne ([12.1 Plán čistenia a údržby](#)). Medzi denné predbežné úlohy patria:
 - a Skontrolujte, či sú nádoby na nebalený odpad naplnené maximálne do polovice.
 - b Skontrolujte nádoby na nebalené reagensie. Ak je to potrebné, doplňte ich.
- 2 Skontrolujte premývacie bloky a zmiešavaciu stanicu – v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.
- 3 Skontrolujte, či značkovač sklíčok obsahuje štítky a tlačovú pásku a či je zapnutý.
- 4 Zapnite riadiace zariadenie modulu spracovania (a terminál pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta BOND.

1.4.1.2 Konfigurácia reagensí

- 1 V prípade potreby vytvorte v systéme reagensie ([8.2.1 Pridanie alebo úprava reagensie](#)).
- 2 Registrujte nádoby na reagensie ([8.3.3 Registrácia reagensí a systémov reagensí](#)).


1.4.1.3 Konfigurácia protokolov

- 1 V prípade potreby vytvorte nové protokoly ([7.3 Vytvorenie nových protokolov](#)).

1.4.1.4 Konfigurácia sklíčok

- 1 Vytvorte prípady v softvéri ([6.3.3 Pridanie prípadu](#)).
- 2 Vytvorte sklíčka v softvéri ([6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)).
- 3 Vytlačte štítky sklíčok a nalepte ich na sklíčka ([6.6.1 Tlač štítkov a nalepenie na sklíčka](#)).
- 4 Položte sklíčka a krycie sklíčka Covertile na podnosy na sklíčka ([4.1.3 Nastavenie sklíčok](#)).

1.4.1.5 Vloženie modulu spracovania a spustenie cyklu

- 1 Vložte podnosy na sklíčka do modulu spracovania (4.1.3.5 Vkladanie sklíčok).
- 2 Vložte detekčný systém a podnosy na reagencie do modulu spracovania (4.1.4 Vkladanie reagencií).
- 3 Stlačte tlačidlá Load/Unload (Vložiť/vybrať) na module spracovania na uzamknutie podnosov na sklíčka.
- 4 Na obrazovke **System status** (Stav systému) skontrolujte, či boli identifikované všetky sklíčka – manuálne identifikujte sklíčka, ktoré neboli automaticky identifikované (5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme).
- 5 Zobrazte a opravte všetky signály s upozornením na obrazovke **System status** (Stav systému).
- 6 Kliknutím na tlačidlo  spustíte cyklus.

1.4.1.6 Monitorovanie cyklu

- 1 Monitorujte priebeh cyklu na obrazovke **System status** (Stav systému) (5.1 Stavová obrazovka systému) alebo BOND ovládacom paneli (3.5 Ovládací panel BOND-ADVANCE). Zobrazte a opravte všetky oznámenia.

1.4.1.7 Vyložte sklíčka a reagencie

- 1 Po dokončení cyklu vyberte detekčný systém a podnosy na reagencie a uložte reagencie (4.1.6 Dokončenie).



Ak sa modul spracovania nepoužíva, odstráňte nádoby na nebalený materiál ER1 a ER2 a uskladnite ich pri teplote +2 až +8 °C. Pozrite si tiež časť 2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál.

- 2 Stlačením tlačidiel Load/Unload (Vložiť/vybrať) na module spracovania odomknite podnosy na sklíčka a vyberte ich.
- 3 Odstráňte krycie sklíčka Covertile a vyčistite ich (12.3 krycie sklíčka Covertile).



Počas čistenia krycích sklíčok Covertile nenechávajte sklíčka v podnosoch.

- 4 Vyberte sklíčka.
- 5 Vyčistite všetky vyliate tekutiny alebo stopy na zostavách na farbenie sklíčok (12.4 Zostava na farbenie sklíčok), na iných častiach modulu spracovania alebo na podnosoch na podložné sklíčka alebo reagencie.

1.4.1.8 Hydratácia pri používaní systému BOND-MAX a BOND-III

Po dokončení procesu farbenia budú sklíčka hydratované, kým ich neodstránite. V prípade systému BOND-MAX a BOND-III budú sklíčka na podnose na sklíčka pravidelne hydratované špecifikovanou hydratačnou tekutinou, kým nebudú podnosy na sklíčka zdvihnuté. Po zdvihnutí podnosu na sklíčka sa uistite, že ste podnosy okamžite vybrali z modulu spracovania.

1.4.2 BOND-PRIME

Podrobné informácie nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

1.4.2.1 Počítačové kontroly a uvedenie do prevádzky

- 1 Zapnite riadiace zariadenie (a terminál pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta BOND.
- 2 Skontrolujte, či značkovač sklíčok obsahuje štítky a tlačovú pásku a či je zapnutý.
- 3 Inicializujte modul spracovania BOND-PRIME a prihláste sa.
- 4 Dokončite všetky úlohy poradia opatrení, ktoré ukazujú, že akcia sa vyžaduje „čo najskôr“ alebo „teraz“.

1.4.2.2 Konfigurácia reagencií

- 1 V prípade potreby vytvorte v systéme reagenty (8.2.1 Pridanie alebo úprava reagenty).
- 2 Registrujte nádoby na reagenty (8.3.3 Registrácia reagentov a systémov reagentov).

1.4.2.3 Konfigurácia protokolov

- 1 V prípade potreby vytvorte nové protokoly (7.3 Vytvorenie nových protokolov).

1.4.2.4 Konfigurácia sklíčok

- 1 Vytvorte prípady v softvéri (6.3.3 Pridanie prípadu).
- 2 Vytvorte sklíčka v softvéri (6.5.2 Vytvorenie sklíčka).
- 3 Vytlačte štítky sklíčok a nalepte ich na sklíčka (6.6.1 Tlač štítkov a nalepenie na sklíčka).

1.4.2.5 Na module spracovania BOND-PRIME:

- 1 Vložte podnos na reagenty a podnos detekčného systému.
- 2 Vložte sklíčka do zásuvky na predbežné vloženie.
- 3 Sklíčka sa potom naskenujú, presunú zo zásuvky a automaticky spracujú.

1.4.2.6 Hydratácia pri používaní systému BOND-PRIME

Po dokončení procesu farbenia budú sklíčka hydratované, kým ich neodstránite. V prípade systému BOND-PRIME sa sklíčka prenesú do zásuvky na vykladanie, kde budú hydratované v zásuvke s deionizovanou vodou, kým sa sklíčka nevyberú.

2

Hardvér



Informácie o hardvéri modulu spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Cieľom tejto časti je poskytnúť vám tieto informácie:

- názvy častí zariadenia v systéme BOND,
- funkcie týchto položiek a ako súvisia so systémom ako celkom,
- kde nájdete ďalšie informácie, napríklad prevádzkové postupy a postupy údržby týkajúce sa zariadenia.

Detaily o nastavení a pripojení komponentov nie sú súčasťou opisov hardvéru, pretože systém by sa mal nastaviť a otestovať pre vás. Ak potrebujete vymeniť alebo znovu pripojiť komponenty, detaily sú uvedené v časti **12 Čistenie a údržba (len BOND-III a BOND-MAX)**.

Ak je to vhodné, informácie o moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX sú rozdelené do samostatných sekcií, aby ste rýchlejšie našli relevantné informácie.

Pozrite si sekcie:

- **2.1 Systém BOND**
- **2.2 Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX**
- **2.3 Riadiace zariadenie a terminály BOND**
- **2.4 Ručná čítačka čiarových kódov**
- **2.5 Značkovač sklíčok**
- **2.6 Pomocné vybavenie**
- **2.7 Premiestnenie modulu spracovania**
- **2.8 Vyradenie z prevádzky a likvidácia prístroja**

2.1 Systém BOND

Systém BOND pozostáva z nasledujúcich hlavných komponentov:

- jeden alebo viac modulov spracovania (pozrite si časť [2.2 Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX](#)),
Informácie o module spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.
- riadiace zariadenie BOND alebo riadiace zariadenie BOND-ADVANCE (pozrite si časť [2.3 Riadiace zariadenie a terminály BOND](#)),
Inštalácie BOND-ADVANCE majú terminály aj riadiace zariadenie a môžu obsahovať sekundárne (záložné) riadiace zariadenie,
- jednu alebo viac ručných čítačiek čiarových kódov (pozrite si časť [2.4 Ručná čítačka čiarových kódov](#)),
- jednu alebo viac tlačiarň označení sklíčok (pozrite si časť [2.5 Značkovač sklíčok](#)).

Každý nový modul spracovania BOND-III alebo BOND-MAX sa dodáva s:

- 4 podnosmi na sklíčka (pozrite si časť [2.6.2.1 Podnosy na sklíčka](#)),
- 4 podnosmi na reagencie (pozrite si časť [2.6.2.2 Podnosy na reagencie](#)),
- 1 zmiešavacou stanicou (pozrite si časť [2.2.9 Premývací blok a zmiešavacia stanica](#)),
- 1 kľúčom s vnútorným šesťhranom na výmenu pumpy injekčných striekačiek,
- 1 ethernetovým káblom.

Pre moduly spracovania BOND-III alebo BOND-MAX budete tiež potrebovať:

- krycie sklíčka Covertile (pozrite si časť [2.6.2 Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles](#)),
- detekčné systémy BOND a hotové reagencie alebo koncentráty BOND a/alebo otvorené nádoby na reagencie (pozrite si časť [2.6.3 Systémy a nádoby na reagencie](#)),

Informácie o príslušenstve dodávanom s modulom spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Úplný a aktuálny zoznam spotrebného materiálu a náhradných dielov si pozrite na www.leicabiosystems.com.

Pozrite si tiež časť [3.1 Architektúra systému](#).

2.1.1 Doplnkové produkty BOND

Doplnkové produktov BOND sú navrhnuté osobitne pre systém BOND a ich použitie pomáha zaistiť optimálne výsledky farbenia. Použitie doplnkových produktov BOND tiež pomáha udržiavať modul spracovania v dobrom stave a predchádzať poškodeniu.



Na systéme BOND by sa mali vždy používať nasledujúce produkty a *nikdy* sa nemajú nahrádzať inými produktmi:

Pomocné reagensie

- Premývací roztok BOND alebo BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
- Roztok na získavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 a 2)
- Roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution

Spotrebný materiál BOND-III alebo BOND-MAX

- Sklíčka BOND Plus a Apex BOND (alebo sklenené sklíčka vyhovujúce špecifikáciám uvedeným v časti [2.6.1 Sklíčka](#))
- Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles
- Otvorené nádoby BOND (7ml a 30ml)
- Titračné nádoby a vložky BOND (6ml)
- Zmiešavacia fľaštička BOND
- Súprava BOND Slide Label and Printer Ribbon

Spotrebný materiál BOND-PRIME

- Sklíčka BOND Plus a Apex BOND (alebo sklenené sklíčka vyhovujúce špecifikáciám uvedeným v časti [2.6.1 Sklíčka](#))
- Otvorené nádoby BOND (7ml a 30ml)
- Titračné nádoby a vložky BOND (6ml)
- BOND-PRIME Suction Cups (Prísavky BOND-PRIME)
- Súprava BOND Slide Label and Printer Ribbon
- BOND-PRIME ARC Refresh Kit (Obnovovacia súprava ARC BOND-PRIME) (obsahuje krycie sklíčka ARC Covertiles a Mixing Well Plate (dosku so zmiešavacími jamkami))

2.2 Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX

Modul spracovania (PM) je platforma farbenia systému BOND. Systém BOND s jednou stanicou môže mať až 5 modulov spracovania a systém BOND-ADVANCE ich môže mať až 30 v akejkoľvek kombinácii typov modulov spracovania.



VÝSTRAHA: Modul spracovania musí byť pripojený k uzemnenej sieťovej zásuvke a musí byť umiestnený tak, aby pracovníci mohli ľahko odpojiť sieťový kábel bez toho, aby museli pohybovať modulom spracovania.

- [2.2.1 Hlavné komponenty](#)
- [2.2.2 Inicializácia modulu spracovania](#)
- [2.2.3 Veko](#)
- [2.2.4 Hlavný robot a snímač identifikátorov](#)
- [2.2.5 Zostavy na farbenie sklíčok](#)
- [2.2.6 Predný kryt](#)
- [2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál](#)
- [2.2.8 Nasávací sonda](#)
- [2.2.9 Premývací blok a zmiešavacia stanica](#)
- [2.2.10 Roboty na nebalenú tekutinu \(iba BOND-III\)](#)
- [2.2.11 Injekčné striekačky](#)
- [2.2.12 Vypínač](#)
- [2.2.13 Zadný kryt](#)

2.2.1 Hlavné komponenty

Pozrite si hlavné komponenty systému BOND-III a BOND-MAX:


- [2.2.1.1 BOND-III](#)
- [2.2.1.2 BOND-MAX](#)

2.2.1.1 BOND-III

Nasledujúce fotografie zobrazujú komponenty hlavného modulu spracovania pre systém BOND-III. Je zobrazený aktuálny model – staršie modely sa líšia vzhľadom, ale hlavné komponenty sú rovnaké.

Opis zadného krytu je uvedený v časti [2.2.13 Zadný kryt](#).

Obrázok 2-1: Pohľad spredu na predchádzajúci (vľavo) a aktuálny (vpravo) BOND-III modul spracovania

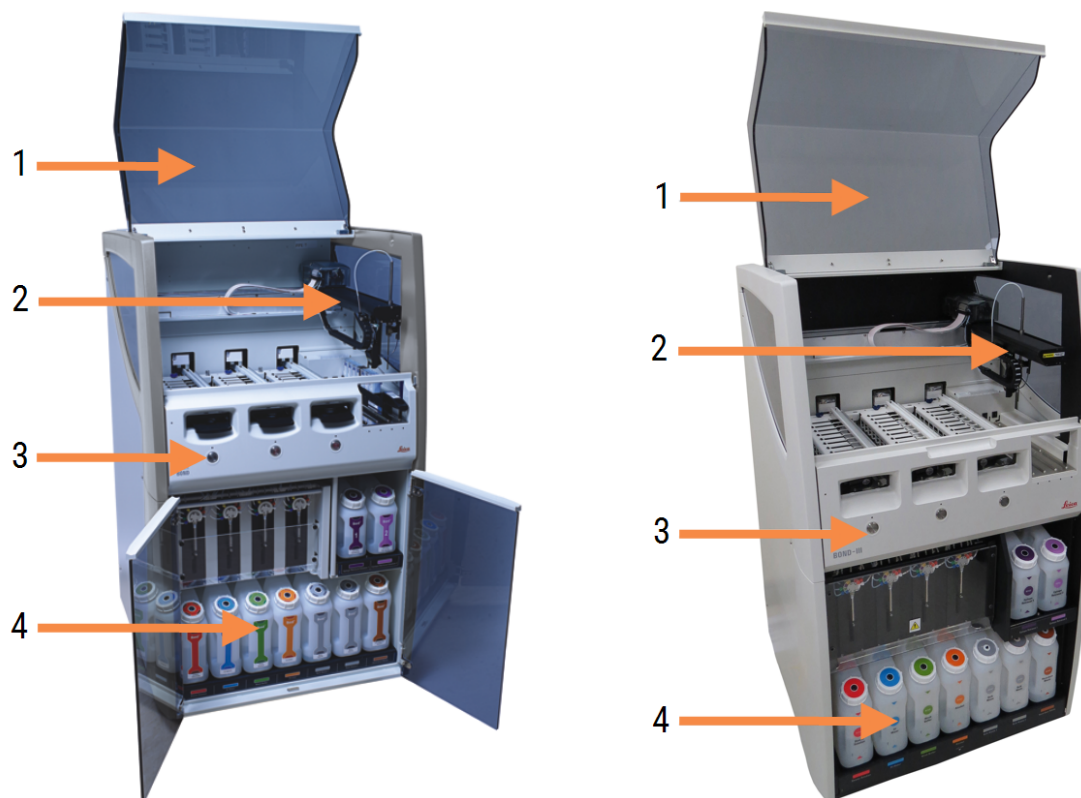

Legenda

- | | |
|---|---|
| <p>1 Veko
2.2.3 Veko</p> <p>2 Hlavné robotické rameno
2.2.4 Hlavný robot a snímač identifikátorov</p> | <p>3 Predný kryt
2.2.6 Predný kryt</p> <p>4 Priehradka na nádoby na nebalený materiál
2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál</p> |
|---|---|

Obrázok 2-2: Predná strana modulu spracovania BOND-III



Legenda

- | | |
|--|--|
| <p>5 Roboty na nebalenú tekutinu
2.2.10 Roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III)</p> | <p>7 Injekčné striekačky
2.2.11 Injekčné striekačky</p> |
| <p>6 Zostavy na farbenie sklíčok
2.2.5 Zostavy na farbenie sklíčok</p> | <p>8 Platforma reagencií
2.2.6.5 Platforma reagencií</p> |

2.2.1.2 BOND-MAX

Nasledujúce fotografie zobrazujú hlavné komponenty modulu spracovania BOND-MAX. Je zobrazený aktuálny model – staršie modely sa líšia vzhľadom, ale hlavné komponenty sú rovnaké.


Obrázok 2-3: Pohľad spredu na modul spracovania BOND-MAX



Legenda

- | | |
|--|--|
| <p>1 Veko
2.2.3 Veko</p> | <p>4 Predný kryt
2.2.6 Predný kryt</p> |
| <p>2 Rameno robota
2.2.4 Hlavný robot a snímač identifikátorov</p> | <p>5 Priehradka na nádoby na nebalený materiál
2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál</p> |
| <p>3 Zostavy na farbenie sklíčok
2.2.5 Zostavy na farbenie sklíčok</p> | |

Obrázok 2-4: Modul spracovania BOND-MAX pri pohľade z pravej strany

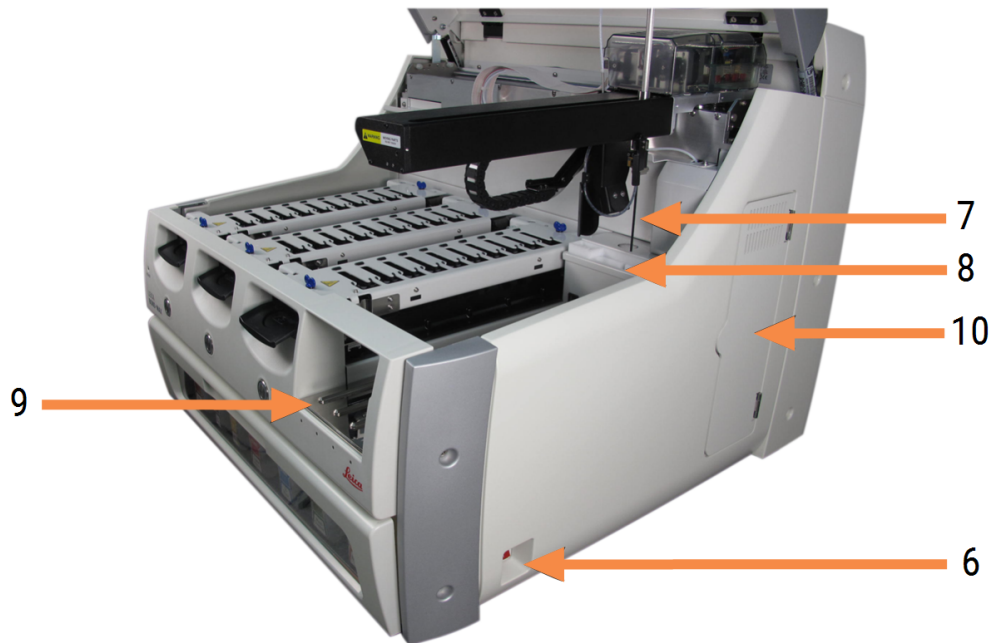

Legenda

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 6 | Vypínač
2.2.12 Vypínač | 9 | Platforma reagentov
2.2.6.5 Platforma reagentov |
| 7 | Nasávací sonda
2.2.8 Nasávací sonda | 10 | Injekčná striekačka (pozrite si časť nižšie)
2.2.11 Injekčné striekačky |
| 8 | Premývací blok a zmiešavacia stanica
2.2.9 Premývací blok a zmiešavacia stanica | | |

Opis zadného krytu je uvedený v časti 2.2.13 Zadný kryt.

Obrázok 2-5: Injekčná striekačka za dverami na pántoch



2.2.2 Inicializácia modulu spracovania

Keď zapnete modul spracovania, systém BOND vykoná interné kontroly, aktivuje fluidický systém a premiestni roboty do ich východiskovej polohy. Hlavný robot sa presunie do ľavého zadného rohu modulu spracovania a tri roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III) sa presunie do zadnej časti modulu spracovania.

Zostavy na farbenie sklíčok sa inicializujú a vrátia do svojej odomknutej polohy. Proces inicializácie sa zastaví, ak sa zistí chyba alebo ak je modul v stave nevhodnom na spracovanie.

Pred pokusom o inicializáciu modulu spracovania skontrolujte nasledujúce položky:

- veko je zatvorené,
- Predné dvere sú zatvorené (iba BOND-MAX)
- nádoby na nebalený odpad sú plné menej ako do polovice,
- Nádoby na nebalené reagenty obsahujú adekvátne reagenty
- zmiešavacia stanica je na svojom mieste,
- injekčné liekovky na zmiešavaciu stanicu sú prázdne a čisté.
- horné dosky zostávajú na farbenie sklíčok (SSA) sú v uzavretej polohe.

Kontrolka LED napájania na prednej strane modulu spracovania sa zmení na zelenú a softvér BOND označuje, že je modul pripojený. Po dokončení inicializácie sa na karte modulu spracovania zobrazí ikona troch podnosov na sklíčka (pozrite si časť [5.1.1 Karty modulu spracovania](#)). Nepokúšajte sa používať modul spracovania, kým nebude úplne inicializovaný.

2.2.3 Veko

Veko je navrhnuté tak, aby sa počas prevádzky uzavrelo, a je chránené zámkami.



VÝSTRAHA: Pri zatváraní veka modulu spracovania buďte opatrní a uistite sa, že máte čisté ruky, aby nedošlo k zraneniu.



VÝSTRAHA: Počas prevádzky sa hlavný robot, nasávací sonda a roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III) môžu pohybovať bez varovania a rýchlosťou, ktorá môže spôsobiť zranenie.

Nepokúšajte sa otvoriť veko modulu spracovania, keď prebieha cyklus.

Nepokúšajte sa obísť blokovanie, ktoré bráni činnosti modulu spracovania, keď je veko otvorené.



VÝSTRAHA: Ak hlavný robot a/alebo roboty na nebalenú tekutinu naďalej fungujú dlhšie ako približne 5 sekúnd po otvorení veka modulu spracovania, okamžite sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.

2.2.4 Hlavný robot a snímač identifikátorov

Hlavný robot umiestni nasávaciu sondu tak, aby nasávala a dávkovala reagencie. Rameno robota drží snímač identifikátorov, ktorý sa používa na identifikáciu podložných sklíčok a reagencií vložených do modulu spracovania.

Obrázok 2-6: Fotografia hlavného robota so snímačom identifikátorov označeným šípkou



VÝSTRAHA: Pokiaľ je modul spracovania zapnutý, nepohybujte hlavným ramenom robota. Robot sa môže vyrovnáť, čo má za následok zlé farbenie.

Ak bol robot presunutý: vypnite modul spracovania, počkajte 30 sekúnd a potom ho znovu inicializujte.

V prípade sklíčok systém BOND naskenuje každý štítok sklíčka na účely identifikácie (pozrite si časť [5.1.5.1 Automatická identifikácia sklíčok](#)).

- Okno snímača identifikátorov by sa malo pravidelne čistiť.
Pokyny si pozrite v časti [12.9 Snímač identifikátorov](#).
- Ak je nasávací sonda zlomená alebo ohnutá, obráťte sa na podporu zákazníka.

2.2.5 Zostavy na farbenie sklíčok




VÝSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zosťavami na farbenie sklíčok a ich okolím. Môžu byť veľmi horúce a spôsobiť vážne popáleniny. Po ukončení činnosti nechajte zostavy na farbenie sklíčok a ich okolie vychladnúť dvadsať minút.



VÝSTRAHA: Potenciálne nebezpečné reagentie sa môžu zhromažďovať okolo zostáv na farbenie sklíčok a kontaminovať podnosy na sklíčka. Pri manipulácii s podnosmi na sklíčka vždy používajte schválený ochranný odev a rukavice.

Sklíčka sa spracúvajú v zostavách na farbenie sklíčok. Každý modul spracovania obsahuje tri zostavy na farbenie sklíčok.

Ak chcete začať s prevádzkou, operátor vloží podnos na sklíčka cez predný kryt (opísaný v časti [2.2.6 Predný kryt](#)) a potom stlačí tlačidlo Load (Vložiť). Systém BOND zaznamená snímky sklíčok. Ak sú sklíčka kompatibilné (pozrite si časť [6.9 Kompatibilita sklíčok](#)) a všetky reagentie sú prítomné, používateľ potom môže spustiť cyklus. Ďalšie informácie o zadávaní podrobností o sklíčku a načítavaní sklíčok nájdete v časti [6 Nastavenie sklíčka \(na riadiacom zariadení BOND\)](#).

Pred začatím spracovania systém BOND zaistí sklíčka do zostavy na farbenie sklíčok. Ak potrebujete odstrániť podnos na sklíčka, kým systém BOND spracováva sklíčka, musíte najprv cyklus opustiť. Kliknite na položku  pod podnosom obrazovke **System status** (Stav systému) (pozrite si časť [5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu](#)) a potom odomknite zostavu na farbenie sklíčok.

Informácie o čistení a bežnej údržbe zostavy na farbenie sklíčok si pozrite v časti [12.4 Zostava na farbenie sklíčok](#).

Ohrievače zostáv na farbenie sklíčok



VÝSTRAHA: Ohrievače a vyhrievané povrchy na module spracovania môžu predstavovať nebezpečenstvo zapálenia:

- Na ohrievače ani blízko nich nekladte horľavé materiály.
- Na modul spracovania nekladte horľavé materiály.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.



VÝSTRAHA: Niektoré reagentie použité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX sú horľavé:

- Neumiestňujte plameň ani zdroj zapálenia do blízkosti modulov spracovania.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.

Moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX majú ohrievacie teleso v každej polohe sklíčka. Každý z týchto prvkov sa nezávisle monitoruje a v prípade chyby teploty sa označí ako chybný (pozrite si [Obrázok 2-7](#)). Ak je indikovaný chybný ohrievač, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Obrázok 2-7: Individuálna chyba ohrievača



Mali by ste sa pokúsiť spustiť sklíčko, ktoré vyžaduje zahrievanie v polohe označenej ako chybná. Ak ohrievanie nefunguje počas cyklu, potom sa sklíčko v tejto polohe nemusí správne spracovať.

Ak porucha ohrievača predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, modul spracovania vypne všetky ohrievače sklíčok vrátane ohrievača akéhokoľvek sklíčka s regulovanou teplotou, ktoré sa práve spracúva.

Obrázok 2-8: Sivé symboly ohrievača v každej polohe označujú úplné vypnutie vyhrievania



Po vypnutí vyhrievania sklíčok musíte vypnúť a reštartovať modul spracovania, aby ste vyčistili zámok ohrievača. Polohy sklíčok môžete naďalej používať s chybnými ohrievačmi, pokiaľ sklíčka, ktoré sa tam spracovávajú, nevyžadujú zahrievanie.

2.2.6 Predný kryt

Nasledujúce obrázky znázorňujú predné kryty systému BOND-III a BOND-MAX.

Obrázok 2-9: Predný kryt BOND-III



Legenda

- | | |
|--|--|
| 1 Predný kryt
2.2.6.1 Kontrolka LED napájania | 4 Platforma reagensí
2.2.6.5 Platforma reagensí |
| 2 Priečinko na podnos na sklíčka
2.2.6.2 Priečinko na podnos na sklíčka | 5 Kontrolka LED podnosu na reagencie
Kontrolka LED podnosu na reagencie |
| 3 Kontrolka LED podnosu na sklíčka
2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklíčka | 6 Tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať)
2.2.6.4 Tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) |

Obrázok 2-10: Predný kryt BOND-MAX



Legenda


- | | |
|--|--|
| 1 Predný kryt
2.2.6.1 Kontrolka LED napájania | 4 Platforma reagencií
2.2.6.5 Platforma reagencií |
| 2 Priečinok na podnos na sklíčka
2.2.6.2 Priečinok na podnos na sklíčka | 5 Kontrolka LED podnosu na reagencie
Kontrolka LED podnosu na reagencie |
| 3 Kontrolka LED podnosu na sklíčka
2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklíčka | 6 Tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať)
2.2.6.4 Tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) |

2.2.6.1 Kontrolka LED napájania

Funguje takto:

- **Vypnutá** – bez napájania,
- **Modrá** (aktuálny model) alebo **oranžová** (predchádzajúce modely) – zapnutie, ale softvér modulu spracovania sa ešte nespustil,
- **Zelená** – zapnutá, systém je v prevádzke.

Obrázok 2-11: Farby kontroliek LED napájania (modrá, zelená) na module BOND-MAX spracovania

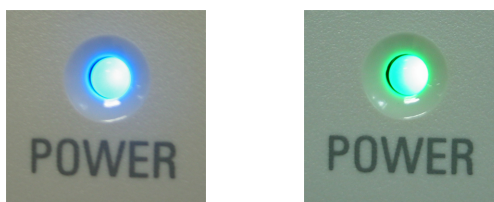

2.2.6.2 Priečinok na podnos na sklíčka

Existujú tri sekcie (jedna pre každú zostavu na farbenie sklíčok), do ktorých sú vložené podnosy na sklíčka. Po vložení podnosu na sklíčka stlačte tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) a zaistite ho v zostave na farbenie sklíčok. Keď je podnos uzamknutý, rameno robota presunie snímač identifikátorov ponad sklíčka v podnose, aby sa sklíčka automaticky identifikovali.

2.2.6.3 Kontrolka LED podnosu na sklíčka

Viacfarebné kontrolky LED na prednom kryte pod každou zostavou na farbenie sklíčok označujú stav podnosu na sklíčka. Na moduloch spracovania BOND-MAX sú kontrolky LED podnosu na sklíčka začlenené do tlačidiel Load/Unload (Vložiť/vybrať). Na týchto moduloch spracovania sa kontrolka LED na niekoľko sekúnd po stlačení zmení na modrú.

Farebné kontrolky LED zostavy na farbenie sklíčok sú nasledujúce:

- **Vypnutá** – nie je prítomný žiadny podnos na sklíčka alebo je podnos na sklíčka odomknutý.
- **Neprerušovaná oranžová** – podnos je vložený a zablokovaný, ale spracovanie sa nezačalo.


Podnos sa dá bezpečne odomknúť a vybrať pomocou tlačidla Load/Unload (Vložiť/vybrať).

- **Neprerušovaná červená** – sklíčka v podnose sa spracúvajú.

Podnos je odomknutý a nemožno ho odomknúť pomocou tlačidla Load/Unload (Vložiť/vybrať). Na vyloženie musíte najskôr prerušiť spúšťanie softvéru.

- **Bliká na zeleno** – spracovanie skončilo bez upozornení. Odomknite tlačidlom Load/Unload (Vložiť/vybrať).
- **Bliká na červeno** – cyklus bol zamietnutý alebo bolo spracovanie ukončené s oznámeniami. Odomknite tlačidlom Load/Unload (Vložiť/vybrať).

Obrázok 2-12: Farby kontroliek LED podnosu na sklíčka (oranžová, červená, zelená) na module spracovania BOND-MAX

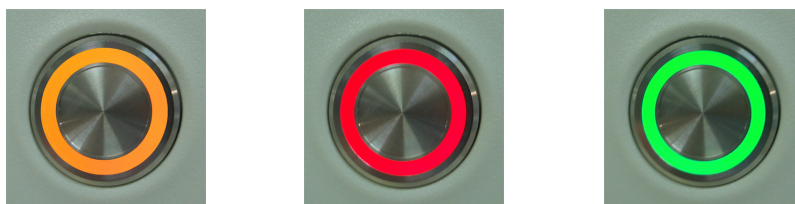

2.2.6.4 Tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať)

Stlačením tlačidla Load/Unload (Vložiť/vybrať) sa vykonávajú nasledujúce činnosti:

- Ak zásobník nie je vložený, nič sa nestane.
- Ak je podnos vložený a nie je zablokovaný, systém BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a ak je dostupné rameno robota, snímač identifikátorov identifikuje identifikátory sklíčka.
- Ak je podnos uzamknutý a cyklus sa nezačal, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.
- Ak je podnos uzamknutý a cyklus sa dokončil, systém BOND-III alebo BOND-MAX odomkne podnos.
- Ak je podnos uzamknutý a prebieha cyklus, tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) nemá žiadny účinok. Podnos nie je možné odomknúť, kým nedôjde k ukončeniu alebo opusteniu cyklu pomocou tohto podnosu.

Ak je zostava na farbenie sklíčok horúca, nemôžete blokovať ani odomknúť podnos – počkajte, kým zostava nevychladne.

2.2.6.5 Platforma reagencií

Na tomto mieste sú umiestnené podnosy na reagentie, ktoré obsahujú detekčné systémy, 7ml a 30ml nádoby na reagentie a/alebo 6ml titračné nádoby. Do každého zásobníka sa zmestí až deväť reagentií a na platformu reagentií možno vložiť až štyri podnosy na reagentie.


Ak chcete naplniť podnos na reagentie, posuňte podnos na platformu a do blokovacieho mechanizmu (pozrite si časť [4.1.4 Vkladanie reagentií](#)). Keď je k dispozícii rameno robota, systém BOND identifikuje reagentie v každej polohe reagentie.

Kontrolka LED podnosu na reagentie

Pod každou pozíciou podnosu sa nachádza dvojfarebná kontrolka LED, ktorá funguje takto:

- **Vypnutá** – podnos nebol detegovaný.
Ak je podnos vložený a kontrolka LED nesvieti, skontrolujte, či je podnos správne vložený;
- **Neprerušovaná červená** – v priebehu nasledujúcich dvoch minút sa vyžaduje reagentia na podnose.
Podnos je zablokovaný a nedá sa vybrať.
- **Neprerušovaná zelená** – v priebehu nasledujúcich dvoch minút nie je na tomto podnose potrebná žiadne reagentia.
Podnos je odomknutý a môže sa dočasne vybrať.

Obrázok 2-13: Farby kontroliek LED podnosu na reagentie (červená, zelená) na module spracovania BOND-MAX

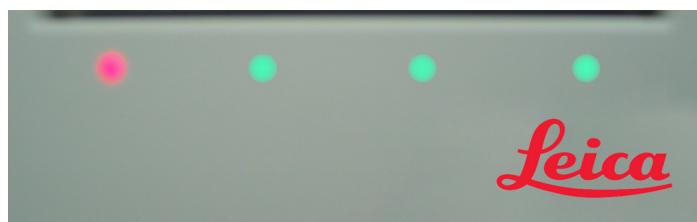

2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál

Nádoby na reagentie a odpad sa nachádzajú pod predným krytom v systéme BOND-III aj BOND-MAX. Systém BOND-MAX má tiež externú nádobu na štandardný odpad.

Pokyny na plnenie, vyprázdňovanie a údržbu nádob na nebalený materiál si pozrite v časti [12.2 Nádoby na nebalený materiál](#).



VÝSTRAHA: Aby ste zabezpečili správnu prevádzku modulu spracovania, vložte každú nádobu na nebalené reagentie do jeho správnej stanice v priehradke, ako je to uvedené na farebne označených štítkoch s názvom.

Pre systém BOND-III si pozrite [Obrázok 2-14](#); pre systém BOND-MAX si pozrite [Obrázok 2-16](#).

V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu farbenia.



VÝSTRAHA: Niektoré reagenty použité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX sú horľavé:

- Neumiestňujte plameň ani zdroj zapálenia do blízkosti modulov spracovania.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.

- [2.2.7.1 BOND-III](#)
- [2.2.7.2 BOND-MAX](#)

2.2.7.1 BOND-III

Predchádzajúci systém BOND-III má dve priehľadné dvere skrinky, ktoré umožňujú ľahký prístup ku všetkým nádobám na nebalený materiál. Pri otváraní držte koľajničku na vrchu dverí.

Všetok odpad zo zostáv na farbenie sklíčok sa čerpá do nádoby na nebezpečný odpad. Odpad z premývacieho bloku sa čerpá do nádob na štandardný alebo nebezpečný odpad v závislosti od stavu reagentu v odpade (ak je to vhodné, musíte nastaviť vaše vytvorené reagenty ako nebezpečné – pozrite si časť [8.2.1 Pridanie alebo úprava reagentu](#)).

Snímače hmotnosti pre každú nebalenú reagentu a nádobu na odpad upozorňujú používateľa, keď je hladina reagentu nízka alebo je úroveň odpadu príliš vysoká. Stav každej nádoby na nebalený materiál je vizuálne signalizovaný [Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál \(BOND-III\) \(Sekcia na strane 53\)](#). Upozorňujeme, že týmto systémom nie je vybavený predchádzajúci systém BOND-III. Môžete namiesto toho použiť ikony na obrazovke (pozrite si časť [5.1.3.6 Stav nádoby na nebalený materiál](#)).

Systém BOND-III má priestor pre nasledujúce nádoby v poliach uvedených na [Obrázok 2-14](#) zľava doprava:

Stanica	Nádoba	Pozícia	Veľkosť (L)	Farba	Reagent (Reagentia)
8	ER1	Vrchná polica	2	Fialová	Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9	ER2		2	Svetlo fialová	Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 2*
1	Roztok na odvoskovanie	Dolná polica	5	Červená	Roztok BOND Dewax Solution*
2	Deionizovaná voda		5	Modrá	Deionizovaná voda
3	Premývací pufer		5	Zelená	Roztok BOND Wash Solution*
4	Etanol		5	Oranžová	Etanol (reagenčného stupňa)
5	Nebalený odpad		5	Sivá	Štandardný odpad
6	Nebalený odpad		5	Sivá	Štandardný odpad
7	Nebezpečný odpad		5	Hnedá	Nebezpečný odpad

* Používajte iba reagenty BOND – nenahrádzajte ich inými produktmi.

Ak vaše laboratórium nepoužíva nádoby na reagenty na získavanie epitopov a/alebo na odvoskovanie, je možné ich v klientovi správy deaktivovať – pozrite si časť **10.6.1.1 Deaktivácia nádob na nebalené reagenty**.

Obrázok 2-14: Nádoby na nebalené reagenty BOND-III na svojom mieste



Uistite sa, že sa farba štítku každej nádoby na nebalený materiál a farba uzáveru a vytlačený popis zhodujú so štítkom na dutine prístroja hneď pod nádobou.

Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál (BOND-III)

Moduly spracovania BOND-III sú vybavené systémom osvetlenia nádob na nebalený materiál, ako to znázorňuje **Obrázok 2-15** nižšie.

Obrázok 2-15: Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál



Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál umožňuje vidieť hladinu kvapaliny v každom podnose a svetlá majú počas normálnej prevádzky neprerušovanú bielu farbu.

Svetlá tiež označujú aktuálny stav každej nádoby na nebalený materiál:

- Ak je nádoba na nebalený materiál takmer prázdna alebo je nádoba na odpad takmer plná, jej biele svetlo bliká.
- Ak je nádoba na nebalený materiál prázdna alebo je nádoba na odpad plná, čo má vplyv na aktuálny chod, jej osvetlenie svieti načerveno.
- Keď sa nádoba na nebalený materiál vyberie, jej podsvietenie sa vypne a jej osvetlenie štítku v priehradke modulu spracovania bliká bielou farbou.



Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál bude fungovať iba so softvérom BOND 6.0 alebo novším.

Pozrite si tiež časť [5.1.3.6 Stav nádoby na nebalený materiál](#), kde nájdete údaje o tom, ako sú nádoby na nebalený materiál znázornené na obrazovke **Systems status** (Stavov systému).

2.2.7.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX má jediné dvere, ktoré otvárajú smerom nadol na prístup k nádobám na nebalený materiál. Dvere majú priehľadný panel, ktorý vám umožňuje zobrazíť hladiny reagencií v nádobách na nebalený materiál (ktoré sú tiež priehľadné).

Dvere sú držané magnetickými západkami. Ak chcete otvoriť dvere na predchádzajúcich moduloch spracovania (bez rukoväti), potiahnite za hornú časť každej strany dverí.



Dvere priehradky na nádoby na nebalený materiál musia zostať počas farbenia zatvorené. Ak sú dvere otvorené, na stavovej obrazovke systému sa objaví indikácia s upozornením (pozrite si časť [5.1.2 Stav hardvéru](#)) a akékoľvek súčasné cykly sa môžu pozastaviť.

Odpad z modulu spracovania sa čerpá do nádob na štandardný alebo nebezpečný odpad v závislosti od stavu reagentie v odpade (ak je to vhodné, musíte nastaviť vaše vytvorené reagentie ako nebezpečné – pozrite si časť [8.2.1 Pridanie alebo úprava reagentie](#)).

Nádoby na nebalené reagentie BOND-MAX majú snímače hladiny kvapaliny, ktoré upozorňujú na nízku hladinu reagentie. Nádoby na odpad tiež obsahujú snímače hladiny kvapaliny, ktoré upozornia na príliš vysokú úroveň odpadu. Pozrite si časť [12.2 Nádoby na nebalený materiál](#), kde nájdete pokyny týkajúce sa dopĺňania a vyprázdňovania.

Systém BOND-MAX má priestor pre nasledujúce nádoby v poradí zľava doprava:

Stanica	Nádoba	Veľkosť (L)	Farba	Reagent (Reagencia)
1	Nebezpečný odpad	2	Hnedá	Nebezpečný odpad
2	ER1	1	Fialová	BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3	ER2	1	Svetlo fialová	BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4	Roztok na odvoskovanie	2	Červená	BOND Dewax Solution*
5	Deionizovaná voda	2	Modrá	Deionizovaná voda
6	Premývací pufer	2	Zelená	BOND Wash Solution*
7	Etanol	2	Oranžová	Etanol (reagenčného stupňa)

*Používajte iba reagentie BOND – nenahrádzajte ich inými produktmi.

Nádoby na získavanie epitopov a/alebo nádoby na reagentie na odvoskovanie sa môžu z modulu spracovania odstrániť, ak sa nepoužívajú – pozrite si časť [10.6.1.1 Deaktivácia nádob na nebalené reagentie](#).

Obrázok 2-16: Nebalené reagentie BOND-MAX na svojom mieste




Uistite sa, že sa farba štítku každej nádoby na nebalený materiál a vytlačený popis zhodujú so štítkom na dutine modulu spracovania hneď

Nádoba na externý odpad

Súčasťou balenia je deväťlitrová externá nádoba na štandardný odpad BOND-MAX. Kontajnery dodávané s modulmi spracovania pred aktuálnym modelom majú pripojenia kvapalinového a hladinového snímača v jednom uzávere nádoby, ktorý sa používa na vyprázdnenie nádoby. Nádoby dodávané s aktuálnym modelom BOND-MAX majú dva uzávery – jeden pre konektory a druhý pre vyprázdňovanie odpadu. Nikdy neodstraňujte uzáver konektora z týchto nádob.

Dodávaná nádoba má dva uzávery – jeden pre konektory a druhý pre vyprázdňovanie odpadu. Nikdy neodstraňujte kryt konektora z tejto nádoby.

Obrázok 2-17: Nádoba na externý odpad BOND-MAX

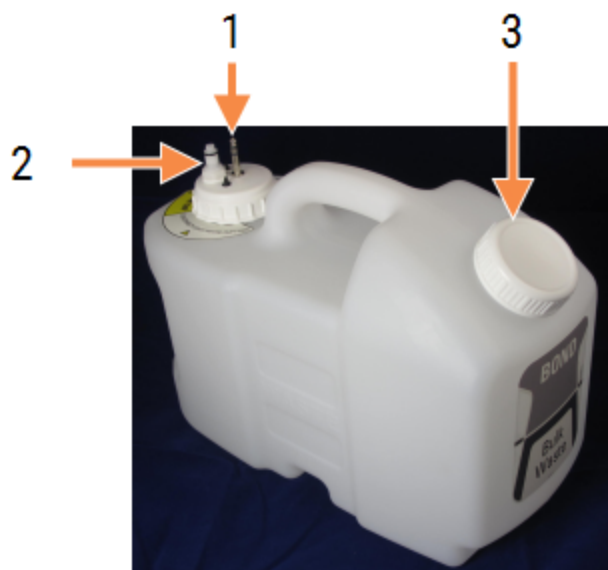

Legenda

- 1 Konektor snímača
- 2 Kvapalinový konektor
- 3 Otvor na vyprázdnenie nádoby

Hadičky na kvapaliny sa pripájajú k zásuvnému konektoru v pravom dolnom rohu zadného krytu modulu spracovania. Snímač hladiny kvapaliny sa pripája k trojkolíkovému konektoru v ľavej hornej časti zadného krytu (pozrite si [Obrázok 2-25](#)).

Pozrite si časť **12.2.4 Nádoba na externý odpad (len BOND-MAX)**, kde nájdete pokyny na vyprázdňovanie a údržbu externej nádoby.



POZOR: Pred vyprázdnením nádoby na externý odpad vždy odpojte konektory snímača a kvapaliny (v tomto poradí). Nepokúšajte sa naliať tekutinu z nádoby, keď sú kábel a hadička stále pripojené.



VÝSTRAHA: Niektoré z reagensí používaných v imunohistochemickom rozbere a in situ hybridizácii sú nebezpečné. Pred pokračovaním sa uistite, že ste absolvovali primerané školenie pre tento postup:

- 1 Pri manipulácii s reagensiami alebo čistení modulu spracovania používajte latexové alebo nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iný vhodný ochranný odev.
- 2 S reagensiami a kondenzátom manipulujte a likvidujte ich v súlade so všetkými príslušnými postupmi a štátnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratóriu.




VÝSTRAHA: Niektoré reagensie použité na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX sú horľavé:

- Neumiestňujte plameň ani zdroj zapálenia do blízkosti modulov spracovania.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.

2.2.8 Nasávacia sonda

Nasávacia sonda nasáva reagentie z nádob, dodáva reagentie na podložné sklíčka v zostavách na farbenie sklíčok a zmiešava chromogény v zmiešavacej stanici. Obsahuje snímač hladiny kvapaliny na detekciu hladiny reagentie (pozrite si časť [8.3.1 Stanovenie objemu reagentie](#)).

Obrázok 2-18: Nasávacia sonda v ramene robota

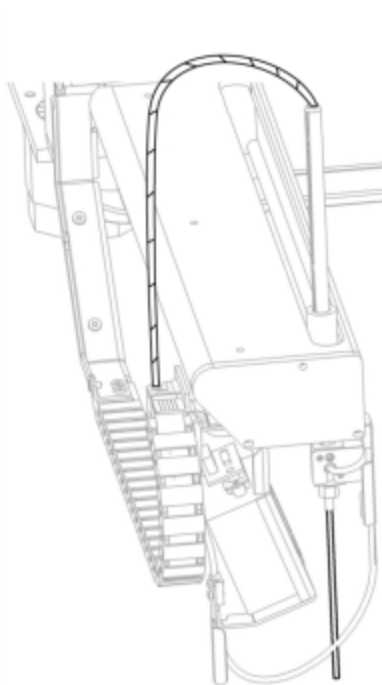


V každej nádobe je zvyškový objem, ktorý sonda nedokáže dosiahnuť. Tento objem sa označuje ako „mŕtvy objem“. Mŕtvy objem je odlišný pre každý typ nádoby (pozrite si časť [18.5 Prevádzkové špecifikácie](#) v kapitole [18 Technické údaje](#), kde sa uvádzajú hodnoty mŕtveho objemu).

Pozrite si časť [12.6 Nasávacia sonda](#) pre pokyny na údržbu nasávacej sondy.

2.2.9 Premývací blok a zmiešavacia stanica

Obrázok 2-19: Premývací blok s vloženou zmiešavacou stanicou

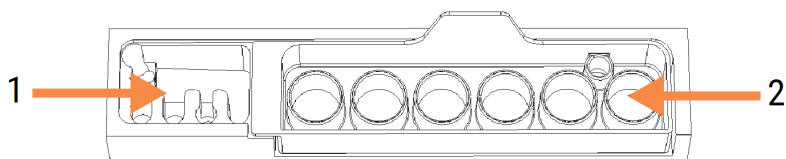

Legenda

- 1 Premývacia oblasť
- 2 Zmiešavacia stanica

Oblasť na umývanie na ľavej strane obsahuje malé otvory na umývanie nasávacej sondy.

Pravá časť premývacieho bloku obsahuje zmiešavaciu stanicu, ktorá pozostáva zo šiestich dutín. Ide o zmiešavacie fľaštičky na reagencie s krátkou životnosťou, ktoré sa musia zmiešať bezprostredne pred použitím. Miešanie reagentov je určené softvérom v závislosti od typu reagentu.



Softvér BOND sleduje stav zmiešavacej stanice a neinicializuje systém BOND-III alebo BOND-MAX, ak je sledovaný stav stanice iný ako čistý a prázdny (pozrite si časť [5.1.2 Stav hardvéru](#)). Ak si počas inicializácie všimnete, že je zmiešavacia stanica znečistená alebo obsahuje tekutinu, pred kliknutím na tlačidlo **OK** v dialógovom okne s oznámením zabezpečte, aby bola čistá a prázdna. Ak budete pokračovať so špinavou a/alebo neprázdnu zmiešavacou stanicou, môžu sa kontaminovať reagenty alebo by mohlo dôjsť k pretečeniu zmiešavacích fľaštičiek.




Počas inicializácie systém BOND naskenuje štítok na zmiešavacej stanici na overenie či je prítomná. Ak softvér BOND nedokáže zistiť tento identifikátor, potom sa zobrazí správa s výzvou na potvrdenie, že je k dispozícii zmiešavacia stanica.

Pozrite si časť [12.7 Premývací blok a zmiešavacia stanica](#), kde nájdete pokyny na údržbu zmiešavacej stanice.

2.2.10 Roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III)

Obrázok 2-20: Robot na nebalenú tekutinu BOND-III (1) sa pohybuje pozdĺž vodiacej koľajnice (2) na každej zostave na farbenie sklíčok.

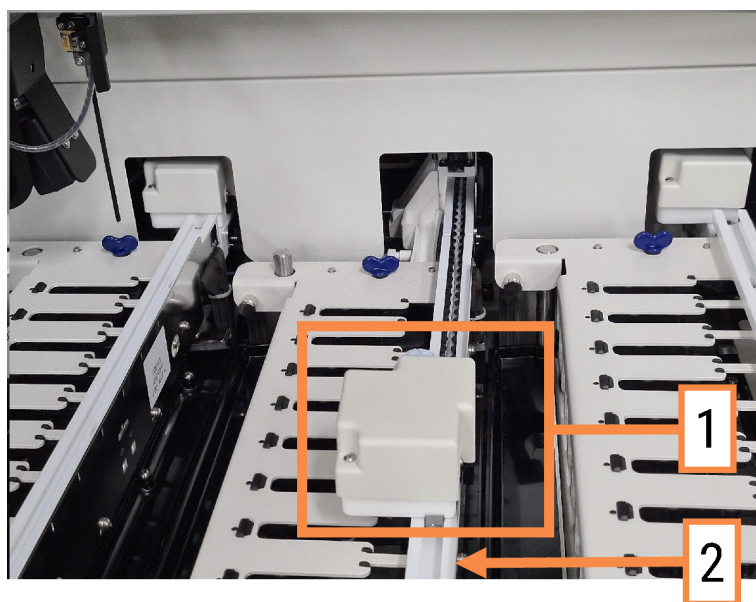

VÝSTRAHA: Ak hlavný robot a/alebo roboty na nebalenú tekutinu naďalej fungujú dlhšie ako 5 sekúnd po otvorení veka modulu spracovania, okamžite sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.

Modul spracovania BOND-III má tri roboty na nebalenú tekutinu, ktoré sa pohybujú pozdĺž vodiacej koľajnice na každej zostave na farbenie sklíčok a dávkujú reagencie na všetky prítomné sklíčka. Roboty dodávajú iba nebalené reagencie, zatiaľ čo nasávací sonda dávkuje reagencie z platformy nádob na reagencie a niektorých nebalených reagentoch. Každý robot na nebalenú tekutinu má premývací blok na prepláchnutie a vyčistenie dávkovacej sondy.

2.2.10.1 Manuálne vrátenie robota na nebalenú tekutinu do východiskovej polohy


Ak robot na nebalenú tekutinu prestane fungovať a je umiestnený pozdĺž zostavy na farbenie sklíčok, stlačením tlačidla Load/Unload (Vložiť/vybrať) ho vráťte do pôvodnej polohy. Ak zostane na zostave na farbenie sklíčok, vykonajte nasledujúce kroky, aby ste ho ručne vrátili do východiskovej polohy a získali všetky sklíčka v zostave na farbenie sklíčok.

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný a nemá naplánované ani nespracováva žiadne cykly, až potom ho vypnite.
- 2 Opatrne nadvihnite dávkovací blok na robote na nebalenú tekutinu (pozrite si [Obrázok 2-21](#)), kým sonda nevyčistí hornú dosku.

- 3 Zatlačte robota pozdĺž koľajnice dozadu zostavy na farbenie sklíčok. Použite pomalý a rovnomerný pohyb – netlačte príliš rýchlo.

Zatlačte, kým sa robot nedostane z koľajnice hornej dosky – **netlačte** ho dozadu až na doraz.

Obrázok 2-21: Zdvihnutie dávkovacieho bloku

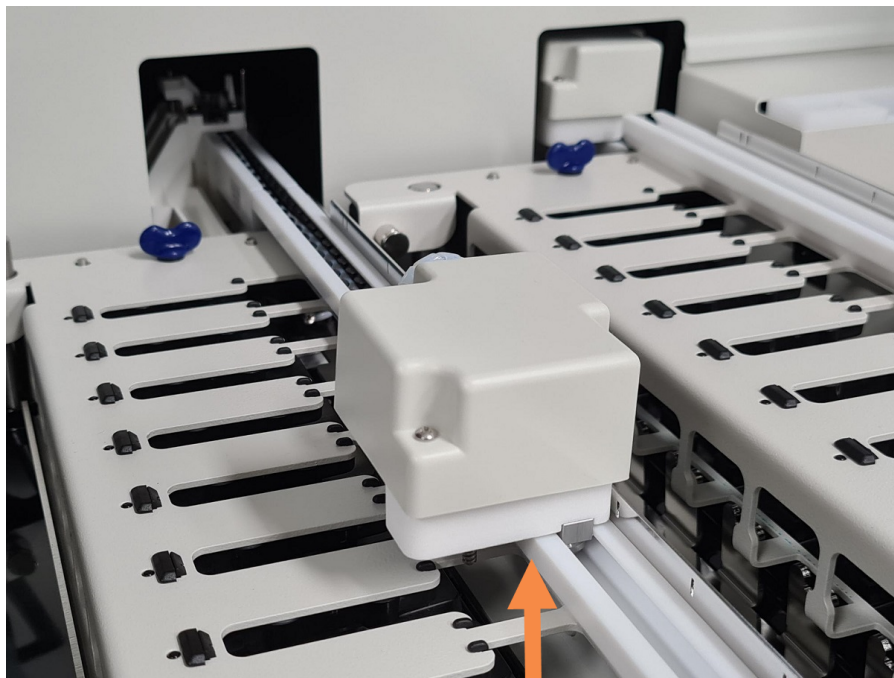

- 4 Keď je robot mimo hornej dosky, zatvorte veko a zapnite modul spracovania. Zostava na farbenie sklíčok sa má odomknúť ako súčasť inicializačného postupu.

Ak sa zostava na farbenie sklíčok neodomykne, pozrite si časť [12.4.1 Ručné odomykanie zostáv na farbenie sklíčok](#), kde nájdete pokyny týkajúce sa získania podnosov na sklíčka.

- 5 Vyberajte podnos na sklíčka a sklíčka.

2.2.11 Injekčné striekačky

Injekčné striekačky nasávajú a dávajú presné objemy tekutín reagencie, ktoré vyžaduje systém BOND. Pozrite si časť [12.13 Injekčné striekačky](#), kde nájdete pokyny na údržbu injekčných striekačiek.




VÝSTRAHA: Skontrolujte, či sú počas normálnej prevádzky dverka injekčných striekačiek zatvorené (BOND-MAX) alebo je nasadený kryt injekčných striekačiek (BOND-III). Ak dôjde k uvoľneniu injekčnej striekačky alebo príslušenstva injekčnej striekačky, môže z injekčnej striekačky vystreknúť reagentia pod tlakom.

2.2.11.1 BOND-III

Systém BOND-III má štyri pumpy injekčných striekačiek umiestnené pod predným krytom. Prvé tri pumpy injekčných striekačiek (zľava doprava) používajú roboty na nebalenú tekutinu na SSA1, SSA2 a SSA3 vyššie. Štvrtú hlavnú pumpu injekčných striekačiek používa nasávací sonda.

Obrázok 2-22: Injekčné striekačky BOND-III

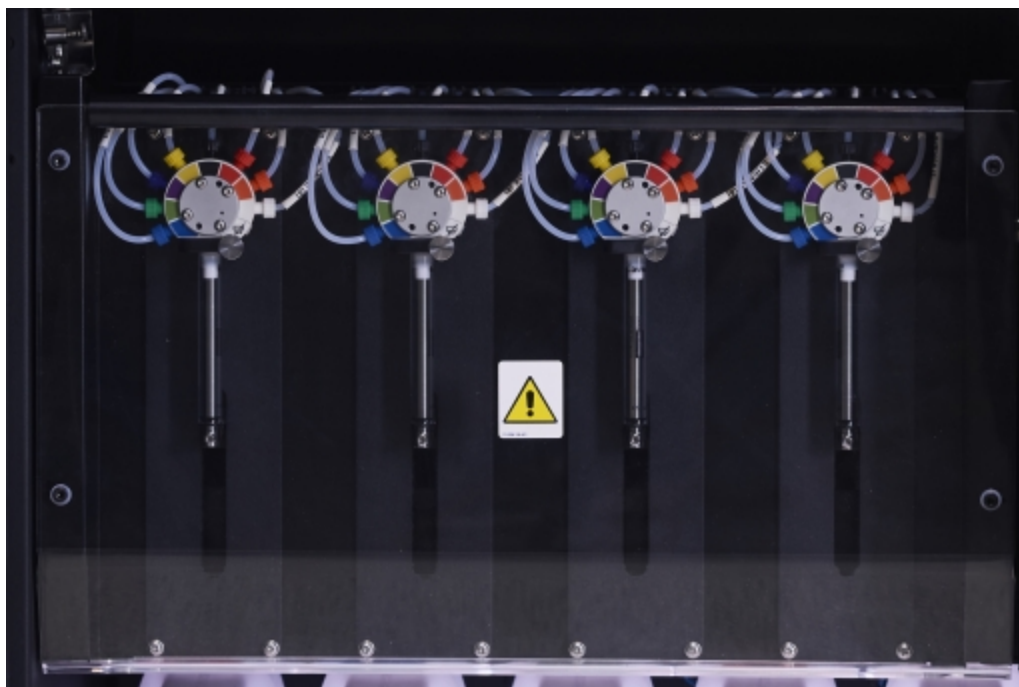

POZOR: Pred spustením cyklu alebo inicializáciou modulu spracovania sa uistite, že je modul injekčných striekačiek úplne zatvorený (pozrite si časť [12.4.1 Ručné odomykanie zostáv na farbenie skliček](#)). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu injekčných striekačiek počas prevádzky.

2.2.11.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX má jednu pumpu injekčných striekačiek umiestnenú v komore na pravej strane modulu spracovania. Ide o 9-portový ventil injekčných striekačiek (jeden port sa nepoužíva) s naskrutkovaným valcom striekačky a malou svorkou.

Obrázok 2-23: 9-portová injekčná striekačka BOND-MAX



Na kontrolu stavu injekčnej striekačky otvorte dvierka stlačením a uvoľnením zaoblenej plôšky v strede prednej časti dvierok.



VÝSTRAHA: Vždy noste ochranný odev a rukavice.

Počas inicializácie ich pravidelne kontrolujte a podľa potreby ich vymeňte – pozrite si časť [12.13 Injekčné striekačky](#).

2.2.12 Vypínač

Jeden kolískový prepínač je umiestnený na pravom kryte modulu spracovania. Používa sa na zapnutie a vypnutie modulu spracovania.

- Umiestnenie vypínača na systéme BOND-III si pozrite na [Obrázok 2-24](#).
- Umiestnenie vypínača na systéme BOND-MAX si pozrite na [Obrázok 2-25](#).

2.2.13 Zadný kryt



VÝSTRAHA: Neodstraňujte kryty modulu spracovania ani sa nesnažte získať prístup k vnútorným komponentom. Vo vnútri modulu spracovania BOND sú nebezpečné napätia a tieto úlohy by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici schválení spoločnosťou Leica Biosystems.

2.2.13.1 BOND-III

Obrázok 2-24 znázorňuje zadný obal modulu spracovania BOND-III.

Obrázok 2-24: Zadný kryt BOND-III



Legenda

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | Ističe (len staršie moduly spracovania) | 3 | Sieťové pripojenie |
| 2 | Poistky | 4 | Ethernetové pripojenie |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Staršie moduly spracovania – 4 poistky • Alternatívne moduly spracovania – 2 poistky | | |

Pokyny na výmenu poistiek si pozrite v časti [12.14 Poistky napájania](#).




VÝSTRAHA: Na zdvihnutie modulu spracovania nepoužívajte dve čierne rukoväti na zadnom obale systému BOND-III.

2.2.13.2 BOND-MAX

Obrázok 2-25 znázorňuje zadný obal modulu spracovania BOND-MAX. (Upozorňujeme, že staršie modely modulov spracovania majú iba jeden ventilátor napájania.)

Obrázok 2-25: Zadný kryt BOND-MAX

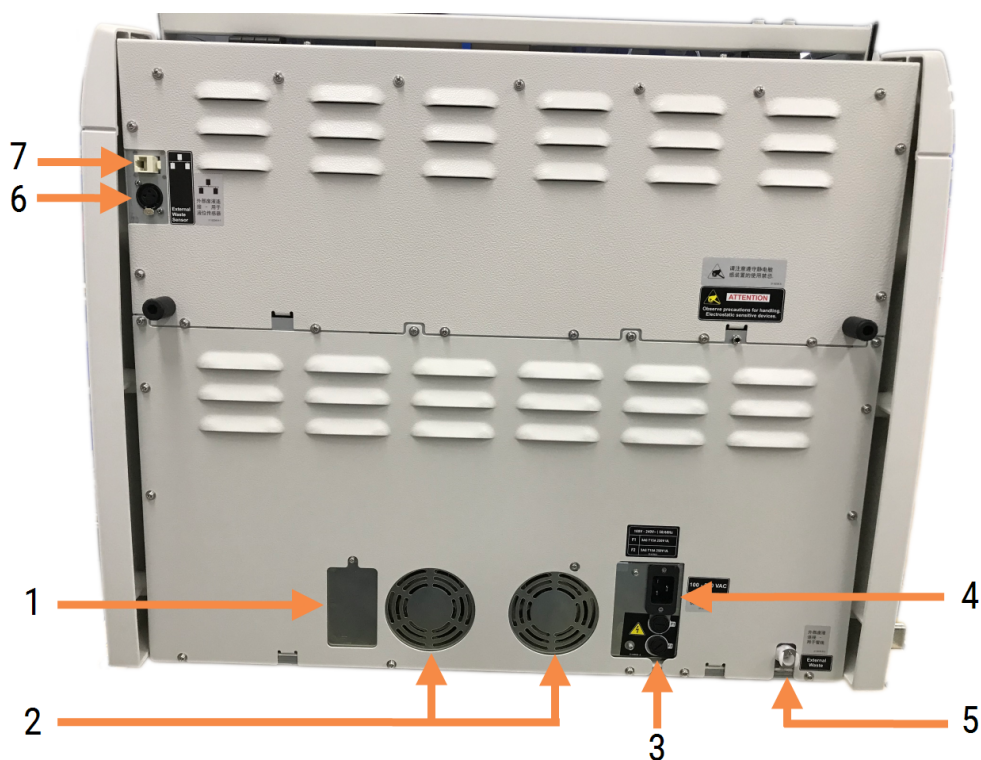

Legenda

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Ističe (len staršie moduly spracovania) | 5 | Pripojenie externého odpadu – pre hadičky (pozrite si časť 12.2.4 Nádo­ba na externý odpad (len BOND-MAX)) |
| 2 | Ventilátory napájania | 6 | Pripojenie externého odpadu – pre snímač hladiny kvapaliny (pozrite si časť 12.2.4 Nádo­ba na externý odpad (len BOND-MAX)) |
| 3 | Poistky <ul style="list-style-type: none"> • Staršie moduly spracovania – 4 poistky • Alternatívne moduly spracovania – 2 poistky | 7 | Ethernetové pripojenie |
| 4 | Sieťové pripojenie | | |

Pokyny na výmenu poistiek si pozrite v časti [12.14 Poistky napájania](#).

2.2.13.3 Odpojenie modulu spracovania

Pri odpojení modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX od sieťového zdroja postupujte takto:

- 1 Vypnite napájanie pomocou prepínača na pravej strane modulu spracovania.
- 2 Nájdite napájací kábel, ktorý vedie zo sieťového konektora napájacieho modulu spracovania (položka 3 na [Obrázok 2-24](#) a položka 4 na [Obrázok 2-25](#)) do steny. Vypnite sieťové napájanie na zásuvke.
- 3 Odpojte zástrčku zo zadnej časti modulu spracovania.

2.3 Riadiace zariadenie a terminály BOND

Súčasťou všetkých systémov BOND je riadiace zariadenie BOND, kde sa vykonáva celé softvérové spracovanie. V inštaláciách s jednou stanicou (pozrite si časť [3.1.1 Konfigurácia s jednou stanicou](#)) sa na spustenie klientskeho softvéru používa jedno riadiace zariadenie s klávesnicou, myšou a monitorom. Inštalácie s jednou stanicou sú vhodné na prevádzku piatich alebo menšieho počtu modulov spracovania.

Laboratóriá s inštaláciami BOND-ADVANCE (pozrite si časť [3.1.2 BOND-ADVANCE](#)), ktoré majú viac ako päť modulov spracovania, majú navyše terminály BOND. V týchto inštaláciách sa väčšina interakcií používateľov so softvérom BOND vykonáva na termináloch, z ktorých každý môže ovládať ľubovoľný alebo všetky moduly spracovania. Je tiež možné ovládať rovnaké moduly spracovania z viac ako jedného terminálu.

Riadiace zariadenie BOND aj naďalej vykonáva všetky procesy spracovania softvéru. Riadiace zariadenia v inštaláciách BOND-ADVANCE majú vyššiu špecifikáciu ako tie, ktoré sa používajú v inštaláciách s jednou stanicou, a zahŕňajú viac úrovní redundancie, aby sa zabezpečila vynikajúca spoľahlivosť.

Súčasťou niektorých inštalácií BOND-ADVANCE je sekundárne (záložné) riadiace zariadenie. Toto riadiace zariadenie zaznamenáva všetky procesy na primárnom riadiacom zariadení a môže sa naň prepnúť v prípade zlyhania primárneho riadiaceho zariadenia. V ideálnom prípade by sa sekundárne ovládače nemali nachádzať v blízkosti primárneho riadiaceho zariadenia, aby sa znížila pravdepodobnosť poškodenia oboch riadiacich zariadení lokalizovanou udalosťou.

Tlačiareň štítkov sklíčok a ručná čítačka čiarových kódov sú pripojené k riadiacemu zariadeniu v inštaláciách s jednou stanicou alebo ku každému terminálu v inštaláciách BOND-ADVANCE.



POZOR: Operačný systém a softvér na riadiacom zariadení BOND je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne riadenie systému BOND. Neinštalujte do systému žiadny dodatočný softvér, aby ste predišli možnému oneskoreniu alebo rušeniu riadenia riadiaceho zariadenia alebo terminálu BOND.

2.4 Ručná čítačka čiarových kódov

Obrázok 2-26: Ručná čítačka čiarových kódov



Ručné čítačky čiarových kódov USB sú pripojené k riadiacemu zariadeniu (inštalácie s jednou stanicou) alebo k terminálom (inštalácie BOND-ADVANCE). Používajú sa na registráciu reagencií a môžu sa tiež použiť na identifikáciu sklíčok (pozrite si časť [6.5.6 Manuálna identifikácia sklíčka](#)).

Vytváranie čiarových kódov 1D a OCR nie je podporované od verzie 7 softvéru BOND.

Ak aktualizácia systému obsahuje modul spracovania BOND-PRIME, musíte použiť čítačku 2D čiarových kódov. Pozrite si časť [13.1.2 Čítačka čiarových kódov Zebra DS2208](#).

Ručná čítačka čiarových kódov by mala byť nainštalovaná a funkčná, keď je nainštalovaný váš systém BOND. Pokyny na údržbu a konfiguráciu nájdete v časti [13.1 Ručné čítačky čiarových kódov](#).

2.4.1 Používanie ručnej čítačky čiarových kódov

Ak chcete načítať čiarový kód, nasmerujte naň čítačku a stlačte spúšť. Zarovnajte ju tak, aby červená čiara zasahovala celú dĺžku čiarového kódu. Keď čítačka rozpozná čiarový kód, zapípa a ukazovateľ sa rozsvieti nazeleno. Keď čítačka nerozpozná čiarový kód, zapípa a ukazovateľ sa rozsvieti načerveno.



Čiarové kódy nedržte príliš blízko čítačky. Ak skener nerozpozná čiarový kód, skúste čiarový kód posunúť ďalej alebo skenujte čiarový kód pod uhlom 45 ° (aby ste zabránili spätnej väzbe na skener).

Keď je čítačka umiestnená v stojane, používa sa bez použitia rúk a pri čítaní čiarového kódu nemusíte stlačiť spúšť.

2.5 Značkovač sklíčok

Súčasťou systémov s jednou stanicou BOND je jedna tlačiareň štítkov sklíčok (nazývaná „značkovač sklíčok“) pripojená k riadiacemu zariadeniu. V inštaláciách BOND-ADVANCE je ku každému terminálu pripojený samostatný značkovač sklíčok.

Značkovače sklíčok tlačia nalepovacie štítky, ktoré sa nalepia na sklíčka na účely identifikácie. Všetky štítky obsahujú jedinečné identifikátory sklíčok vykreslené ako 2D čiarové kódy (pozri [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)). Systém BOND používa identifikátory na automatické identifikovanie sklíčok, keď sú vložené do modulov spracovania. Môžete nakonfigurovať ďalšie informácie, ako aj identifikátory, aby sa zobrazovali na štítkoch – pozrite si časť [10.3 Labels \(Štítky\)](#).

Niektoré laboratóriá používajú štítky sklíčok vytlačené zo svojich systémov LIS, značkovač sklíčok BOND je však stále súčasťou týchto systémov pre všetky sklíčka vytvorené pomocou klinického klienta BOND.

Značkovače sklíčok sú nastavené ako súčasť štandardnej inštalácie BOND. Ak pridáte alebo vymeníte značkovač sklíčok, nakonfigurujte ho na obrazovke **Hardware** (Hardvér) klienta správy (pozrite si časť [10.6.3 Značkovače sklíčok](#)). Informácie o doplnení štítkov a pások a čistení si prečítajte v dokumentácii dodávanej spolu so značkovačom.



VÝSTRAHA: Používajte iba štítky sklíčok a tlačovú pásku BOND. Tieto štítky musia zostať počas spracovania na moduloch spracovania BOND pripevnené a čitateľné.

2.6 Pomocné vybavenie

V tejto časti je opísané pomocné vybavenie používané so systémom BOND.

- [2.6.1 Sklíčka](#)
- [2.6.2 Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles](#)
- [2.6.3 Systémy a nádoby na reagencie](#)

Informácie o spotrebnom materiáli pre systém BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

2.6.1 Sklíčka

Na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX používajte iba sklenené sklíčka správnej veľkosti. Sklíčka nesprávnej veľkosti nemusia správne sedieť na podnosoch na sklíčka a krycie sklíčka Covertile na nich nebudú správne sedieť. Obidve tieto situácie môžu ovplyvniť kvalitu farbenia.

Spoločnosť Leica Biosystems odporúča sklíčka Leica BOND Plus a Apex BOND, ktoré sú navrhnuté na použitie so systémom BOND. Okrem toho, že majú optimálnu veľkosť pre podnosy na sklíčka BOND a krycie sklíčka Covertile, sú tieto pozitívne nabité sklíčka označené tak, aby zobrazovali oblasti, kde by sa tkanivo malo umiestniť na 100µl a 150µl dávkovanie (pozrite si časť [6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach](#)).

Ak používate vlastné sklíčka, musia spĺňať nasledujúce špecifikácie:

Rozmery	Šírka: 24,64 – 26,0 mm (0,97 – 1,02 palca) Dĺžka: 74,9 – 76,0 mm (2,95 – 2,99 palca) Hrúbka: 0,8 – 1,3 mm (0,03 – 0,05 palca)
Oblasť štítkov	Šírka: 24,64 – 26,0 mm (0,97 – 1,02 palca) Dĺžka: 16,9 – 21,0 mm (0,67 – 0,83 palca)
Materiál	sklo, ISO 8037/1



POZOR: Nepoužívajte poškodené sklíčka. Pred vložením do modulu spracovania sa uistite, že sú všetky sklíčka správne zarovnané na podnosoch na sklíčka.



POZOR: Nepoužívajte sklíčka so zaoblenými alebo orezanými rohmi. Tieto sklíčka môžu spadnúť cez podnos na sklíčka a môžu zmeniť tok tekutiny pod krycím sklíčkom Covertile, čo ovplyvní kvalitu farbenia.

2.6.2 Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles

Krycie sklíčka BOND Universal Covertiles sú priehľadné plastové kryty, ktoré sa počas farbenia ukladajú na podložné sklíčka. Kapilárne pôsobenie nasáva reagenciu dávkanú na sklíčka medzi krycie sklíčka Covertile a podložné sklíčka, čím sa zaistí jemné a rovnomerné pokrytie tkaniva. Krycie sklíčka Covertiles minimalizujú potrebné objemy reagencie a chránia sklíčka pred vyschnutím medzi aplikáciami. Krycie sklíčka Covertiles sú podstatnou súčasťou systému farbenia BOND a musia sa vždy používať.


Po umiestnení sklíčok na podnosy na sklíčka ich zakryte kryciami sklíčkami Covertile (pozrite si časť [4.1.3.5 Vkladanie sklíčok](#)). Uistite sa, že krycie sklíčka sú správne umiestnené tak, aby výčnelok v hrdle každého krycieho sklíčka Covertiles (zakrúžkovaný na fotografii vpravo) zapadol do priehlbiny na podnose na sklíčka.



Existujú dve vyhotovenia krycích sklíčok Covertile – môžu sa navzájom zamieňať.

Nový dizajn obsahuje prvky (slovo **Leica**, malú kruhovú značku a výčnelok v ľavom hornom rohu), vďaka ktorým sa dá ľahšie rozpoznať, keď je na podložnom sklíčku nesprávne umiestnené krycie sklíčko Covertile.

Obrázok 2-27: Krycie sklíčko BOND Universal Covertile (pôvodný dizajn)

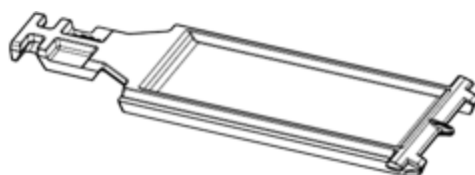

Obrázok 2-28: Krycie sklíčko BOND Universal Covertile (nový dizajn)



Krycie sklíčka Covertile sa môžu opätovne použiť až 25-krát za predpokladu, že nie sú výrazne odfarbené alebo poškodené a ak sú správne vyčistené (pozrite si časť [12.3 krycie sklíčka Covertile](#)). Poškodené krycie sklíčka Covertiles zlikvidujte.


Niektoré analýzy vyžadujú použitie nových (nepoužitých) krycích sklíčok Covertile. Najskôr si prečítajte príslušné návody na použitie pre daný test.

2.6.2.1 Podnosy na sklíčka

Použite podnosy na sklíčka na pridržiavanie sklíčok a krycích sklíčok Covertile v ich polohe, keď ich vkladáte do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX. Do každého podnosu môžete vložiť desať sklíčok.

Existujú dve vyhotovenia podnosov na sklíčka – môžu sa navzájom zamieňať.

Obrázok 2-29: Podnos na sklíčka (nový dizajn (vľavo) a starý dizajn (vpravo))

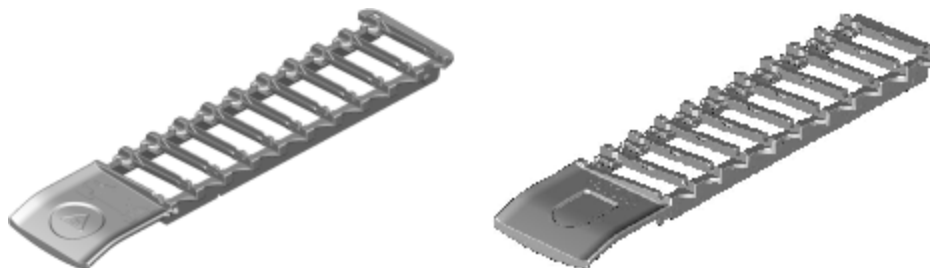


Pokyny na vkladanie sklíčok a krycích sklíčok Covertile do modulu spracovania nájdete v časti [4.1.3.5 Vkladanie sklíčok](#).

2.6.2.2 Podnosy na reagentie

Do podnosov na reagentie sa zmestia 7ml a 30ml BOND nádoby na reagentie a 6ml BOND titračné nádoby. Podnosy sa vkladajú do modulu spracovania na platforme reagentií (pozrite si časť [2.2.6.5 Platforma reagentií](#)).

Obrázok 2-30: Podnos na reagentie

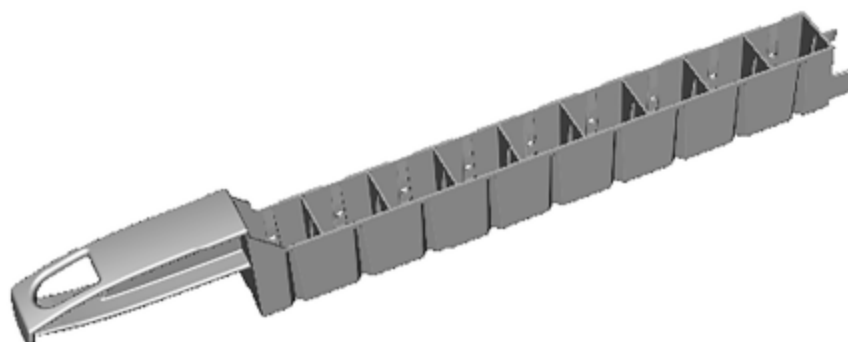

Polohy nádob v podnosoch na reagentie sú očíslované od konca, ktorý je najďalej od rukoväti (poloha 1), po polohu najbližšiu k rukoväti (poloha 9).

Pokyny na vkladanie reagentií do modulu spracovania nájdete v časti [4.1.4 Vkladanie reagentií](#).

2.6.3 Systémy a nádoby na reagentie

V podnosoch na reagentie sa môže použiť celý rad typov nádoby na reagentie.

2.6.3.1 Systémy reagentií

Systémy reagentií sú preddefinované súpravy reagentií v podnose na reagentie. Systém BOND môže používať dva typy systémov reagentií:

- Detekčné systémy BOND
- Čistiace systémy BOND

Pozrite si časť [8.1 Prehľad správy reagentií](#), kde nájdete ďalšie detaily o každom z nich.

Systém reagentií sa registruje skenovaním čiarových kódov na boku podnosu na reagentie, a nie skenovaním štítkov s čiarovými kódmi na každej nádobe z jeho komponentov. Nádoby na reagentie, ktoré tvoria systém, nie sú jednotlivo zaregistrované, sú zamknuté na podnose a nemali by sa vyberať ani by sa nemalo meniť ich usporiadanie. Ak je systém reagentií vyčerpaný alebo expiruje jeho platnosť, vyhodte celý podnos aj nádoby.

2.6.3.2 Hotové reagentie BOND

Hotové reagentie BOND používajú nádoby, ktoré sa zmestia do podnosov na reagentie. Tieto reagentie sa poskytujú v koncentráciách optimalizovaných pre systém BOND, preto sa pred použitím vyžaduje iba registrácia a otvorenie.

Nádoby obsahujú rôzne objemy reagentie od 3.75ml do 30ml v závislosti od typu reagentie.

2.6.3.3 Otvorené nádoby

Otvorené nádoby sú prázdne, čisté nádoby na uchovávanie reagentie dodávané používateľom (napríklad primárnej protilátky). Sú k dispozícii vo veľkosti 7ml a 30ml. Otvorené nádoby sa môžu používať iba s jednou reagentiou a môžu sa znovu naplniť tak, aby sa v každej nádobe podávalo maximálne 40ml reagentie (pozrite si časť [8.3.2.4 Dopĺňanie otvorenej nádoby na reagentie](#)).

Na systéme BOND sa majú používať iba otvorené nádoby BOND – nepokúšajte sa používať iné nádoby (okrem titračných nádob) na reagentie dodávané používateľom.

2.6.3.4 Titračné nádoby

Dostupné sú aj titračné nádoby na špeciálne účely (pozrite si časť [14.2.1.4 Titračná súprava](#)). Ich súčasťou je 6ml vymeniteľná vložka, takže reagentia v nádobe sa môže ľahko vymeniť, napríklad počas optimalizácie koncentrácie. Rovnako ako otvorené nádoby možno každú titračnú nádobu naplniť a použiť na dodanie až 40 ml reagentie. V titračnej súprave BOND je k dispozícii päť vložiek na nádobu a dodáva ich spoločnosť Leica Biosystems.

Súpravy sa môžu opätovne použiť na rôzne protilátky a sú navrhnuté s minimálnym mŕtvym objemom na zachovanie reagentie.

2.7 Premiestnenie modulu spracovania



VÝSTRAHA: Ak chcete premiestniť modul spracovania na veľkú vzdialenosť alebo ho prepraviť na účely opravy alebo likvidácie, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka. Modul spracovania je ťažký a nie je navrhnutý tak, aby ho presúval používateľ.



POZOR: Neblokujte vetracie otvory umiestnené na zadnom obale modulu spracovania. Nezakrývajte tiež vetracie otvory umiestnené na dverkách injekčných striekačiek (BOND-MAX).

Ak premiestňujete modul spracovania BOND na krátku vzdialenosť, pred pokračovaním zväzte nasledujúce body:

- Uistite sa, že je podlaha schopná uniesť hmotnosti modulu spracovania. Pozrite si časť **18.2 Fyzické špecifikácie** v časti **18 Technické údaje**, kde nájdete rozmery, a pred premiestnením si prečítajte miestne požiadavky.
- Pred prevádzkou modulu spracovania vyhodnoťte elektromagnetické prostredie na posúdenie rušenia.
- Nepoužívajte modul spracovania BOND v tesnej blízkosti zdrojov silného elektromagnetického žiarenia. Napríklad netienené zámerné RF zdroje, ktoré môžu rušiť správnu prevádzku.
- Modul spracovania BOND nezdvíhajte pomocou vysokozdvížneho vozíka.
- Používajte iba dodaný napájací kábel a zabezpečte, aby mal operátor prístup k napájaciemu pripojeniu, do ktorého je kábel zapojený.
- Pred premiestnením sa uistite, že sú napájací kábel a ethernetový kábel odpojené.
- Zabezpečte dostatočné vetranie.
- Pred premiestnením vyprázdnite nádoby na odpad.
- Dbajte na to, aby ste pred premiestnením odistili všetky štyri kolesá na module spracovania BOND-III (alebo vozíku v prípade systému BOND-MAX), a znova ich zaistíte, keď sa nachádzate na novom mieste.

2.8 Vyradenie z prevádzky a likvidácia prístroja

Prístroj vrátane použitých dielov a príslušenstva sa musí zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi postupmi a predpismi. Všetky reagenty použité s prístrojom zlikvidujte v súlade s odporúčaniami výrobcu reagentov.

Pred vrátením alebo likvidáciou prístroja alebo jeho častí a príslušenstva ho vyčistite a dekontaminujte v súlade s miestnymi postupmi a predpismi.

V EÚ musí byť všetok elektronický odpad zlikvidovaný v súlade s nariadením o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ). V regiónoch mimo EÚ dodržiavajte miestne postupy a predpisy týkajúce sa likvidácie elektronického odpadu.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Leica Biosystems.

3

Prehľad softvéru (na riadiacom zariadení BOND)

Táto kapitola je navrhnutá tak, aby vám pomohla zoznámiť sa so všeobecnými charakteristikami softvéru BOND. Pokyny na používanie softvéru na spúšťanie modulov spracovania a správu sklíčok, prípadov a reagencií nájdete v príslušných kapitolách. Pozrite si časť **10 Klient správy (na riadiacom zariadení BOND)**, kde nájdete pokyny pre klienta správy.

- [3.1 Architektúra systému](#)
- [3.2 Spustenie a vypnutie softvéru BOND](#)
- [3.3 Úlohy používateľa](#)
- [3.4 Prehľad rozhrania klinického klienta](#)
- [3.5 Ovládací panel BOND-ADVANCE](#)
- [3.6 Oznámenia, výstrahy a alarmy](#)
- [3.7 Správa](#)
- [3.8 Pomocník](#)
- [3.9 Informácie o systéme BOND](#)
- [3.10 Definície údajov systému BOND](#)
- [3.11 Aktualizácia softvéru](#)

3.1 Architektúra systému

Používatelia interagujú so softvérom BOND prostredníctvom dvoch „klientov“ – v skutočnosti sú to dva samostatné programy. Sú to klinický klient (alebo jednoducho „klient“) a klient správy. Klinický klient je určený na každodennú prevádzku – na nastavenie reagencií, protokolov, prípadov a sklíčok v rámci prípravy na spracovanie a potom na monitorovanie a kontrolu cyklov na module spracovania. Klient správy sa používa na konfiguráciu rozšírených nastavení, ktoré sa po úvodnom nastavení menia len zriedkavo. Patria sem konfigurácie štítkov sklíčok, hardvérové pripojenia a používateľské účty (pozrite si časť **10 Klient správy (na riadiacom zariadení BOND)**).


- **3.1.1 Konfigurácia s jednou stanicou**
- **3.1.2 BOND-ADVANCE**

3.1.1 Konfigurácia s jednou stanicou

Inštalácie s jednou stanicou majú len jedno „riadiace zariadenie BOND“, čo je jediný bod pre interakciu používateľa so softvérom BOND (a tým aj kontrolu modulov spracovania). Riadiace zariadenie BOND vykonáva všetky softvérové spracovania systému a udržiava databázu systému, kde sa uchovávajú informácie o prípadoch a sklíčkach. Má pripojenú klávesnicu, myš a monitor a tlačiareň štítkov sklíčok a čítačku.

V inštalácii s jednou stanicou existuje limit piatich modulov spracovania. Ak potrebujete viac modulov spracovania, prejdite na systém BOND-ADVANCE.

Obrázok 3-1: Schéma inštalácie s jednou stanicou

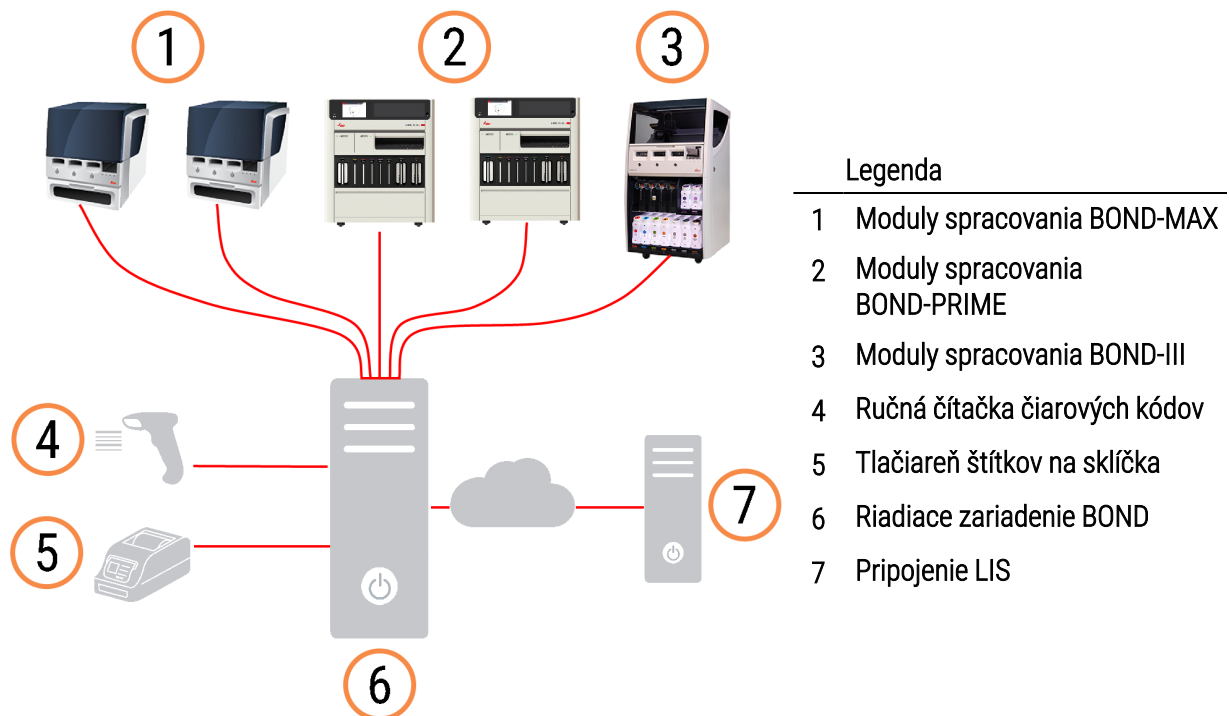


3.1.2 BOND-ADVANCE

Inštalácie BOND s viac ako piatimi modulmi spracovania sú nakonfigurované ako inštalácie BOND-ADVANCE s viacerými stanicami. Riadiace zariadenie BOND pokračuje vo všetkých procesoch spracovania softvéru pre celý systém, ale väčšina vstupov pochádza z terminálov BOND-ADVANCE umiestnených v blízkosti pracovných buniek modulu spracovania (v softvéri BOND sa nazývajú „súbory“), ktoré kontrolujú. Súbory sú definované v klientovi správy.

Monitor pripojený k riadiacemu zariadeniu zobrazuje “ovládací panel systému BOND”, ktorý poskytuje zhrnutie stavu modulu spracovania v systéme v reálnom čase každého (pozrite si časť [3.5 Ovládací panel BOND-ADVANCE](#)). Ovládací panel sa môže na požiadanie pripojiť aj k vyhradenému terminálu. Klienta správy je možné spustiť z ľubovoľného terminálu.

Niektoré laboratóriá môžu mať sekundárne riadiace zariadenie, ktoré zálohuje všetky údaje zo systému BOND v reálnom čase a na ktorý možno prepnúť v prípade, že primárne riadiace zariadenie nefunguje správne. Podrobné údaje o tom, ako to urobiť, nájdete v časti [16.2 Prepínanie na sekundárne riadiace zariadenie](#).

Obrázok 3-2: Schéma a inštalácia BOND-ADVANCE – terminály BOND-ADVANCE riadia moduly spracovania v súboroch prostredníctvom riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE.

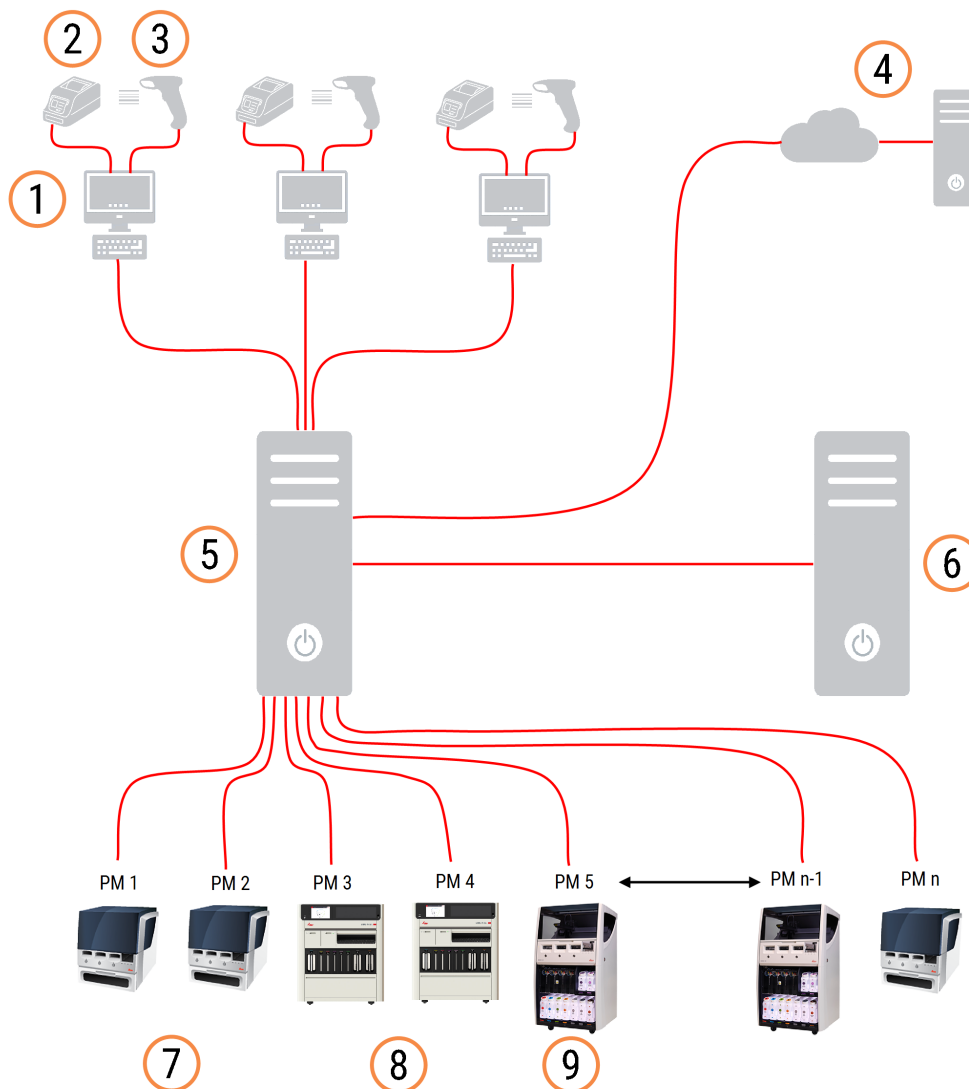

Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 Terminály BOND-ADVANCE | 6 Sekundárne riadiace zariadenie BOND-ADVANCE |
| 2 Tlačiarne štítkov na sklíčka | 7 Moduly spracovania BOND-MAX |
| 3 Čítačky čiarových kódov | 8 Moduly spracovania BOND-PRIME |
| 4 Pripojenie LIS | 9 Moduly spracovania BOND-III |
| 5 Primárne riadiace zariadenie BOND-ADVANCE | |

3.2 Spustenie a vypnutie softvéru BOND

3.2.1 Spustenie softvéru BOND

Softvér BOND môžete spustiť pred spustením alebo po spustení všetkých pripojených modulov spracovania.

Spustenie softvéru:

- 1 **S jednou stanicou:** v prípade potreby spustíte riadiace zariadenie BOND a prihlásite sa do systému Windows® ako používateľ „BONDUser“. Keď je systém nový, nie je nakonfigurované žiadne počiatkové heslo. Ak je však heslo nakonfigurované, ďalšie podrobnosti získate u vedúceho laboratória.

BOND-ADVANCE: ak je to potrebné, spustíte riadiace zariadenie BOND-ADVANCE. Ovládací panel by sa mal otvoriť automaticky (ak nie, dvakrát kliknite na skratku **BONDDashboard** na pracovnej ploche Windows. Stlačením tlačidla <F11> nastavte Internet Explorer na režim celej obrazovky).

Spustíte potrebný terminál a prihlásite sa do systému Windows ako používateľ „BONDUser“.

- 2 Dvojitým kliknutím na ikonu príslušnej pracovnej plochy spustíte klinického klienta alebo klienta správy (alebo obidvoch – môžu byť spustené súčasne).
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo systému BOND.

Ak v systéme BOND-ADVANCE otvárate klinického klienta, môžete si vybrať súbor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



Klinický klient BOND-ADVANCE si pamätá posledný vybraný modul.

Heslo môžete kedykoľvek zmeniť v prihlasovacom dialógovom okne. Postupujte podľa postupov laboratória, pokiaľ ide o častotť zmien hesla a silu hesla. Softvér BOND vyžaduje, aby heslá mali 4 až 14 znakov a obsahovali aspoň jedno číslo.

Ak ste používateľ systému BOND-PRIME, môžete tiež nastaviť alebo zmeniť PIN kód vášho modulu spracovania. Pozrite si časť **3.2.2 Nastavenie alebo zmena PIN kód modulu spracovania BOND-PRIME** nižšie.

- 4 Kliknite na možnosť **Log on** (Prihlásiť sa).

Systém zobrazí obrazovku klinického klienta alebo obrazovku klienta správy podľa výberu. V záhlaví sa zobrazuje používateľské meno používateľa, ktorý je aktuálne prihlásený. Ak prevezmete správu od iného používateľa, mali by ste sa odhlásiť a znova prihlásiť pomocou svojho vlastného používateľského mena. V prípade systému BOND-ADVANCE sa v záhlaví tiež zobrazí aktuálne vybraný súbor.




VÝSTRAHA: Keďže softvér BOND kontroluje dôležitý hardvér a ukladá citlivé údaje, nespúšťajte na riadiacom zariadení BOND iné aplikácie – záruka na systém BOND tým stráca platnosť. Nepoužívajte riadiace zariadenie BOND na všeobecné počítačové účely.

3.2.2 Nastavenie alebo zmena PIN kódu modulu spracovania BOND-PRIME


- 1 V dialógovom okne prihlásenia kliknite na položku **Set processing module PIN** (Nastaviť PIN kód modulu spracovania).

Obrázok 3-3: Dialógové okná prihlásenia pre klinického klienta a klienta správy

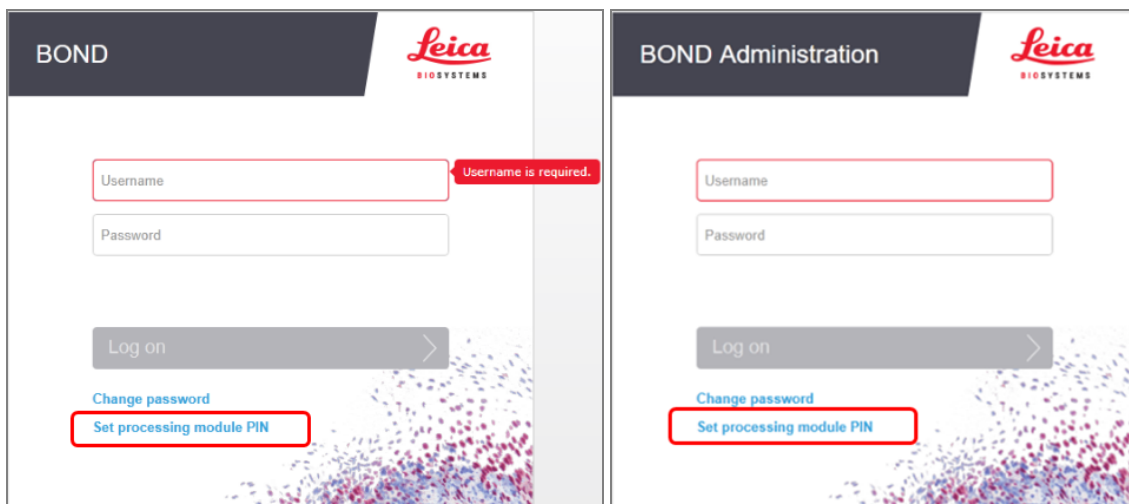

- 2 Zadať svoje používateľské meno a heslo systému BOND.
- 3 Zadať 4-miestny PIN kód a potom nižšie potvrdte svoj PIN kód.

Obrázok 3-4: Dialógové okno na nastavenie PIN kódu modulu spracovania

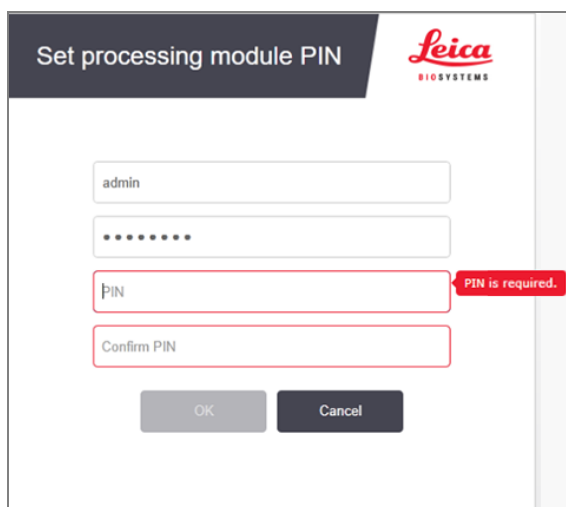

- 4 Kliknite na tlačidlo **OK**.


Pozadia pracovnej plochy

Rôzne pozadia pracovnej plochy Windows sa používajú na rozlíšenie medzi typom aktuálne prihláseného používateľa Windows a úlohou aktuálne pripojeného riadiaceho zariadenia alebo terminálu.

Jednomiestny

Bežne sa zobrazuje pozadie „Controller BONDUser“, ale sa na pracovisku nachádza servisný technik, môže sa vám zobraziť pozadie „Controller BONDSERVICE“. Pozrite si časť **Obrázok 3-5**.

Obrázok 3-5: Pozadia pracovnej plochy systému BOND „Controller BONDUser“ a „Controller BONDSERVICE“

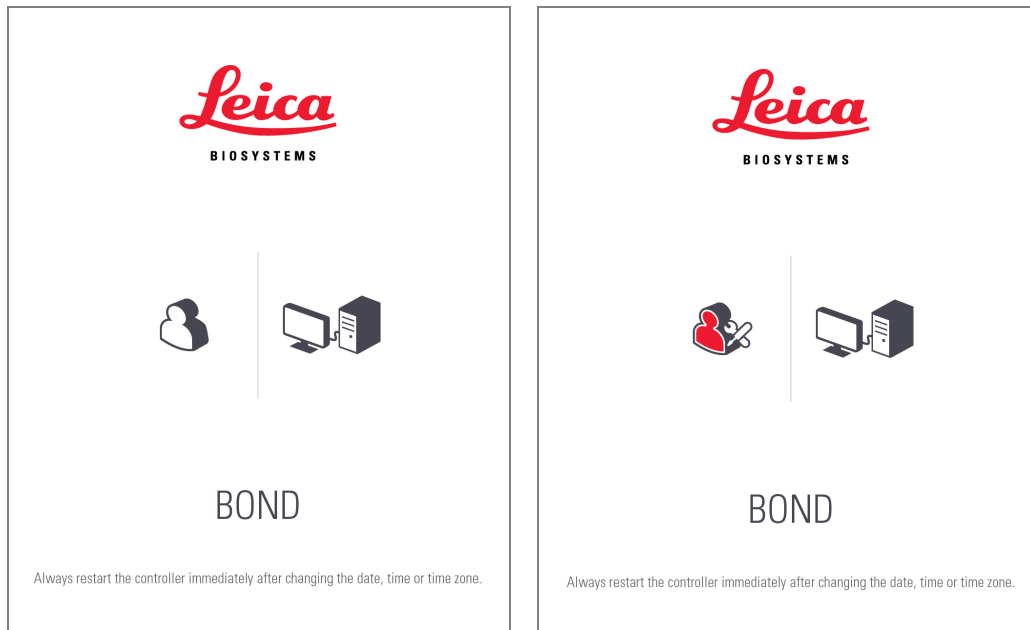

BOND-ADVANCE

Na pozadí pracovnej plochy systému BOND-ADVANCE sa ikona pripojeného riadiaceho zariadenia alebo terminálu mení podľa príslušnej úlohy. Pozrite si časť príklady na **Obrázok 3-6**.

Obrázok 3-6: Ikony terminálu, samostatného riadiaceho zariadenia, primárneho riadiaceho zariadenia a sekundárneho riadiaceho zariadenia



Uvidíte tiež rôzne ikony, ktoré predstavujú typ používateľa. Pozrite si časť [Obrázok 3-7](#).

Obrázok 3-7: Ikony BONDUser, BONDSERVICE, BONDCONTROL a BONDDashboard



3.2.3 Vypnutie softvéru BOND



Ak chcete vypnúť klinického klienta alebo klienta správy, kliknite na ikonu **Log out** (Odhlásiť) na paneli funkcií. Ak potrebujete zmeniť používateľov, klinického klienta môžete vypnúť počas prebiehajúceho cyklu. Nenechávajte modul spracovania v prevádzke bez toho, aby bol otvorený klient, pretože sa vám nebudú zobrazovať žiadne výstrahy ani alarmy.

Nikdy nevypínajte riadiace zariadenie BOND počas cyklu. Ak vypínate systém BOND úplne, softvér môžete vypnúť pred vypnutím alebo po vypnutí modulov spracovania.

3.3 Úlohy používateľa

V systéme BOND sú k dispozícii tri úlohy používateľa:

- **Operátor:** môže aktualizovať zásoby reagentov, vytvárať prípady a sklíčka, spúšťať a kontrolovať cykly farbenia, vytvárať a upravovať lekárov a generovať správy.
- **Dohliadajúci:** môže vytvárať a upravovať protokoly, reagenty a panely.
- **Správca:** má prístup ku klientovi správy na správu používateľov systému BOND a môže konfigurovať nastavenia celého systému.

Používatelia môžu mať viac úloh. Dohliadajúci automaticky získajú úlohy operátora. Klienta správy môžu spúšťať iba používatelia s úlohou správcu a klinického klienta môžu spúšťať iba používatelia s úlohami operátora alebo dohliadajúceho.

Používatelia sa vytvárajú a ich úlohy sa nastavujú na obrazovke **Users** (Používatelia) klienta správy (pozrite si časť [10.1 Users \(Používatelia\)](#)).



V záhlaví okna klienta sa zobrazuje používateľské meno aktuálne prihláseného používateľa.


3.4 Prehľad rozhrania klinického klienta

V hornej a ľavej časti obrazovky klinického klienta sa nachádzajú funkcie, ktoré sú spoločné pre všetky stránky softvéru. V tejto časti sa uvádzajú tieto funkcie a tiež opisuje všeobecné vlastnosti softvéru.


- [3.4.1 Panel funkcií](#)
- [3.4.2 Karty modulu spracovania](#)
- [3.4.3 Zoradenie v tabuľkách](#)
- [3.4.4 Formát dátumu](#)








3.4.1 Panel funkcií

Panel funkcií sa nachádza v hornej časti obrazovky softvéru BOND a poskytuje rýchly prístup k hlavným častiam softvéru BOND.



Kliknutím na ikonu na paneli funkcií prejdete na obrazovku alebo vykonáte konkrétnu funkciu podľa popisu v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Zobrazená obrazovka (alebo vykonaná funkcia)	Účel
	Slide setup (Nastavenie sklíčka)	Vytvorte prípady a nastavte sklíčka v softvéri BOND. Ďalšie informácie nájdete v časti 6 Nastavenie sklíčka (na riadiacom zariadení BOND) .
	Protocol setup (Nastavenie protokolu)	Upravte a spravujte svoje protokoly. Ďalšie informácie nájdete v časti 7 Protokoly (na riadiacom zariadení BOND) .
	Reagent setup (Nastavenie reagentie), Reagent inventory (zoznam reagentí) a Reagent pa (panely reagentí) (3 karty)	Nakonfigurujte nové reagentie, spravujte inventár reagentí a vytvorte panely reagentí (súbory značkovačov používané na urýchlenie vytvárania sklíčok). Ďalšie informácie nájdete v časti 8 Správa reagentí (na riadiacom zariadení BOND) .
	Slide history (História sklíčok)	Zobrazte detaily sklíčok, ktoré boli spracované v systéme BOND, zobrazte detaily jednotlivých sklíčok, cyklov a prípadov a vytvorte širokú škálu správ. Ďalšie informácie nájdete v časti 9 História sklíčok (na riadiacom zariadení BOND) .

Ikona	Zobrazená obrazovka (alebo vykonaná funkcia)	Účel
	Search (Vyhľadávanie)	Identifikujte sklíčka, nádoby na reagencie a systémy reagencií naskenovaním čiarových kódov alebo manuálnym zadaním identifikátora sklíčka alebo identifikátora reagencie. Jednotné dialógové okno vyhľadávania sa používa vtedy, keď systém automaticky identifikuje obsah vyhľadávania (sklíčko alebo reagentiu). Pozrite si časť 6.5.6 Manuálna identifikácia sklíčka alebo 8.1.1.3 Identifikácia reagencie , kde nájdete ďalšie informácie.
	Help (Pomocník)	Otvorte túto používateľskú príručku.
	Logout (Odhlásiť sa)	Odhláste sa z klienta.
	Zálohovanie zlyhalo	Zálohovanie databázy sa nepodarilo úspešne dokončiť. Ďalšie informácie nájdete v časti 10.5.3 Zálohy databázy .
	Systém LIS nie je pripojený	Modul LIS je nainštalovaný, ale momentálne nie je pripojený k systému LIS. Ďalšie informácie nájdete v časti 11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS .
	Systém LIS je pripojený	Modul LIS je nainštalovaný a momentálne je pripojený k systému LIS. Ďalšie informácie nájdete v časti 11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS .
	Oznámenia systému LIS	Počet nevybavených oznámení systému LIS. Ďalšie informácie nájdete v časti 11.4 Oznámenia systému LIS .

V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza logo Leica Biosystems. Kliknutím na logo zobrazíte dialógové okno **About BOND** (Informácie o systéme BOND). Pozrite si časť [3.9 Informácie o systéme BOND](#).

V pravej hornej časti obrazovky sa môžu zobraziť výstražné a stavové ikony. Pozrite si časť [11 Integrovaný balík LIS \(na BOND riadiacom zariadení\)](#) a [10.4.2 Záznam z auditu](#) (Záznam z auditu).

3.4.2 Karty modulu spracovania



Tieto karty sa nezobrazujú pre moduly spracovania BOND-PRIME. Informácie o stave systému a údržbe modulu spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Pomocou kariet na ľavej strane rozhrania sa otvárajú obrazovky **System status** (Stav systému), **Protocol status** (Stav protokolu) a **Maintenance** (Údržba) pre každý z modulov spracovania v súbore, ku ktorému je klient pripojený. Na samotných kartách sa zobrazujú niektoré informácie o aktuálnom stave každého modulu spracovania (pozrite si časť [5.1.1 Karty modulu spracovania](#)).

Obrázok 3-8: Karty modulu spracovania (BOND-MAX)



Na obrazovkách **System status** (Stav systému) sa zobrazuje stav každého modulu spracovania, zatiaľ čo **Protocol status** (Stav protokolu) sa zobrazuje priebeh prebiehajúcich protokolov. Obrazovka **Maintenance** (Údržba) obsahuje príkazy pre celý rad operácií údržby.

3.4.3 Zoradenie v tabuľkách

Mnohé obrazovky v softvéri BOND zobrazujú dáta v tabuľkách. Kliknutím na nadpis stĺpca ich zoradíte podľa hodnôt v tomto stĺpci. Vedľa nadpisu sa zobrazí trojuholník nahor, ktorý naznačuje, že tabuľka je usporiadaná vzostupne (0 – 9, A – Z). Kliknutím znova zoradíte zostupne, trojuholník ukazuje nadol.

Ak chcete usporiadať dva stĺpce, kliknite na prvý stĺpec, podľa ktorého chcete zoradiť, a potom podržte kláves a kliknite na druhý stĺpec. Poradie hodnôt v prvom stĺpci sa nemení, ale v prípade viacerých riadkov s rovnakou hodnotou v prvom stĺpci budú riadky zoradené podľa hodnôt v druhom stĺpci.

Môžete tiež zmeniť šírku stĺpcov a presunúť stĺpce na nové pozície v tabuľke.

Všetky zmeny, ktoré urobíte v triedení tabuliek, rovnako ako šírky stĺpcov a polohy zostanú zachované, kým sa neodhlásite.

3.4.4 Formát dátumu

Pre inštalácie s jednou stanicou sa v softvéri a správach používajú dátumy a časy vo formátoch stanovených v operačnom systéme riadiaceho zariadenia BOND. Pri inštaláciách BOND-ADVANCE sa používajú formáty nastavené v termináloch. Formáty s krátkym a dlhým dátumom by mali mať maximálnu dĺžku 12 a 28 znakov.

3.5 Ovládací panel BOND-ADVANCE



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Pri inštaláciách BOND-ADVANCE sa ovládací panel BOND zobrazuje na monitore pripojenom k riadiacemu zariadeniu alebo terminálu. Poskytuje zhrnutie stavu v reálnom čase pre všetky moduly spracovania v systéme.

Obrázok 3-9: Ovládací panel BOND









Legenda

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | Moduly spracovania s alarmami | 4 | Moduly spracovania s dokončenými cyklami |
| 2 | Moduly spracovania s výstrahami | 5 | Tably jednotlivých modulov spracovania, zobrazujúce stav zostáv na farbenie sklíčok. |
| 3 | Moduly spracovania s oznámeniami | | |

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú štyri ikony zobrazujúce moduly spracovania s alarmami, výstrahami, oznámeniami a dokončenými procesmi (zľava doprava). Ak je v kategórii viac ako jeden modul spracovania, ikony sa cez ne cyklicky postupne presúvajú.

Pod horným riadkom sú tably pre každý modul spracovania v systéme zoradené abecedne podľa názvu (nastavené v klientovi správy). Tably zobrazujú stav každej z troch zostáv na farbenie sklíčok na moduloch spracovania plus všetky všeobecné indikátory stavu vzťahujúce sa na moduly ako celok.

Ikony ovládacieho panela

Ikona	Opis
	Modul spracovania má alarm.
	Modul spracovania má výstrahu.
	Modul spracovania funguje normálne. Časová značka má biele pozadie (00:14:28).
	Cyklus sa úspešne dokončil najmenej na jednom podnose modulu spracovania a podnos je pripravený na vyloženie. Časová značka má zelené pozadie (00:11:36).
	Modul spracovania má oznámenie.
	Modul spracovania bol odpojený.

Moduly spracovania s výstrahami, oznámeniami alebo dokončenými cyklami sa zobrazia na vhodnej pozícii v hornej časti displeja a ako jednotlivé tably v abecednom zozname nižšie.

3.5.1 Stav zostavy na farbenie sklíčok



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Stav každej zostavy na farbenie sklíčok je zobrazený na tabľách modulu spracovania. Existujú tri kategórie stavu:

- **Locked** (Zamknutý) – zobrazuje sa, keď je podnos na sklíčka zaistený. Nie je zobrazený žiadny čas.
- **Processing** (Spracovanie) – začalo sa spracovanie na podnose. V stĺpci **Time** (Čas) sa zobrazuje čas, ktorý zostáva do spustenia cyklu v hodinách, minútach a sekundách.
- **Completed** (Dokončený) – spracovanie sa skončilo. V stĺpci **Time** (Čas) sa zobrazuje čas od dokončenia cyklu v hodinách, minútach a sekundách a má zelené pozadie.

Ak nie je zablokovaný žiadny podnos, riadok je prázdny.

S informačným panelom nie je možné interagovať. Ak sa na ovládacom paneli zobrazuje správa, že modul spracovania potrebuje pozornosť, používateľ musí interagovať prostredníctvom terminálu BOND-ADVANCE.

3.6 Oznámenia, výstrahy a alarmy

Systém BOND má tri úrovne upozornení: oznámenie, výstraha a alarm. Každé upozornenie je označené ikonou, ktorá sa zobrazí na obrazovke **System status** (Stav systému) nad alebo vedľa subjektu položky, ktorá je predmetom správy s alarmom. Zodpovedajúca ikona upozornenia sa tiež môže zobraziť na karte modulu spracovania, aby poskytla indikáciu bez ohľadu na aktuálne zobrazenú obrazovku (pozrite si časť [5.1.1 Karty modulu spracovania](#)). V systéme BOND-ADVANCE sa upozornenia zobrazia aj na ovládacom paneli (pozrite si časť [3.5 Ovládací panel BOND-ADVANCE](#)).

Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu upozornenia a výberom možnosti **Attention message** (Správa s upozornením) sa otvorí dialógové okno s detailmi o stave upozornenia.

Tri úrovne upozornení a ich priradené ikony sú opísané nižšie.



Nebliká

Oznámenie

Poskytuje informácie o stave, ktorý môže vyžadovať zásah teraz alebo neskôr, aby sa spustil cyklus alebo aby sa zabránilo neskoršiemu oneskoreniu spracovania.



Nebliká

Výstraha

Teraz je potrebné vykonať zásah, aby sa zabránilo oneskoreniu pri spracovaní. Oneskorenie spracovania môže ohroziť farbenie.



Bliká

Alarm

Naliehavo je potrebné konať. Ak modul spracovania spracovával sklíčka, bol pozastavený a nemôže pokračovať, kým nevyriešite stav s upozornením. Oneskorenie spracovania môže ohroziť farbenie.



VÝSTRAHA: Výstražné správy a správy s alarmom si vždy prečítajte hneď, ako uvidíte ikony (najmä keď prebieha cyklus). Rýchla reakcia môže zabrániť ohrozeniu farbenia sklíčok.

Aj v prípade oznámení je vhodné zasiahnuť čo najskôr, ak sa vyskytnú počas cyklov.

3.7 Správa

Softvér BOND generuje mnohé správy. Tieto sa otvárajú v „zobrazovači správ systému BOND“, v novom okne. Všeobecné informácie ako čas, miesto a modul spracovania, na ktoré sa správa vzťahuje, sú uvedené v záhlaví správy. V päťach stránky správy sa zobrazuje čas a dátum, kedy bol prehľad vygenerovaný, a čísla stránok.

Niektoré správy, najmä tie, ktoré obsahujú informácie o prípadoch, sklíčkach alebo reagenziách, môžu trvať niekoľko minút, najmä v laboratóriách s mnohými modulmi spracovania a/alebo s vysokou kapacitou.

Prehliadač správ systému BOND má malý rozsah možností navigácie, zobrazenia a výstupu. Rovnako ako otvorenie štandardného tlačového dialógového okna na výber a konfiguráciu tlačiarne alebo na výber stránok, ktoré sa majú tlačiť, môžete exportovať správy v rôznych formátoch vrátane PDF, XLS, CSV a v textovom formáte.

Na navigáciu môžete použiť rôzne klávesové skratky, napríklad **Page Up**, **Page Down**, **Home** (prvá strana) a **End** (posledná strana). Ostatné funkcie sú tiež dostupné napríklad aj pomocou klávesových skratiek **Ctrl-F** zobrazí dialógové okno Search (Hľadať), **Ctrl-S** otvorí dialógové okno Save (Uložiť) a **Ctrl-P** otvorí dialógové okno Print (Tlač).

Správy systému BOND sú zdokumentované v nasledujúcich sekciách:

- [5.3.1 Správa o údržbe](#)
- [6.7 Súhrnná správa o nastavení sklíčok](#)
- [7.5 Správy protokolu](#)
- [8.3.4 Správa s údajmi o zásobách](#)
- [8.3.5 Správa o použití reagenzií](#)
- [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)
- [9.5 Správa s údajmi o cykle](#)
- [9.6 Správa o prípade](#)
- [9.8 Súhrn sklíčok](#)
- [9.10 Stručná história sklíčok](#)
- [Servisný denník](#)

Je tiež možné exportovať informácie o sklíčkach vo formáte súboru CSV (hodnoty oddelené čiarkami). Pozrite si časť [9.9 Export údajov](#).

3.7.1 Staré správy


Ak bol váš systém BOND aktualizovaný z verzie softvéru 4.0, údaje o prípadoch a sklíčkach pred aktualizáciou sa neprevedú do aktuálnej databázy. Staré údaje (ďalej len „staršie“ údaje) sú však stále k dispozícii. Prístup k nim získate otvorením ponuky **Start** (Štart) > **All Programs** (Všetky programy) > **Leica** > **BONDLegacy Report Viewer** (Prehliadač starších správ systému). Otvorí sa verzia softvéru BOND 4.0. Zobrazte spracované sklíčka na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) a vytvorte správy rovnakým spôsobom ako vo verzii 4.0. Rovnako ako vo verzii môžete tlačiť správy z okna prehľadov alebo ich ukladať vo formáte PDF. Ak to chcete urobiť, vyberte položku **File** (Súbor) > **Print** (Vyvolať) a ako tlačiareň vyberte možnosť **Leica PDF Printer** (Tlačiareň Leica PDF).

V prehliadači starších správ BOND nevytvárajte prípady ani sklíčka. Používajte ho iba na prezeranie starších údajov a vytváranie správ.

3.8 Pomocník



Ikona **Help** (Pomoc) na paneli funkcií klienta Klinické aj klienta správy otvorí kontextové okno, ktoré vám umožní vybrať verziu používateľskej príručky, ktorú chcete otvoriť.

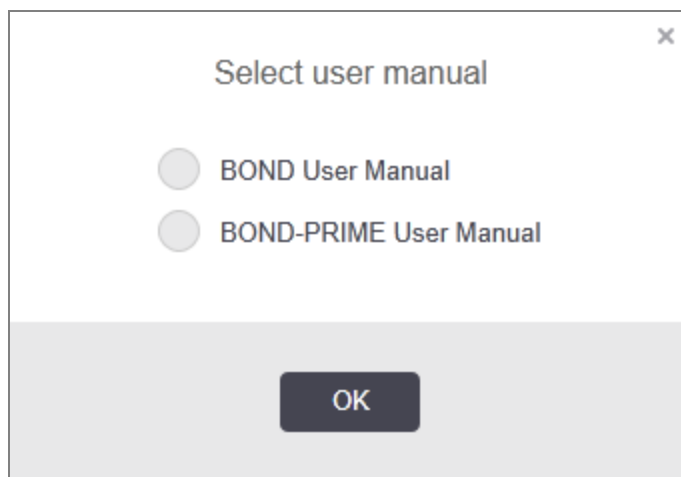


Prípadne môžete otvoriť okno používateľskú príručku **Select user manual** (Výber používateľskej príručky) z ikony na pracovnej ploche.

3.9 Informácie o systéme BOND

Kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky, aby sa zobrazilo dialógové okno **About BOND** (Informácie o systéme BOND), ktoré obsahuje informácie o systéme.

Obrázok 3-10: Dialógové okno About BOND (Informácie o systéme BOND)

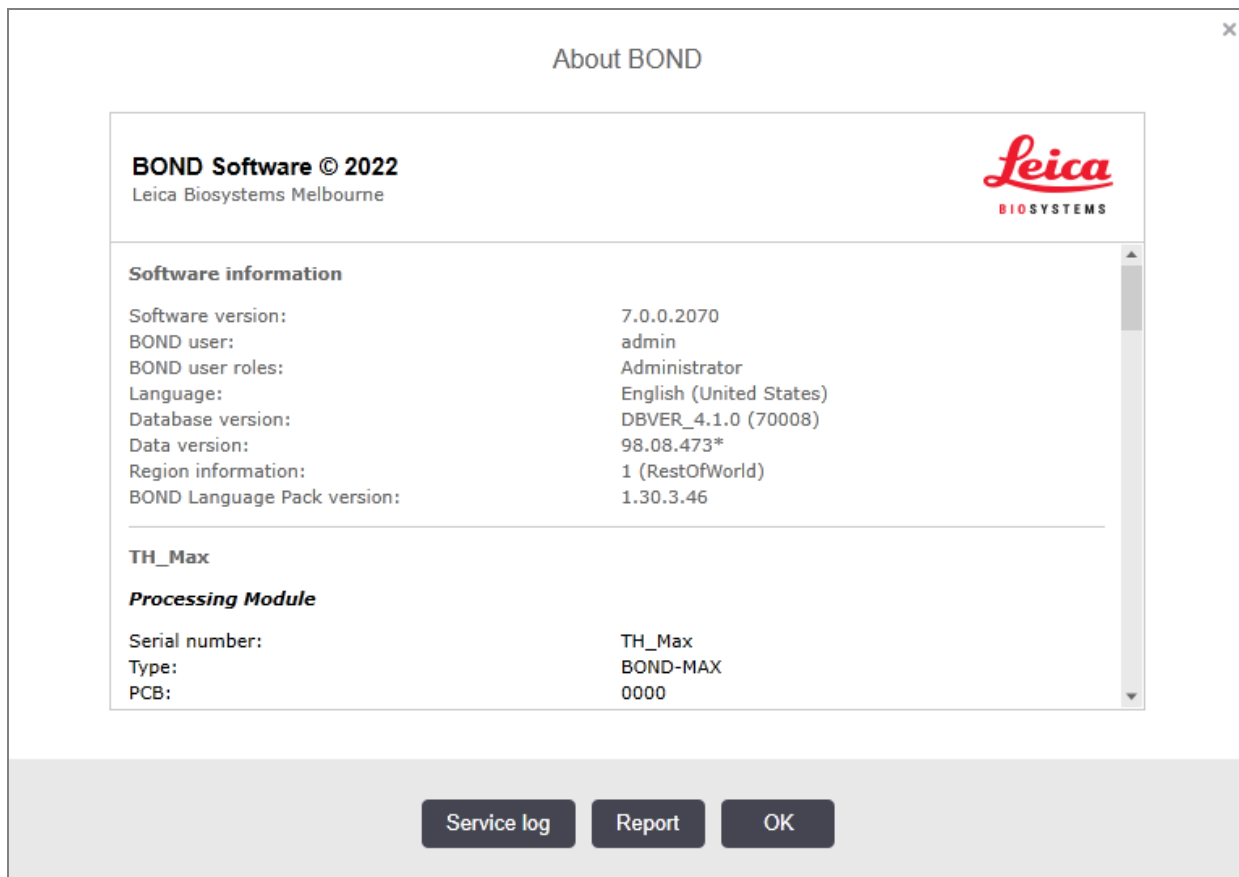

Väčšina informácií v časti **About BOND** (Informácie o systéme BOND) je v zásade určená pre servisných pracovníkov, pre laboratórnych pracovníkov však môže byť užitočná prvá skupina informácií, najmä počas rozhovorov s oddelením podpory zákazníkov.

Informácie obsiahnuté v prvej skupine sú tieto:

- verzia softvéru: číslo verzie softvéru,
- používateľ systému BOND: používateľské meno aktuálneho používateľa,
- úlohy používateľa systému BOND: úlohy aktuálneho používateľa,
- jazyk: aktuálny jazyk,
- verzia databázy: verzia databázy (odkazuje na štruktúru databázy),
- verzia údajov: verzia údajov načítaných do databázy,
- informácie o oblasti: svetový región, pre ktorý je systém nakonfigurovaný (nastavený počas inštalácie).

Informácie môžete uložiť v dialógovom okne do textového súboru – kliknite na časť **Report** (Správa) a vyberte umiestnenie na uloženie súboru.

Servisný denník

V klientovi správy môžete generovať protokoly servisných protokolov z dialógového okna **About BOND** (Informácie o systéme BOND). Spravidla by sa tak stalo na žiadosť servisného zástupcu. Vytvorenie servisného denníka:

- 1 Kliknite na položku **Service log** (Servisný denník) v dialógovom okne **About BOND**(Informácie o systéme BOND) (pozrite si **Obrázok 3-10**).
- 2 Vyberte buď:
 - Jedinečné sériové číslo modulu spracovania,
 - ***System*** (Systém), ak chcete správu o udalostiach softvéru alebo riadiaceho zariadenia v systéme BOND, prípadne
 - ***LIS*** pre udalosti súvisiace so systémom LIS.
- 3 Vyberte časový rámec pre správu alebo kliknite na možnosť **Last seven days** (Posledných sedem dní).
- 4 Kliknutím na možnosť **Generate** (Generovať) vygenerujete správu. Správa sa zobrazí v prehliadači správ – pozrite si časť **3.7 Správa**.
- 5 Ak chcete exportovať servisný denník do súboru CSV, kliknite na ikonu **Export Data** (Exportovať údaje).

3.10 Definície údajov systému BOND

Riadiace zariadenie BOND ukladá definície údajov, ktoré obsahujú všetky podrobnosti o reagencii a protokole pre celý systém. Predvolené protokoly a detaily reagencií Leica Biosystems a systémy reagencií sú tiež zahrnuté.

3.10.1 Aktualizácie definícií údajov

Spoločnosť Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizácie definícií údajov pomocou webovej lokality, napríklad na pridanie novo vydaných reagencií. V časti **10.4 BDD** si pozrite pokyny týkajúce sa aktualizácií definícií údajov.

Keď aktualizujete definície údajov, musíte použiť iba aktualizáčny súbor, ktoré majú koncovku súboru **.bdd** a sú určené pre správny región.

Skontrolujte svoju aktuálnu verziu údajov v dialógovom okne **About BOND** (Informácie o systéme BOND). Ak chcete zobraziť toto dialógové okno, kliknite na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND. Pozrite si tiež časť **3.9 Informácie o systéme BOND**.

3.11 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Leica Biosystems môže vydávať aktualizácie softvéru, pretože vývoj systému BOND aj naďalej pokračuje. Aktualizácie sa môžu týkať hlavného softvéru alebo databázy, ktorá obsahuje predvolené protokoly, reagenty a systémy reagentov.

Číslo aktuálnej verzie softvéru nájdete v dialógovom okne **About BOND** (Informácie o systéme BOND) (pozrite si časť [3.9 Informácie o systéme BOND](#)). Verzia údajov sa zobrazí aj v dialógovom okne **About BOND** (Informácie o systéme BOND).

4

Rýchly štart

Táto kapitola je navrhnutá tak, aby vám poskytla prehliadku vášho prvého individuálneho cyklu so systémom BOND. V rámci tejto prehliadky vytvoríme vzorový prípad a nakonfigurujeme a spracujeme štyri sklíčka, ktoré otestujeme s pomocou hotových primárnych protilátok BOND *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6.

V prípade systémov BOND-III a BOND-MAX je predvolený protokol a detekčný systém pre tieto protilátky používame *IHC Protocol F a BOND Polymer Refine Detection System (DS9800).

V prípade modulov spracovania BOND-PRIME je predvolený detekčný systém protokolu *IHC Protocol F a BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces využíva aj pomocný BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096).

Opísané postupy sú platné aj pre sondy ISH a protokoly ISH (jednoducho vymeňte protilátku za sondu a protokoly IHC nahradíte protokolmi ISH).

4.1 BOND-III a BOND-MAX

Skôr ako začnete, mali by ste sa oboznámiť s relevantnými časťami kapitol [2 Hardvér](#) a [3 Prehľad softvéru \(na riadiacom zariadení BOND\)](#) tejto príručky.

- [4.1.1 Predbežné kontroly a uvedenie do prevádzky](#)
- [4.1.2 Kontroly protokolov a reagensí](#)
- [4.1.3 Nastavenie sklíčok](#)
- [4.1.4 Vkladanie reagensí](#)
- [4.1.5 Spustenie protokolu](#)
- [4.1.6 Dokončenie](#)

4.1.1 Predbežné kontroly a uvedenie do prevádzky

Pred začiatkom cyklu vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Skontrolujte, či je modul spracovania čistý a či sú všetky úlohy údržby aktuálne (pozrite si časť **12.1 Plán čistenia a údržby**).

Medzi denné úlohy pred spustením cyklu patria nasledujúce:


- a Skontrolujte, či nie sú nádoby na nebalený odpad naplnené do polovice. Na súčasnom modeli BOND-MAX použite bielu vodorovnú čiaru na štítku nádoby ako vodidlo označujúce polovičnú úroveň (pozrite si časť **Obrázok 12-3**).
 - b Skontrolujte, či sú v nádobách na nebalené reagenty dostatočné množstvá správnych reagentov.
- 2 Skontrolujte premývacie bloky a zmiešavaciu stanicu – v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.
 - 3 Skontrolujte, či má značkovač sklíčok dostatočné množstvo štítkov.
 - 4 Ak modul spracovania a riadiace zariadenie (a terminál, pre BOND-ADVANCE) nie sú zapnuté, teraz ich zapnite.
 - 5 Keď je riadiace zariadenie alebo terminál spustený, spustite klinického klienta.
 - 6 Po spustení softvéru skontrolujte obrazovky **Status** (Stavové), aby ste sa uistili, že nie sú zobrazené žiadne oznámenia modulu spracovania. Pred pokusom o spustenie akýchkoľvek sklíčok ich napravte.
 - 7 Zapnite značkovač sklíčok.

4.1.2 Kontroly protokolov a reagentov

Mali by ste skontrolovať, či sú v softvéri nastavené protokoly a reagenty, ktoré chcete použiť pri spustení.

Postup kontroly protokolov:

- 1 Vyberte ikonu **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) (zobrazená vpravo) na paneli funkcií.
- 2 Skontrolujte, či je v tabuľke uvedené „*IHC protokol F“.



Ak protokol nie je uvedený, vyberte **All** (Všetko) vo filtri **Preferred status** (Preferovaný stav) v dolnej časti obrazovky (pozrite si časť **7.2 Obrazovka nastavenia protokolu**).

Vyberte protokol v tabuľke a kliknite na položku **Open** (Otvoriť) a pozrite si preferovaný detekčný systém v dialógovom okne **Edit protocol properties** (Úprava vlastností protokolu); **BOND Polymer Refine Detection**.

Uistite sa, že protokol je vybraný ako možnosť **Preferred** (Preferovaný) v blízkosti hornej časti dialógového okna (ak chcete, aby bol protokol preferovaný, musíte sa prihlásiť pomocou úlohy používateľa – dohliadajúci).

Postup kontroly reagentov:

Táto kontrola predpokladá, že máte zásoby požadovaných protilátok a detekčného systému a že boli zaregistrované v inventári reagentov systému BOND. Pozrite si časť **8.3.3 Registrácia reagentov a systémov reagentov** pre viac informácií.



- 1 Vyberte ikonu **Reagent setup** (Nastavenie reagentie) (zobrazená vpravo) na paneli funkcií.
- 2 Na karte **Setup** (Nastavenie) vyberte možnosť **Primaries** (Primárne) ako nastavenie položky **Reagent type** (Typ reagentie), možnosť **Leica Microsystems** ako nastavenie položky **Supplier** (Dodávateľ) a možnosť **All** (Všetko) pre položku **Preferred status** (Preferovaný stav) vo filtroch v dolnej časti obrazovky.
- 3 Vyhľadajte každú z protilátok, ktoré potrebujeme (*CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6), a dvojitým kliknutím otvorte dialógové okno **Edit reagent properties** (Úprava vlastností reagentií):
 - a Kliknite na položku **Restore factory default protocols** (Obnoviť predvolené výrobné protokoly) (na obnovenie predvolených nastavení z výroby musíte byť prihlásení pomocou úlohy používateľa – dohliadajúci). Tým sa zaistí, že je nastavený predvolený protokol farbenia *Protokol IHC F a predvolené protokoly predbežnej úpravy.
 - b Skontrolujte, či je reagentia označená ako možnosť **Preferred** (Preferovaná) (ak chcete, aby bola reagentia preferovaná, musíte byť prihlásení pomocou úlohy používateľa – dohliadajúci).
 - c Kliknite na položku **Save** (Uložiť).
- 4 Teraz prejdite na kartu **Inventory** (Inventár) a vyberte položku **Reagent containers** (Nádoby na reagentie) ako nastavenie položky **Package type** (Typ balenia), možnosť **Primaries** (Primárne) ako nastavenie položky **Reagent type** (Typ reagentie), **In stock** (Skladom) ako nastavenie položky **Inventory status** (Stav zásob), možnosť **Leica Microsystems** pre položku **Supplier** (Dodávateľ) a možnosť **Preferred** (Preferované) pre položku **Preferred status** (Preferovaný stav) vo filtroch v dolnej časti obrazovky.
 Všetky protilátky, ktoré potrebujeme, by sa mali zobrazíť s dostupnými objemami.
 Uistite sa, že pre každú protilátku je k dispozícii dostatočný objem.
- 5 Na tej istej karte vyberte položku **BOND detection systems** (Detekčné systémy) ako nastavenie položky **Package type** (Typ balenia) a možnosť **In stock** (Skladom) pre položku **Inventory status** (Stav zásob). Skontrolujte, či je preferovaný detekčný systém, **BOND Polymer Refine Detection**, uvedený v tabuľke a či je k dispozícii dostatočný objem (pozrite si časť **8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekčné systémy**).

4.1.3 Nastavenie sklíčok

V tejto sekcii sú opísané postupy, ako oznámiť systému BOND detaily, ktorý potrebuje na farbenie sklíčok, a postupy na fyzické umiestnenie sklíčok do modulu spracovania.



Softvérové operácie v tejto sekcii sa vykonávajú na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Túto obrazovku zobrazíte kliknutím na ikonu **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) na paneli funkcií.

Pozrite si podsekcie:

- [4.1.3.1 Zadávanie detailov prípadu](#)
- [4.1.3.2 Zadávanie detailov sklíčka](#)
- [4.1.3.3 Riadiace zariadenia](#)
- [4.1.3.4 Označovanie sklíčok](#)
- [4.1.3.5 Vkladanie sklíčok](#)

4.1.3.1 Zadávanie detailov prípadu

Najprv musíme v softvéri vytvoriť „prípado“ pre vzorku pacienta. V našom príklade je meno pacienta A Edward, identifikátor prípadu 3688 a odporúčajúci lekár je doktor Smith.

- 1 Kliknite na možnosť **Add case** (Pridať prípad) na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Softvér zobrazí dialógové okno **Add case** (Pridať prípad).

Obrázok 4-1: Dialógové okno **Add case** (Pridať prípad)

- 2 Kliknite do poľa **Case ID** (Identifikátor prípadu) a napíšte „3688“.
- 3 Kliknite do poľa **Patient name** (Meno pacienta) a napíšte „Edward, A“.
- 4 Kliknutím na položku **Manage doctors** (Spravovať lekárov) otvorte dialógové okno **Manage doctors** (Spravovať lekárov). Tam kliknutím na položku **Add** (Pridať) otvorte dialógové okno **Add doctor** (Pridať lekára) a do poľa **Name** (Meno) napíšte „Smith“. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko **Preferred** (Preferovaný). Kliknite na položku **Save** (Uložiť).
- 5 Vyberte možnosť „Smith“ a v dialógovom okne **Manage doctors** (Spravovať lekárov) kliknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Vyberte objem na dávkovanie 150µl ako predvolené hodnotu pre prípad. Toto nastavenie môže byť počas nastavenia sklíčka podľa potreby prepísané.
- 7 V poli **Preparation protocol** (Protokol o príprave) vyberte možnosť *Dewax (Odvoskovať) alebo *Bake and Dewax (Zahrievanie a odvoskovanie) na nastavenie predvolenej prípravy sklíčok v prípade. Toto nastavenie môže byť počas nastavenia sklíčka podľa potreby prepísané.
- 8 Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte dialógové okno **Add case** (Pridať prípad) – v tabuľke vľavo od obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) sa zobrazí nový prípad.

Ďalšie informácie o práci s prípadmi nájdete v časti [6.3 Práca s prípadmi](#).

4.1.3.2 Zadávanie detailov sklíčka

V ďalšej fáze vytvoríme softvérové „sklíčka“ pre každé zo štyroch fyzických sklíčok:

- 1 Vyberte náš nový identifikátor prípadu 3688 v zozname prípadov v ľavej časti obrazovky.
- 2 Kliknutím na položku **Add slide** (Pridať sklíčko) zobrazte dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka).

Obrázok 4-2: Dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka)

- 3 Prípadne pridajte komentár špecifický pre toto sklíčko.
- 4 Skontrolujte, či je možnosť **Test tissue** (Testovacie tkanivo) zvolená ako nastavenie **Tissue type** (Typ tkaniva).
- 5 Vyberte objem na dávkovanie vhodný pre modul spracovania a veľkosť tkaniva (pozrite si časť [6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach](#)).
- 6 Budeme predpokladať, že na systéme BOND-III sa sklíčka spracujú, takže nastavte objem na dávkovanie na 150µl.
- 7 V položke **Staining mode** (Režim farbenia) vyberte možnosť **Single** (Jednoduchý) a **Routine** (Rutinný).
- 8 Kliknutím na položku **IHC** špecifikujte spracovanie IHC.
- 9 Zo zoznamu **Marker** (Značkovač) vyberte možnosť ***CD5 (4C7)**
- 10 Na karte **Protocols** (Protokoly) softvér automaticky zadá prípravný protokol nastavený pre daný prípad a predvolené protokoly farbenia a získavania údajov pre *CD5.

- 11 Pri jednom farbení by ste vo všeobecnosti mali ponechať predvolenú funkciu **Auto** (Automaticky) pre jedinečné identifikátory produktov (UPI) na ľavej strane dialógového okna. Ak však chcete vybrať konkrétne číslo šarže pre konkrétne sklíčko (napr. na overenie medzi šaržami), vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu v nasledujúcich poliach:

- **Marker UPI** – UPI nádoby na reagentie pre značkovač
- **Detection System UPI** – UPI detekčného systému.

Na spracovanie sklíčok v rovnakom cykle (v systéme BOND-MAX a BOND-III) musia byť identifikátory UPI rovnaké alebo je potrebné vybrať možnosť **Auto** (Automaticky).

- 12 Kliknite na možnosť **Add slide** (Pridať sklíčko).


Sklíčko sa pridá do zoznamu sklíčok napravo od obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Dialógové okno **Add slide** (Pridať sklíčko) zostane otvorené.

- 13 Zopakujte kroky 9 – 12 trikrát a ako značkovač v kroku 9 vyberte ***CD3 (LN10)**, ***CD10 (56C6)** a ***Bcl-6 (LN22)**

- 14 Po pridaní všetkých sklíčok kliknutím na tlačidlo **Close** (Zatvoriť) zatvorte dialógové okno **Add slide** (Pridať sklíčko).

Skontrolujte detaily v zozname sklíčok.

Obrázok 4-3: Štyri sklíčka nakonfigurované na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka)

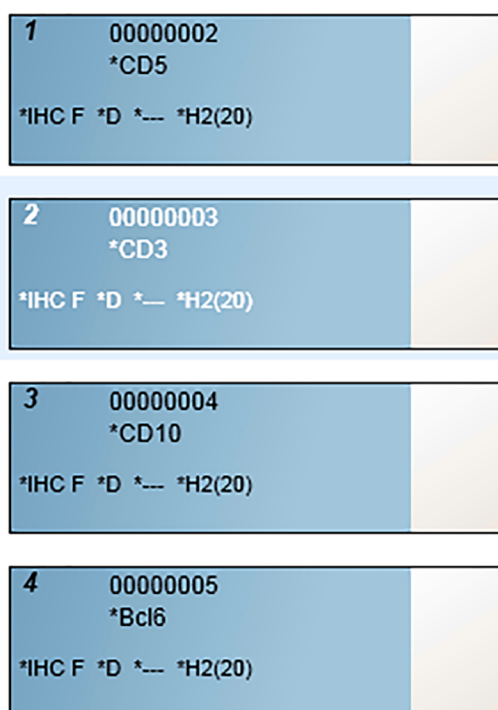

Ak potrebujete zmeniť detaily sklíčka, dvojitým kliknutím naň otvorte dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka), podľa potreby zmeňte detaily a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o práci so sklíčkami nájdete v časti **6.5 Práca so sklíčkami**.



Môžete použiť **panely** na rýchle pridanie viacerých sklíčok, ktoré bežne používate. Vysvetlenie panelov a informácie o tom, ako ich vytvoriť a používať, nájdete v časti **8.4 Obrazovka panela reagensí**.

4.1.3.3 Riadiace zariadenia

Na systéme BOND vždy používajte kontrolné vzorky. Dôrazne odporúčame umiestniť vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké podložné sklíčko ako tkanivo pacienta. Okrem toho môžete vytvoriť samostatný prípad špeciálne pre sklíčka s kontrolnou vzorkou. Pozrite si časť **6.2 Práca s kontrolnými vzorkami**, kde nájdete ďalšie informácie.

4.1.3.4 Označovanie sklíčok


Teraz ste pripravení vytlačiť štítky sklíčok a prilepiť ich na sklíčka:

- 1 kliknite na tlačidlo **Print labels** (Tlač štítkov) na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka);
- 2 V položke **Slide labels to print** (Tlač štítkov sklíčok) vyberte príslušnú možnosť a potom kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

Vytlačia sa štítky.

- 3 Uistite sa, že matná oblasť sklíčka (na ktorú sa bude štítok nalepať) je suchá, potom nalepte štítok s identifikátorom sklíčka alebo čiarovým kódom rovnobežne s koncom sklíčka. Štítok by mal smerovať pravou stranou nahor, keď sa sklíčko drží štítkom nahor.

Obrázok 4-4: Správne nalepený štítok




Viac informácií nájdete na obrazovke **6.6 Označovanie sklíčok**.

4.1.3.5 Vkladanie sklíčok

Vložte sklíčka nasledujúcim spôsobom:

- 1 Podržte sklíčko za koniec štítka tak, aby bola vzorka hore.
- 2 Pridržiť sklíčko nad prázdnu pozíciu na podnose na sklíčka tak, aby bol koniec štítka nad zárezom na bočnej časti podnosu (pozrite si **Obrázok 4-5**). Položte sklíčko nadol tak, aby zapadlo do zapustenej polohy v podnose.

Obrázok 4-5: Umiestnenie sklíčka do podnosu na sklíčka

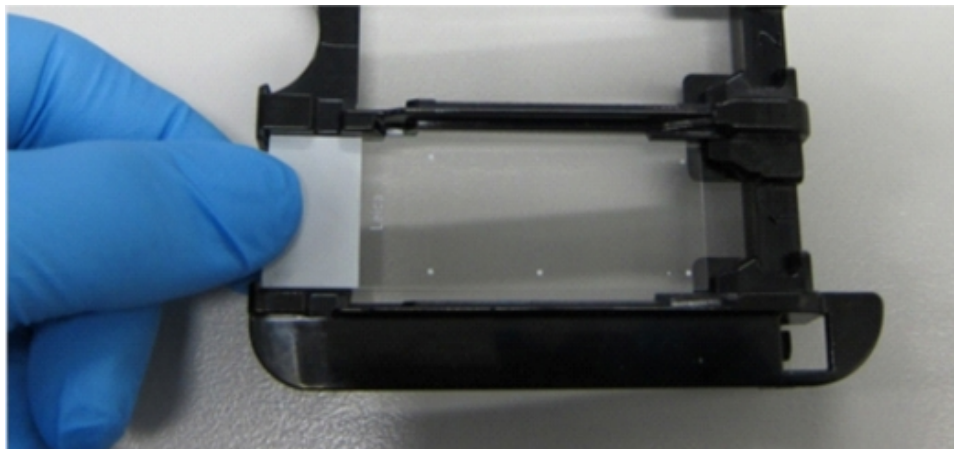

- 3 Držte krycie sklíčko Covertile za koniec a položte ho na sklíčko tak, že vložíte výčnelok na hrdle krycieho sklíčka Covertile do priehlbiny v podnose na sklíčka (zakrúžkované na **Obrázok 4-6**). Vďaka novému dizajnu krycích sklíčok Covertile by sa slovo „Leica“ vytlačené na krycom sklíčku Covertile malo čítať správne, čo znamená, že krycie sklíčko Covertile je v správne orientované.

Obrázok 4-6: Umiestnenie krycieho sklíčka Covertile na podložné sklíčko



- 4 Keď sú všetky podložné sklíčka a krycie sklíčka Covertile vložené do podnosu, nadvihnite podnos a koniec pri vstupe položte do prázdnej zostavy na farbenie sklíčok. Zasuňte podnos až na doraz do modulu. Podnos by sa mal ľahko zasunúť a keď je na svojom mieste, mal by hlasno zacvaknúť.

4.1.4 Vkladanie reagensí

Teraz je potrebné umiestniť na moduly spracovania detekčný systém (BOND Polymer Refine) a nádoby na značkovače (pre *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6).




VÝSTRAHA: Nádoby na reagencie sa môžu počas prepravy nakláňať, pričom zostanú zvyšky reagencie okolo uzáveru. Pri otváraní nádob na reagencie vždy používajte schválenú ochranu očí, rukavice a ochranný odev.

Ak chcete vložiť reagencie do modulu spracovania BOND-III alebo BOND-MAX, postupujte takto:

- 1 Nádoby na značkovače vložte do podnosov na reagencie zarovnaním drážok na zadných stranách nádob so zarážkami v priehradkách na podnosy. Zatlačte nadol, kým nádoby nezacvaknú na svoje miesto.

Nádoby na značkovače je možné v prípade potreby umiestniť do náhradných priehradiek v podnosoch detekčného systému.

Obrázok 4-7: Nádoba na reagencie v podnose na reagencie

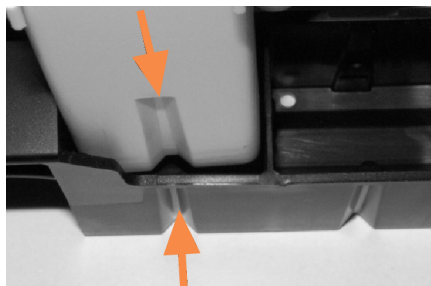


Šípky označujú drážky v nádobe na reagencie a v podnose na reagencie.

- 2 Otvorte všetky nádoby na značkovače a nádoby detekčného systému. Kliknutím otvorte veká a otočte ich dozadu, až kým nezapadnú do úchytiakov na zadnej strane nádob.
- 3 Uistite sa, že horné štítky s čiarovým kódom sú úplne prilepené na nádobách – všetky odlepujúce sa štítky pritlačte na miesto.
- 4 Utrite všetku vlhkosť/kondenzáciu z horného štítku s čiarovým kódom.

- 5 Umiestnite nádoby na reagenty na platformu reagentí modulu spracovania. Na navedenie zásobníkov do plošiny použite vodiace lišty na plošine.

Keď podnos dosiahne koniec plošiny, mal by sa aktivovať zámok. Kontrolka LED podnosu sa zmení na zelenú, čo znamená, že zásobník je na svojom mieste.

Obrázok 4-8: Vkladanie podnosu na reagenty

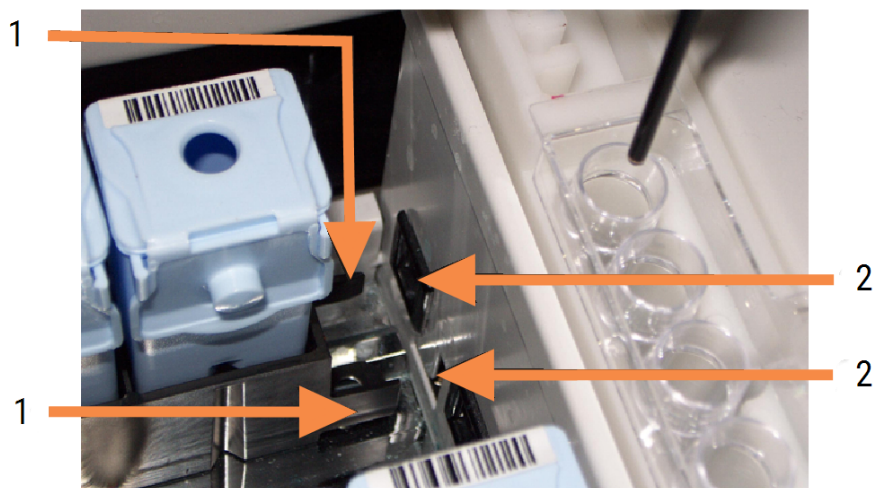


Legenda

- 1 Blokovací mechanizmus podnosu
- 2 Blokovací port modulu spracovania

- 6 V softvéri kliknutím na kartu modulu spracovania zobrazíte obrazovku **System status** (Stavová obrazovka systému).

Stĺpec s reagensiou je zobrazený svetlejšou farbou s tmavým okrajom, čo znamená, že daný podnos sa bude snímať. Systém BOND zobrazí identifikátor na reagensciách hned', ako bude k dispozícii hlavný robot, a potom aktualizuje ikony reagenscií.

Obrázok 4-9: Stav podnosu na reagenzie, ako je zobrazený na stavovej obrazovke systému

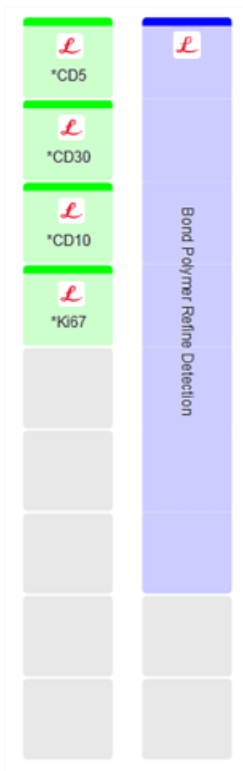

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s reagensiami, softvér zobrazí na tejto obrazovke ikonu upozornenia. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu získate ďalšie informácie (pozrite si časť [5.1.3.4 Riešenie problémov s reagensiou](#)).



Podnosy na reagenzie môžete vybrať kedykoľvek, keď na paneli svieti kontrolka LED nazeleno. Ak bude potrebná reagenzia v podnose do 2 minút, kontrolka LED sa rozsvieti načerveno, čo znamená, že podnos je uzamknutý (pozrite si časť [2.2.6.5 Platforma reagenscií](#)).

4.1.5 Spustenie protokolu

Keď sú sklíčka a reagentie nakonfigurované a vložené v module spracovania, môžete začať so spracovaním.


- 1 Skontrolujte, či je veko modulu spracovania zatvorené.
- 2 Stlačte tlačidlo Load/Unload (Vložiť/Vybrať) na prednom kryte pod vloženým podnosom na sklíčka.

BOND-III alebo BOND-MAX uzamkne podnos a kontrolka LED podnosu na sklíčka by mala svietiť oranžovo.



Počúvajte, ako sa zámok podnosu na sklíčka uzamkne – v prípade hlasného praskania alebo zvukov cvakania je pravdepodobné, že krycie sklíčka Covertile sú mimo správnej polohy. V takom prípade odomknite podnos, vyberte a skontrolujte sklíčka a krycie sklíčka Covertile.

- 3 Hneď ako bude k dispozícii hlavný robot, systém BOND nasníma sklíčka.
Ak niektoré z požadovaných reagentii nie sú k dispozícii, softvér zobrazí pod zoznamom sklíčok ikonu upozornenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite pravým tlačidlom myši na túto ikonu.
- 4 Pokiaľ sa nezistili žiadne nerozpoznané alebo nekompatibilné sklíčka, sklíčka sú teraz pripravené na farbenie. Lišta priebehu bude v začiatkovej fáze (pozrite si časť [5.1.6.2 Priebeh cyklu](#)) a stav cyklu bude **Slides ready** (Pripravené sklíčka) (pozrite si časť [5.1.6.1 Stav cyklu](#)).


Kliknutím na položku  spustíte protokol (alebo môžete nastaviť, aby sa modul spracovania spustil neskôr; pozrite si časť [5.1.8 Odložený štart](#)).

Systém naplánuje cyklus, potom sa indikátor priebehu prepne do fázy spracovania a stav cyklu bude **Proc (OK)** (Sprac. (OK)).



Mali by ste spustiť iba jeden cyklus naraz počkať, kým sa tento cyklus spustí/naplánuje, a až potom spustiť ďalší cyklus. Po každom spustení počkajte chvíľu, aby ste sa uistili, že bol úspešne spustený. Ak nie, stav cyklu sa nastaví na možnosť **Rejected/Slides ready** (Odmietnuté/sklíčka pripravené). Pozrite si časť [5.1.6.1 Stav cyklu](#).

Počas spracovania cyklu tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) pre zostavu na farbenie sklíčok neuvolní podnos na sklíčka.

Kliknite na položku  pod podnosom na obrazovke **System status** (Stavov systému), aby ste ukončili cyklus (pozrite si časť [5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu](#)).

4.1.6 Dokončenie

Po dokončení cyklu spracovania bliká ikona karty modulu spracovania (pozrite si časť [5.1.1 Karty modulu spracovania](#)). Ak sa počas cyklu vyskytli neočakávané udalosti, text na displeji je červený a pod podnosom a na dotknutých sklíčkach sa objaví symbol oznámenia. V takom prípade skontrolujte obrazovku **System status** (Stav systému) s ikonami upozornení. Kliknutím na tieto ikony pravým tlačidlom myši zobrazíte informácie o stave, ktorý si vyžaduje pozornosť. Je potrebné skontrolovať aj správu o udalostiach cyklu (pozrite si časť [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)), kde nájdete ďalšie informácie o problémoch počas cyklu.

Po skončení cyklu:

- 1 Vyberte podnosy na reagentie.

Veká nádob na reagentie pevne uzavrite, aby sa zabránilo vyparovaniu reagentií, a reagentie okamžite uložte podľa odporúčaní na štítku alebo hárku s informáciami o reagentiách.

- 2 Vygenerujte správu o udalostiach cyklu (pozrite si časť [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)).
- 3 Stlačte tlačidlo Load/Unload (Vložiť/vybrať) a vyberte podnosy na sklíčka z modulu spracovania.



Počúvajte, či vyprázdňovaní podnosu nebudete počuť zvuky praskania alebo cvakania. Ak áno, skontrolujte, či sa v zostave na farbenie sklíčok a okolo nej nenachádzajú zlomené sklíčka, k čomu môže dôjsť v nepravdepodobnom prípade rozdrvenia nevyrovnaného sklíčka. Ak áno, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

- 4 Podnos na sklíčka položte na rovný a stabilný povrch. Odstráňte krycie sklíčka Covertile tak, že podržíte štítok sklíčka a potom opatrne zatlačíte hrdlo krycieho sklíčka Covertile nadol, aby ste zdvihli koniec krycieho sklíčka Covertile.



Neprisúvajte krycie sklíčko Covertile cez povrch sklíčka, pretože by ste mohli poškodiť tkanivo, čo by sťažilo čítanie sklíčok.

- 5 Zdvihnite krycie sklíčka Covertile z podložných sklíčok a vyčistite ich podľa opisu v časti [12.3 krycie sklíčka Covertile](#).
- 6 Vyberte sklíčka a pokračujte ďalším krokom pri ich spracovaní podľa postupov laboratória.

Môžete sa rozhodnúť znova spustiť akékoľvek sklíčka (pozrite si časť [9.3 Vlastnosti sklíčka a opätovné spustenie sklíčka](#)).

Týmto sa dokončí váš prvý cyklus na systéme BOND.

4.2 BOND-PRIME



Podrobné informácie nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

4.2.1 Predbežné kontroly a uvedenie do prevádzky

- 1 Zapnite riadiace zariadenie (a terminál pre BOND-ADVANCE) a otvorte klinického klienta BOND.
- 2 Skontrolujte, či značkovač sklíčok obsahuje štítky a tlačovú pásku a či je zapnutý.
- 3 Inicializujte modul spracovania BOND-PRIME a prihláste sa.
- 4 Dokončite všetky úlohy poradia opatrení, ktoré ukazujú, že akcia sa vyžaduje „čo najskôr“ alebo „teraz“.

4.2.2 Kontroly protokolov a reagensí

Použite *IHC Protocol F a BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces využíva aj pomocný BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096). V opačnom prípade postupujte podľa krokov opísaných v časti [4.1.2 Kontroly protokolov a reagensí](#).

4.2.3 Nastavenie sklíčok

Postupujte podľa krokov opísaných v časti [4.1.3 Nastavenie sklíčok](#) (až po označenie sklíčok štítkami, vrátane tohto k roku).

4.2.4 Na module spracovania BOND-PRIME:

- 1 Vložte podnos na reagensie a podnos detekčného systému.
- 2 Vložte sklíčka do zásuvky na predbežné vloženie.
- 3 Sklíčka sa potom naskenujú, presunú zo zásuvky a automaticky spracujú.
- 4 Po dokončení procesu farbenia sa sklíčka preniesú do zásuvky na vykladanie, kde budú hydratované, kým ich neodstránite.

5

Stavové obrazovky BOND-III a BOND-MAX (na riadiacom zariadení BOND)



Stavové obrazovky v riadiacom zariadení BOND sa nepoužívajú pre systém BOND-PRIME. Informácie o stave systému BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

V klinickom klientovi má každý modul spracovania dve stavové obrazovky a obrazovku údržby, ktoré sa zvolia na záložkách v ľavej hornej časti okna po zvolení modulu spracovania na záložkách vľavo. Obrazovka **System status** (Stav systému) ponúka možnosť riadenia systému z pohľadu, ktorý zobrazuje umiestnenie sklíčok a reagencií v module. Obrazovka **Protocol status** (Stav protokolu) poskytuje informácie o priebehu protokolu pre jednotlivé sklíčka. Obrazovka **Maintenance** (Údržba) obsahuje príkazy pre celý rad operácií údržby.

- [5.1 Stavová obrazovka systému](#)
- [5.2 Obrazovka stavu protokolu](#)
- [5.3 Obrazovka údržby](#)


5.1 Stavová obrazovka systému



Táto obrazovka sa vzťahuje len na moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX. Informácie o stave modulu spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Táto obrazovka vám umožňuje kontrolovať spracovanie a zobrazuje podrobnosti o vložených podnosoch na sklíčka a reagenciách, ako aj o stave reagencií, odpadu a blokovaní v systéme.

Obrázok 5-1: Obrazovka **System status** (Stav systému) pre modul spracovania BOND-III

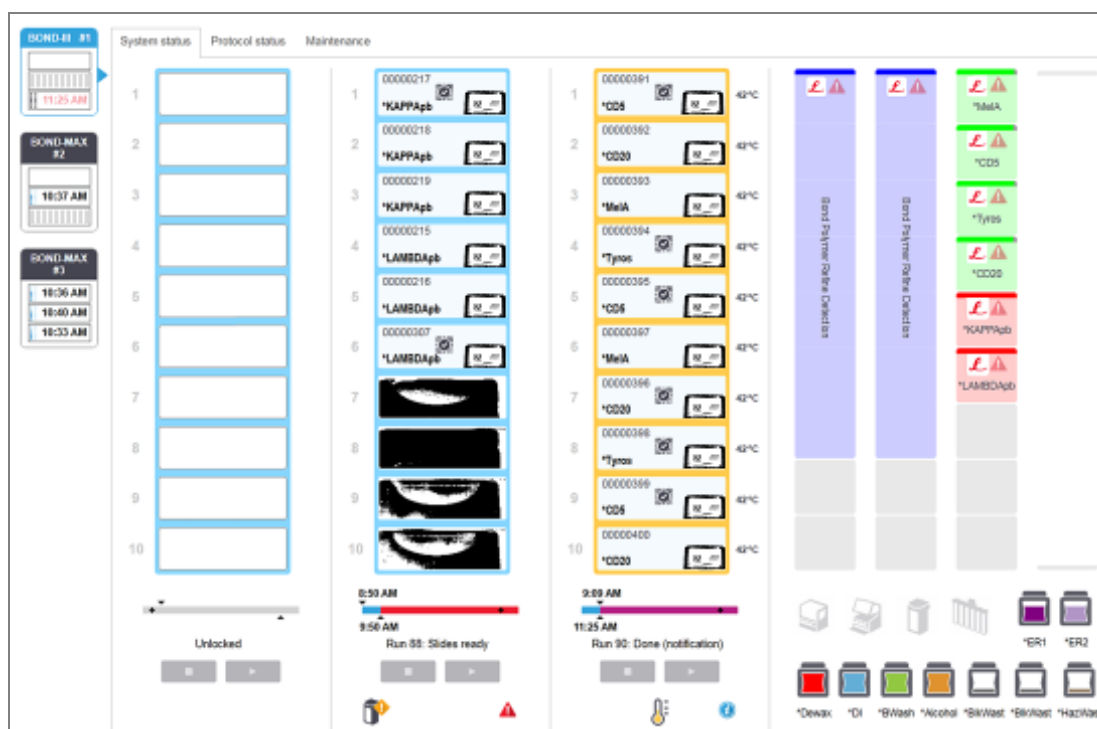

Karty modulu spracovania v ľavej časti stavových obrazoviek poskytujú vizuálny súhrn stavu pridruženého modulu spracovania. Kliknutím na záložku zobrazíte podrobný stav modulu spracovania.

Viac informácií nájdete nasledujúcich častiach:

- [5.1.1 Karty modulu spracovania](#)
- [5.1.2 Stav hardvéru](#)
- [5.1.3 Stav reagencií](#)
- [5.1.4 Informácie o sklíčku](#)
- [5.1.5 Identifikácia sklíčok v systéme](#)
- [5.1.6 Ukazovateľ priebehu cyklu](#)
- [5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu](#)
- [5.1.8 Odložený štart](#)

5.1.1 Karty modulu spracovania

Softvér zobrazuje v ľavej časti obrazovky kartu pre každý modul spracovania v systéme (jednomiestny) alebo v súbore, ku ktorému je klient pripojený (BOND-ADVANCE). Ak nie je dostatok vertikálneho priestoru na zobrazenie všetkých modulov spracovania, posúvajte sa hore a dole pomocou zobrazených tlačidiel so šípkami (šípka nahor zobrazená vpravo).



Obrázok 5-2: Karty modulu spracovania (BOND-III)



Každá karta zobrazuje názov modulu spracovania a obdĺžnikové ikony zobrazujú stav zostáv na farbenie sklíčok (pozrite nižšie). Ak chcete zobraziť obrazovku **System status** (Stav systému) pre modul spracovania, kliknite na záložku. Keď karta modulu spracovania vybratá, zobrazí sa okolo nej modrý obrys a šípka smerujúca doprava (pozrite vyššie).

5.1.1.1 Stav zostavy na farbenie sklíčok

Nižšie sú uvedené príklady stavov zostavy sklíčok, s ktorými sa môžete stretnúť na karte modulu spracovania.

Pred cyklom:



Prázdny obdĺžnik: žiadny podnos nie je prítomný alebo nie je uzamknutý.




Animované identifikačné čísla a plné pruhy: podnos je snímaný.



Ikona podnosu so sklíčkami: štítky sklíčok boli nasnímané a podnos je pripravený na spustenie.

Počas cyklu:




Zobrazenie času čiernou farbou s pohybujúcimi sa bodkami vľavo: podnos je v cykle, nie sú hlásené žiadne neočakávané udalosti. Zobrazený čas predstavuje odhadovaný čas dokončenia pre podnos.



Čas sa zobrazuje červenou farbou s pohybujúcimi sa bodkami vľavo: podnos je v cykle s hlásenými neočakávanými udalosťami. Zobrazený čas predstavuje odhadovaný čas dokončenia pre podnos.

Po cykle:



Čas bliká a je zobrazený čiernou farbou so statickými bodkami vľavo: cyklus bol dokončený v naplánovanom čase bez akýchkoľvek neočakávaných udalostí.









Čas bliká a je zobrazený červenou farbou so statickými bodkami vľavo: cyklus bol dokončený v naplánovanom čase, no vyskytli sa neočakávané udalosti.






Cyklus bol prerušený.

5.1.1.2 Statusy modulu spracovania

Softvér nepretržite monitoruje stav systému a na karte modulu spracovania sa môžu zobraziť nasledujúce ikony:

0	Význam	Ikona	Význam
	Modul spracovania nie je pripojený.		Výstraha: Softvér BOND zistil neočakávaný stav.
	(Bliká) Modul spracovania sa spúšťa.		Alarm (bliká): Na pokračovanie v prevádzke vyžaduje modul spracovania zásah používateľa.
	Na module spracovania momentálne prebiehajú opravy.		Modul spracovania prechádza údržbou.

5.1.2 Stav hardvéru


Ikony v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazujú výstrahu  alebo alarm , ak došlo k problému s niektorou časťou systému BOND, alebo zobrazujú informačný indikátor , ak má systém všeobecné oznámenie. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu získate ďalšie informácie.



Všeobecná chyba systému alebo pripomenka údržby.



Zobrazuje sa, keď je počas cyklu farbenia otvorené veko alebo ak sú otvorené dvere pre nádobu na nebalený materiál (len systém BOND-MAX). Tieto musia byť zatvorené, aby bolo možné prevádzkovať modul spracovania.

Ak farbenie neprebieha, zobrazí sa namiesto toho informačný indikátor .



Chýbajúca alebo nedostatočná reagencia.



Modul spracovania spustil inicializáciu a ešte sa nepokúsil nasnímať zmiešavaciu stanicu.



Počas inicializácie nebola rozpoznaná zmiešavacia stanica. Je možné, že stanica nebola vložená, alebo môže byť vložená, ale čiarový kód nebol rozpoznávaný.

V prípade potreby vložte do modulu spracovania čistú zmiešavaciu stanicu. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a postupujte podľa pokynov, aby ste informovali systém, že zmiešavacia stanica je na svojom mieste.



Stav zmiešavacej stanice pri inicializácii je znečistený (napr. stanica bola znečistená pri poslednom zatvorení modulu spracovania).

Uistite sa, že na mieste je čistá zmiešavacia stanica, potom kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potvrdíte.



Čistenie zmiešavacej stanice nebolo dokončené.

Je možné, že budete môcť naďalej používať zostávajúce čisté fľaštičky. V opačnom prípade budete musieť reštartovať modul spracovania, aby sa oznámenie vymazalo.

Ak oznámenie pretrváva, môže to znamenať problém s fluidikou, kontaktujte podporu zákazníka.



K dispozícii nie sú žiadne čisté zmiešavacie fľaštičky.

Počkajte, kým modul spracovania vyčistí niektoré fľaštičky, a potom pokračujte obvyklým spôsobom. Ak fľaštičky nie sú vyčistené, možno budete musieť reštartovať modul spracovania. Ak oznámenie pretrváva, môže to znamenať problém s fluidikou, kontaktujte podporu zákazníka.




Ak je to potrebné, môžete zmiešavaciu stanicu vyčistiť manuálne. Pozrite si časť [12.7 Premývací blok a zmiešavacia stanica](#).

5.1.2.1 Chyby ohrievača

Každý z ohrievačov sklíčok BOND-III a BOND-MAX sa monitoruje nezávisle a v prípade chyby teploty sa označí ako chybný, (pozrite si [Obrázok 5-3](#)). Ak je indikovaný chybný ohrievač, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Obrázok 5-3: Individuálna chyba ohrievača



Mali by ste sa pokúsiť spustiť sklíčko, ktoré vyžaduje zahrievanie v polohe označenej ako chybná. Ak počas cyklu nefunguje ohrievanie, môže dôjsť k narušeniu sklíčka v tejto polohe. Ak porucha ohrievača predstavuje bezpečnostné riziko, môže dôjsť k zastaveniu zahrievania všetkých sklíčok na module spracovania (pozrite si [Obrázok 5-4](#)).

Obrázok 5-4: Sivé symboly ohrievača v každej polohe označujú úplné vypnutie vyhrievania



Po vypnutí vyhrievania sklíčok musíte vypnúť a reštartovať modul spracovania, aby ste vyčistili zámok ohrievača. Polohy sklíčok môžete naďalej používať s chybnými ohrievačmi, pokiaľ sklíčka, ktoré sa tam spracovávajú, nevyžadujú zahrievanie.

5.1.2.2 Indikácia teploty

Ak zostava na farbenie sklíčok presiahne okolitú teplotu, v dolnej časti obrazovky **System status** (Stav systému) sa objaví indikátor teploty.


Indikátor teploty v dolnej časti obrazovky signalizuje, že zostava na farbenie sklíčok je teplá alebo horúca.

Obrázok 5-5: Indikátor teploty – teplý (vľavo) a horúci (vpravo)



Hranice podnosov na sklíčka na obrazovke **System status** (Stav systému) tiež zmení farbu na indikáciu teploty: modrá, keď má podnos okolitú teplotu, oranžový, keď je teplý, a červený, keď je horúci.

Obrázok 5-6: Hranice indikácie teploty podnosov na sklíčka: teplé (vľavo) a horúce (vpravo)

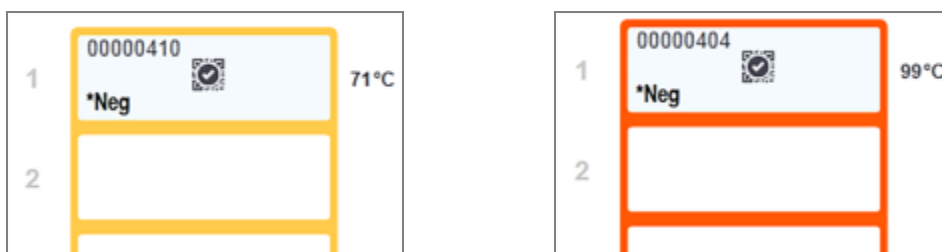


Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklíčok a ich okolím. Môžu byť veľmi horúce a spôsobiť vážne popáleniny. Po ukončení činnosti nechajte zostavy na farbenie sklíčok a ich okolie vychladnúť dvadsať minút.

5.1.3 Stav reagencií


Na pravej strane obrazovky **System status** (Stav systému) je zobrazený stav zistených reagencií. V nižšie uvedených častiach sa opisujú použité ikony a spôsob vyriešenia niektorých problémov s reagenciami uvedených na obrazovke.

- [5.1.3.1 Systémy reagencií](#)
- [5.1.3.2 Nádoby na reagenty](#)
- [5.1.3.3 Hladiny reagencií](#)
- [5.1.3.4 Riešenie problémov s reagentmi](#)
- [5.1.3.5 Oprava nezistených reagencií](#)
- [5.1.3.6 Stav nádoby na nebalený materiál](#)

5.1.3.1 Systémy reagencií

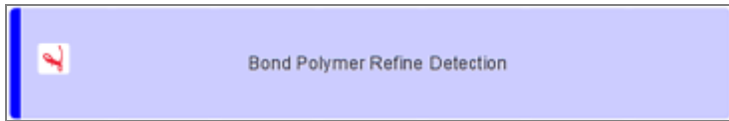

Detekčný systém BOND




Čistiaci systém BOND

5.1.3.2 Nádoby na reagenty



Ikony nádob na reagenty majú hviezdičku (*) pred názvami reagentov dodávaných spoločnosťou BOND.



Hotová primárna protilátka BOND.

Údaje o týchto reagentoch zadáva automaticky softvér BOND, keď ich zaregistrujete. Je uvedený skrátený názov reagentu.




Hotová sonda IHS BOND.

Údaje o týchto reagentoch zadáva automaticky softvér BOND, keď ich zaregistrujete. Je uvedený skrátený názov reagentu.



Primárna protilátka dodávaná používateľom v otvorenej alebo titračnej nádobe BOND.

Podrobnosti o týchto reagentoch sa musia zadať manuálne na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagentov) pred registráciou, pri registrácii je potrebné uviesť číslo šarže a dátum expirácie. Je uvedený skrátený názov reagentu.



Používateľom dodávaná sonda ISH v otvorenej alebo titračnej nádobe BOND.

Podrobnosti o týchto reagentoch sa musia zadať manuálne na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagentov) pred registráciou, pri registrácii je potrebné uviesť číslo šarže a dátum expirácie. Je uvedený skrátený názov reagentu.



Hotové pomocné reagenty BOND.

Údaje o týchto reagentoch zadáva automaticky softvér BOND, keď ich zaregistrujete. Je uvedený skrátený názov reagentu.



Enzým BOND v otvorenej alebo titračnej nádobe BOND.

Enzým BOND musí byť pripravený používateľmi a vložený do otvorených nádob, ale detaily nastavenia reagentov sú vopred definované v softvéri BOND. Pri registrácii sa vyžaduje iba číslo šarže a dátum expirácie.



Pomocná reagentia dodávaná používateľom v otvorenej alebo titračnej nádobe BOND.

Podrobnosti o týchto reagentoch sa musia zadať manuálne na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagentov) pred registráciou, pri registrácii je potrebné uviesť číslo šarže a dátum expirácie. Je uvedený skrátený názov reagentu.

**Softvér nezistil reagenciu v tejto polohe.**

Ak je prítomná reagencia, pozrite si časť **5.1.3.5 Oprava nezistených reagencií**, kde nájdete údaje o tom, ako problém vyriešiť. Ak snímač často nesprávne nasníma identifikátory, vyčistite okno snímača identifikátorov (pozrite si časť **12.9 Snímač identifikátorov**).

**Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite pravým tlačidlom myši na symbol informácií.**

Je možné, že softvér BOND nerozpoznal reagenciu. V takom prípade pomocou ručného skenera nasnímajte reagenciu a pridajte ju do inventára. Ak je identifikátor poškodený, zadajte ho manuálne. Ďalšie informácie si pozrite v časti **8.3.3 Registrácia reagencií a systémov reagencií**.

**Softvér BOND zistil problém s touto reagenciou alebo systémom reagencií.**

Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite pravým tlačidlom myši na symbol oznámenia.


5.1.3.3 Hladiny reagencií

Ikony pre systémy reagencií označujú iba tri hladiny objemu na obrazovke **System status** (Stav systému):

	Plné až približne na 20 % plné
	Nízke (od asi 20 % zostávajúcej po takmer prázdne)
	Prázdne

Ikony pre hotové reagencie a otvorené nádoby označujú hladiny reagencií presnejšie.

Obrázok 5-7: Príklady hladín hotových reagencií uvedené na obrazovke **System status** (Stav systému)

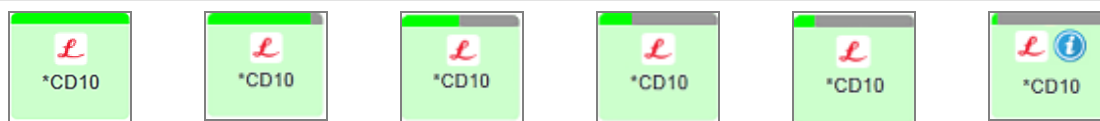

Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie o zozname reagencií alebo systéme reagencií, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a vyberte položku **Inventory...** (Inventár...) z rozbaľovacej ponuky. Zobrazí sa okno **Reagent inventory details** (Údaje o inventári reagencií). Pozrite si časť **8.3.2 Údaje o reagencii alebo systéme reagencií**.

5.1.3.4 Riešenie problémov s reagenciou

Ak softvér BOND zistí problém s reagenciou potrebnou na spracovanie pred začiatkom procesu, zobrazí ikonu upozornenia na obrázku nádoby na reagencie pod podnosom na sklíčka na obrazovke **System status** (Stav systému). Ak sa problém vyskytne počas cyklu, nad ikonou stavu hardvéru reagencie sa zobrazí ikona upozornenia, ako je to opísané vyššie v tejto sekcii. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o probléme, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu upozornenia.

Ak potrebujete vymeniť alebo pridať reagenciu, vyberte podnos na reagencie obsahujúci problémovú reagenciu, vymeňte alebo pridajte požadovanú reagenciu a podnos znova vložte.




Ak spracovanie už prebieha a reagencia v konkrétnom podnose bude potrebná do 2 minút, nebudete možné daný podnos vybrať bez prerušenia cyklu. To znázorňuje indikátor, ktorý pre daný podnos na reagencie svieti načerveno.

5.1.3.5 Oprava nezistených reagencií


Ak sa reagencia nezistí alebo sa súprava zistí iba čiastočne, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Skontrolujte, či:
 - je nádoba na reagencie správne umiestnená na podnose na reagencie,
 - je otvorený uzáver nádoby na reagencie a prichytený k zadnej časti nádoby,
 - je na hornej prednej strane nádoby nepoškodený identifikátor s čiarovým kódom reagencie.
- 2 Skontrolujte, či je reagencia zaregistrovaná v zozname reagencií.
 - Ak reagencia nie je zaregistrovaná, zaregistrujte ju podľa opisu v časti **8.3.3 Registrácia reagencií a systémov reagencií**
- 3 Teraz môžete byť:
 - a vybrať podnos na reagencie (potom si poznačte jedinečný identifikátor balenia (UPI) príslušnej reagencie) a znova ho vložiť, aby systém znova automaticky identifikoval podnos na reagencie, alebo
 - b ak opätovné vloženie podnosu na reagencie nie je účinným riešením, môžete ho identifikovať manuálne. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu nádoby na obrazovke **System status** (Stav systému) a vo vedľajšej ponuke kliknite na tlačidlo **Select...** (Vybrať...). Zadaťte UPI vyššie uvedenej reagencie a kliknite na tlačidlo **OK**.

Na obrázku sa zobrazí obrázok  na identifikáciu reagencie, ktorá bola manuálne zadaná alebo čiastočne identifikovaná. Symbol (a manuálne identifikovaná reagencia) zmizne, ak sa vyberie podnos na reagencie.


Ak manuálne zadáte číslo UPI reagencie, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

Obrázok 5-8: Oznámenie o manuálne zadanej reagencii

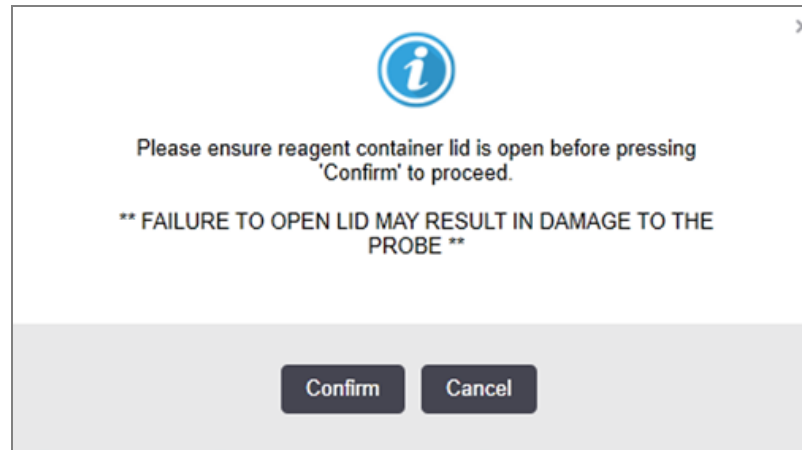


Keď systém identifikuje manuálne zadané číslo UPI alebo modul spracovania automaticky identifikuje reagenčiu, zobrazí sa nasledujúca ikona.

Obrázok 5-9: Manuálne zadaná alebo automaticky identifikovaná reagenčia



Ak bola súprava identifikovaná iba čiastočne a modul spracovania automaticky identifikoval niektoré nádoby, zobrazí sa nasledujúca správa a ikona.

Obrázok 5-10: Oznámenie o automaticky identifikovanej súprave

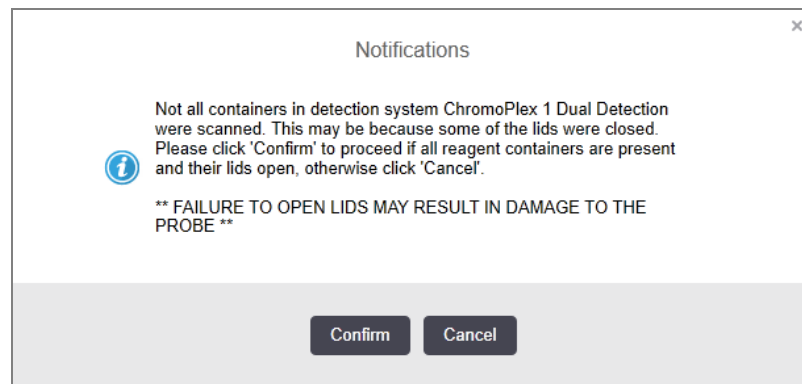

Obrázok 5-11: Automaticky identifikovaná súprava



5.1.3.6 Stav nádoby na nebalený materiál

Pravá dolná časť obrazovky **System status** (Stav systému) zobrazuje ikony pre nádoby na nebalený odpad a reagentie. Každá nádoba je označená a farby zodpovedajú nainštalovaným nádobám. Polohy ikon nádob na nebalený materiál na obrazovke System status (Stavov systému) odrážajú fyzické polohy zodpovedajúcich priehradiek na nádoby na nebalený materiál na module spracovania.

Konkrétnu konfiguráciu nádob pre každý typ modulu spracovania si prečítajte v časti [2.2.7 Priehradka na nádoby na nebalený materiál](#).

Obrázok 5-12: Nádoby na nebalený materiál (konfigurácia BOND-III)



Obrázok 5-13: Nádoby na nebalený materiál (konfigurácia BOND-MAX).



Ikona úplne vpravo predstavuje nádobu na externý odpad

Nižšie sú uvedené opisy obsahu každej z vyššie uvedených nádob na nebalený materiál.

Štítok nádoby na nebalený materiál	Obsah nádoby na nebalený materiál
*Dewax	Roztok na odvoskovanie BOND
*DI	Deionizovaná voda
*BWash	Roztok BOND Wash Solution
*Alcohol	Etanol (reagenčného stupňa)
*BlkWast	Nebalený odpad
*HazWast	Nebezpečný odpad
*ER1	Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2	Roztok BOND Epitope Retrieval Solution 2

BOND-III

Softvér zobrazí hladiny v nádobách na nebalené reagenty a odpad BOND-III. Ak je zásoba reagentu nízka alebo je úroveň odpadu vysoká, môže sa v závislosti od závažnosti problému aktivovať zvukový alarm, pulzujúca kontrolka fľaše (biela alebo červená) a výstražná ikona zobrazená na stavovej obrazovke. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu zobrazíte správu s upozornením a vykonáte všetky kroky potrebné na vyriešenie problému. Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).



Ak sa zobrazí výstražný symbol, spracovanie sa pozastaví, kým sa problém nevyrieši.



Stav nádoby na nebalený materiál v okne **System status** (Stav systému) je synchronizovaný so systémom osvetlenia, ako je opísané v časti [Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál \(BOND-III\)](#) (Sekcia na strane 53).

Displej softvéru BOND-III zobrazuje interpretovanú hladinu vo fľaši na základe odhadu, koľko ďalších podložných sklíčok je možné spracovať pomocou nebalených reagentov. Na označenie stavov nádob na nebalený materiál sa používajú nasledujúce ikony:

Ikony objemu nádob na nebalené reagenty

Obrázok 5-14: Ikony objemu nádob na nebalené reagenty

Úroveň	Stav	Zásobníky	Odvoskovanie	Etanol	Deionizovaná voda	Pufer	HEIR1	HEIR2	Štítok	Fľaša
		GUI	Rozsah hlasitosti						Svetlá	
-	-	Fľaša odstránená	-	-					BIELA Bliká	Off (Vyp)
0	Pozastavenie prebiehajúcich dávky		0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 100	0 – 100	ČERVENÁ Bliká	ČERVENÁ Bliká
1	Nie je možné spustiť dávku		150 – 500	150 – 500	150 – 1000	150 – 1000	100 – 300	100 – 300	BIELA Bliká	BIELA Bliká
2	OK		500 – 750	500 – 750	1000 – 1500	1000 – 1500	300 – 500	300 – 500	BIELA	BIELA

Úroveň	Stav	Zásobníky	Odvoskovanie	Etanol	Deionizovaná voda	Pufer	HEIR1	HEIR2	Štítok	Fľaša
		GUI	Rozsah hlasitosti						Svetlá	
3	OK		750 – 2500	750 – 2500	1500 – 3500	1500 – 3500	500 – 1500	500 – 1500	BIELA	BIELA
4	OK		2500 – 5000	2500 – 5000	3500 – 5000	3500 – 5000	1500 – 2000	1500 – 2000	BIELA	BIELA



Objaví sa, ak nastane nasledujúce:

- reagentia dochádza a je potrebné ju okamžite doplniť,
- nádoba chýba,
- nedostatočný objem na spustenie cyklu.

Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).



alebo








Zobrazí sa, ak bol cyklus pozastavený, pretože nastane jedna z týchto situácií:

- reagentia dochádza a je potrebné ju okamžite doplniť (výstraha),
- nádoba chýba a je potrebná na spracovanie (alarm).

Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).

Ikony objemu nádob na odpad

Obrázok 5-15: Ikony objemu nádob na nebalený odpad

Úroveň	Stav	Fľaša na odpad	Štandardný odpad	Nebezpečný odpad	Štítok	Fľaša
		GUI	Rozsah hlasitosti		Svetlá	
-	-	Fľaša odstránená	-	-	BIELA Bliká	Off (Vyp)
0	OK		0 – 1100	0 – 1100	BIELA	Off (Vyp)
1	OK		1100 – 3000	1100 – 3000	BIELA	BIELA (len 1 prúžok)
2	OK		3000 – 3900	3000 – 3900	BIELA	BIELA
3	Nie je možné spustiť dávku		3900 – 4800	3900 – 4800	BIELA Bliká	BIELA Bliká
4	Pozastavenie prebiehajúcej dávky		4800 – 5000	4800 – 5000	ČERVENÁ Bliká	ČERVENÁ Bliká



Objaví sa, ak nastane nasledujúce:

- odpad je takmer plný a je potrebné ho okamžite vyprázdniť,

Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).



alebo



Zobrazí sa, ak bol cyklus pozastavený, pretože nastane jedna z týchto situácií:

- nádoba na odpad je plná a je potrebné ju okamžite vyprázdniť (výstraha),
- nádoba chýba a je potrebná na spracovanie (alarm).

Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).

BOND-MAX

Keď softvér zistí problém (napríklad objem v nádobe s reagentiou je nízky alebo objem v nádobe na odpad je vysoký), nad nádobou na nebalený materiál zobrazí ikonu upozornenia (ako je uvedené vyššie). Podrobnosti zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu oznámenia.

5.1.4 Informácie o sklíčku

V častiach nižšie sú uvedené ikony, ktoré slúžia na zobrazenie informácií o sklíčkach na obrazovke **System status** (Stav systému). Opísané sú tiež možnosti v kontextovej ponuke sklíčka.

- [5.1.4.1 Ikony sklíčok](#)
- [5.1.4.2 Kontextová ponuka podnosu na sklíčka](#)
- [5.1.4.3 Oznámenia udalostí sklíčok](#)
- [5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklíčka](#)

5.1.4.1 Ikony sklíčok

Na obrazovke **System status** (Stav systému) je zobrazené grafické znázornenie každého z troch podnosov na sklíčka s ikonou pre každé sklíčko. Ikony sklíčok označujú stav každého sklíčka.


Váš systém používa 2D čiarové kódy. Ikony sklíčok môžete voliteľne nakonfigurovať tak, aby obsahovali zachytené snímky štítkov sklíčok. Ak chcete zmeniť existujúce nastavenia, kontaktujte podporu zákazníka.

Príklady ikon sklíčok sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Ikony sklíčok pre štítky s čiarovým kódom




Na tejto pozícii nie je sklíčko alebo je sklíčko nasnímané, ale systém ho nedokáže identifikovať

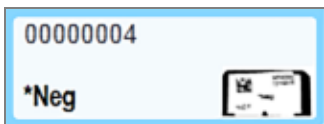


Sklíčko je nasnímané a automaticky identifikované
(pozrite si časť [5.1.5.1 Automatická identifikácia sklíčok](#))



Sklíčko je nasnímané a je manuálne identifikované – všimnite si symbol (v červenom krúžku) na sklíčku
(pozrite si časť [5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme](#))

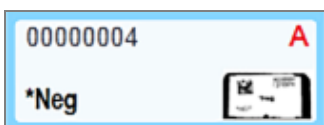

Sklíčko je nekompatibilné s jedným alebo viacerými sklíčkami na podnose
(pozrite si časť [5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklíčka](#))

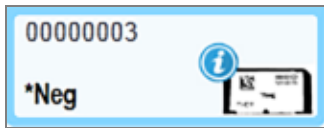

Spracovanie sklíčka s oznámením o udalosti
(pozrite si časť [5.1.4.3 Oznámenia udalostí sklíčok](#))

Dvakrát kliknite na sklíčka, ktoré systém BOND rozpoznal, aby ste pre ne otvorili dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčok). Ak cyklus nebol spustený, v dialógovom okne môžete upraviť údaje o sklíčku, budete však musieť pre sklíčko vytlačiť nový štítok, vybrať podnos a nalepiť nový štítok a opätovne ho vložiť podnos.


5.1.4.2 Kontextová ponuka podnosu na sklíčka

Pravým tlačidlom myši kliknite na grafické znázornenia podnosu na sklíčka na obrazovke **System status** (Stav systému), kde nájdete niekoľko možností pre sklíčko alebo podnos.

Príkaz	Opis
Select manually... (Vybrať manuálne...)	Povolené, ak sklíčko nebolo automaticky identifikované. Vyberte, ak chcete otvoriť dialógové okno Slide identification (Identifikácia sklíčka), ktoré vám umožní spárovať sklíčko s nakonfigurovaným sklíčkom v systéme (pozrite si časť 5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme). Túto možnosť môžete vybrať aj vtedy, ak dvakrát kliknete na neidentifikované sklíčko.
Attention message... (Správa s upozornením...)	Ak sa na snímke zobrazuje upozornenie na udalosť, pozrite si správu s upozornením (pozrite si časť 5.1.4.3 Oznámenia udalostí sklíčok).
Run events (Udalosti cyklu)	Vytvorte správu o udalostiach cyklu (pozrite si časť 9.4 Správa o udalostiach cyklu).
Delayed start (Odložený štart)	Nastavte odložený štart pre cyklus (pozrite si časť 5.1.8 Odložený štart).

5.1.4.3 Oznámenia udalostí sklíčok

Obrázok 5-16: Sklíčko s oznámením udalostí

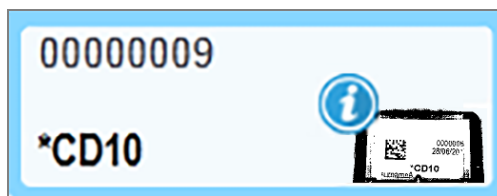

Ak počas spracovania dôjde k neočakávanej udalosti, na ikone sklíčka sa zobrazí výstražný symbol. Toto oznámenie nemusí nevyhnutne naznačovať, že farbenie bolo akýmkoľvek spôsobom nedostatočné. Keď sa objaví symbol s oznámením, operátor systému alebo dohliadajúci laboratória musia vykonať nasledujúce kroky, aby sa potvrdilo, že sklíčko je vhodné na diagnostické použitie.

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na sklíčko a vyberte položku **Run events** (Udalosti cyklu) na vygenerovanie správy o udalostiach cyklu (pozrite si časť [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)).

Všetky udalosti, ktoré spôsobili oznámenie, sa zobrazujú **tučným písmom**. Operátor systému alebo dohliadajúci laboratória by mali starostlivo zvážiť uvedené udalosti oznámenia, pretože poskytujú dôležité podrobnosti o povahe udalostí oznámenia týkajúcich sa sklíčok.

- 2 Farebné tkanivo starostlivo skontrolujte.
- 3 Opatrne skontrolujte všetky kontrolné sklíčka.


Ak laboratórium nie je schopné potvrdiť kvalitu farbenia, potom by mal byť patológ informovaný o oznámení alebo by sa mal test opakovať.

V rámci jednej správy o udalostiach cyklu sa môže vyskytnúť viac oznámení. Ak je cyklus ukončený stavom **Done (notification)** (Hotovo (oznámenie)), uistite sa, že je skontrolovaná celá správa. Ak je stav **Done (OK)** (Hotovo (v poriadku)), nie je potrebné správu kontrolovať.

5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklíčka

Ak systém BOND spozná nekompatibilné sklíčko, priradí všetkým sklíčkam na podnose tučné červené písmeno zobrazené v pravom hornom rohu. Sklíčka s rovnakým písmenom sú kompatibilné.

Obrázok 5-17: Nekompatibilné sklíčka

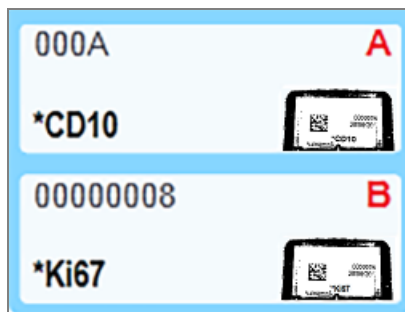

Vyberte podnos na sklíčka a odstráňte nekompatibilné sklíčka alebo zmeňte vlastnosti sklíčok (ak sa v nich vyskytli chyby), aby boli sklíčka kompatibilné. Ak zmeníte vlastnosti sklíčok, musíte znova vytlačiť štítky pre zmenené sklíčka a pripojiť ich pred opätovným uložením na podnos.

Ďalšie informácie o kompatibilitate sklíčok nájdete v časti [6.9 Kompatibilita sklíčok](#).

5.1.5 Identifikácia sklíčok v systéme

V najbežnejšom pracovnom postupe sú sklíčka so štítkami zo systému BOND alebo LIS načítané do modulu spracovania a potom automaticky identifikované. Identifikácia spočíva v načítaní 2D čiarových kódov na štítkoch. Ak je štítok znečistený alebo ho nie je možné prečítať z iného dôvodu, môžete ho manuálne identifikovať v softvéri BOND. Niektoré pracovné postupy používajú manuálnu identifikáciu štandardne (pozrite si časť [6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu](#)).

5.1.5.1 Automatická identifikácia sklíčok

Systém BOND dokáže automaticky identifikovať štandardné 2D čiarové kódy sklíčok BOND vytvorené pomocou značkovača sklíčok BOND (podľa opisu v časti [6.6 Označovanie sklíčok](#)) a sklíčka vytlačené systémom LIS, ktoré používajú rozpoznateľný formát čiarového kódu (pozrite si časť [11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS](#)). Ak je podnos na sklíčka uzamknutý, systém sa pokúsi identifikovať každý štítok sklíčka a porovnať ho so sklíčkom, na ktorom bol vytlačený štítok. Ak je možné štítok prirovnať k tlačnému sklíčku, sklíčko sa automaticky identifikuje a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Systém zachytí snímku každého štítku počas procesu identifikácie podložného sklíčka. Tieto snímky sa nachádzajú v nasledujúcich správach, ktoré poskytujú trvalý záznam o porovnaní sklíčok:

- [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)
- [9.5 Správa s údajmi o cykle](#)
- [9.6 Správa o prípade](#)


Ak systém nedokázal štítok identifikovať, musí sa sklíčko manuálne identifikovať pomocou postupu manuálnej identifikácie sklíčka (pozrite si nasledujúcu časť).

5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme

V systémoch, ktoré sú nastavené na snímanie každého štítku sklíčok, platí, že ak automatická identifikácia zlyhá, je možné sklíčka manuálne identifikovať, zatiaľ čo sa stále načítajú do modulu spracovania. Na manuálnu identifikáciu vloženého sklíčka použijete nasledujúci postup.


- 1 Ak systém nedokáže automaticky identifikovať sklíčko, v dialógovom okne System Status (Stav systému) sa zobrazí snímka štítku.

Obrázok 5-18: Sklíčko nie je automaticky identifikované



- 2 Ak chcete spustiť dialógové okno Slide identification (Identifikácia sklíčka), vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
 - a dvakrát kliknite na obrázok sklíčka alebo
 - b pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť **Select manually** (Vybrať manuálne).
- 3 Teraz sa zobrazí dialógové okno **Slide identification** (Identifikácia sklíčka).

Obrázok 5-19: Dialógové okno identifikácie sklíčka

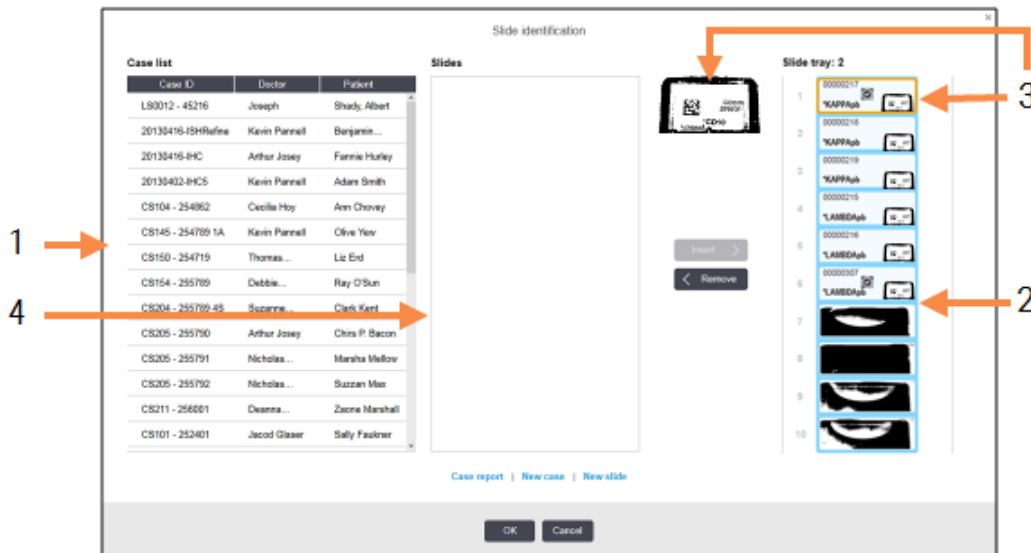

Na ľavej table (položka 1) sú uvedené všetky prípady s nespracovanými sklíčkami. V predvolenom nastavení sa zobrazujú iba prípady so sklíčkami, pre ktoré boli vytlačené štítky (môžete to zmeniť tak, aby zahŕňali prípady so sklíčkami, pre ktoré neboli vytlačené štítky, pozrite si časť [6.8.2.2 Externé štítky sklíčok](#)).

Štítky sklíčok na aktuálnej zostave na farbenie sklíčok sú zobrazené na pravej table (položka 2).

Sklíčko vybrané pri otvorení dialógového okna sa zvýrazní na pravej table (položka 3) a zobrazí sa zväčšené. Ak chcete vidieť ešte väčšie zväčšenie snímky, podržte kurzor nad sklíčkom v pravej table.



Stredná tabla (položka 4) zobrazuje sklíčka nakonfigurované pre prípad vybraný v ľavej table, kde sklíčka ešte neboli priradené k žiadnym sklíčkam zobrazeným na module spracovania. Opäť platí, že v predvolenom nastavení sa zobrazujú iba sklíčka, pre ktoré boli vytlačené štítky, ale toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa zobrazili všetky sklíčka nakonfigurované pre daný prípad (pozrite si časť [6.8.2.2 Externé štítky sklíčok](#)).

V tomto bode je možné vytvárať nové prípady a sklíčka pomocou tlačidiel **New case** (Nový prípad) a **New slide** (Nové sklíčko), ak je to potrebné (pozrite si pokyny v časti [6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu](#)).

Pokyny uvedené nižšie predpokladajú, že všetky požadované sklíčka sú už nakonfigurované v softvéri BOND.

- 4 Informácie, ktoré sú viditeľné na vybranej snímke štítky, na pravej strane použite na určenie prípadu, do ktorého dané sklíčko patrí. Vyberte tento prípad z tably prípadov (položka 1).

Do zoznamu sklíčok (položka 4) sú doplnené nespárované sklíčka nakonfigurované pre tento prípad.

- 5 Teraz spojte neidentifikované sklíčko so sklíčkom v zozname sklíčok (položka 4).
Vyberte sklíčko a kliknite na tlačidlo **Insert** (Vložiť).
Sklíčko sa odstráni zo zoznamu sklíčok a snímka v pravej table sa aktualizuje, čo znamená, že sklíčko bolo identifikované. Symbol  znamená, že sklíčko bolo zvolené manuálne.
Nasledujúci neidentifikovaný štítok sklíčka, ak existuje, je teraz označený na identifikáciu.
- 6 Zopakujte vyššie uvedené kroky a porovnajzte všetky neidentifikované sklíčka.
- 7 Po identifikácii všetkých sklíčok na podnose kliknite na **OK** a zatvorte dialógové okno. Ak kliknete na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť) všetky identifikácie sklíčok, ktoré ste mohli urobiť, sa stratia.
- 8 Na obrazovke **System status** (Stav systému) sa teraz zobrazujú všetky sklíčka na podnose s podrobnosťami o nich. Sklíčka, ktoré boli manuálne identifikované, obsahujú snímku štítku a symbol , ktorý znamená, že sklíčko bolo zvolené manuálne.

Obrázok 5-20: Manuálne identifikované sklíčko pred spracovaním



- 9 Manuálne zvolené sklíčka sú spracované normálne.

Snímka sklíčka sa zobrazuje v nasledujúcich správach, aby poskytla trvalý záznam o zhode sklíčka:

- [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)
- [9.5 Správa s údajmi o cykle](#)
- [9.6 Správa o prípade](#)

Systémy NIE sú nastavené tak, aby nasnímali každý štítok sklíčka

Tieto sklíčka je stále možné manuálne identifikovať, ale môže to vyžadovať vybratie podnosu na sklíčka.

Poznačte si identifikátor sklíčka a číslo pozície sklíčka (vyrazené na podnose na sklíčka pod hrdlom krycieho sklíčka Covertile) pre sklíčko, ktoré nebolo automaticky identifikované.

Znova nasuňte podnos na sklíčka a dvakrát kliknite na zodpovedajúcu pozíciu sklíčka (odpočítavanie z hornej pozície zostavy na farbenie sklíčok na obrazovke **System status** (Stav systému)).

5.1.6 Ukazovateľ priebehu cyklu

Ukazovatele priebehu sa nachádzajú pod každým grafickým zobrazením podnosu na sklíčka. Poskytujú rýchlu vizuálnu indikáciu stavu a priebehu cyklu.

- [5.1.6.1 Stav cyklu](#)
- [5.1.6.2 Priebeh cyklu](#)
- [5.1.7.1 Zastavenie cyklu](#)
- [5.1.8.1 Nastavenie času odloženého štartu](#)

5.1.6.1 Stav cyklu

Aktuálne číslo a stav cyklu sa zobrazujú v dolnej časti každého indikátora priebehu. Možné prevádzkové stavy sú:

Stav cyklu	Opis
Unlocked (Odomknuté)	Podnos na sklíčka je odomknutý.
Locked (Uzamknuté)	Podnos na sklíčka je uzamknutý, ale nie je ešte možné začať. Tento stav sa zvyčajne vyskytuje pred dokončením snímania sklíčok.
Slides ready (Sklíčka pripravené)	Všetky sklíčka v zostave na farbenie sklíčok boli nasnímané.
Starting (Spúšťanie)	Bolo stlačené tlačidlo spustenia a systém vykonáva kontroly a plánovanie pred spustením.
Rejected/Slides ready (Odmietnuté/sklíčka pripravené)	Systém BOND sa pokúsil spustiť cyklus, ale nebol úspešný. Najpravdepodobnejšou príčinou odmietnutia sú chýbajúce reagencie, nízka hladina reagencie alebo plná nádoba na odpad. Vytvorte správu o udalostiach cyklu, odstráňte všetky problémy, ktoré boli označené, a potom reštartujte cyklus.
Naplánované	Cyklus je naplánovaný, ale nezačalo sa s jeho spracovaním. Ukazovateľ priebehu cyklu označuje plánovaný čas spustenia.
Proc (OK) (Spracovanie (v poriadku))	Cyklus sa spracováva, nenastali žiadne neočakávané udalosti.
Proc (notification) (Spracovanie (oznámenie))	Cyklus sa spracováva, vyskytli sa neočakávané udalosti. Podrobnosti nájdete v správe o udalostiach cyklu.
Abandoning (Prerušené)	Cyklus bol prerušený. K tomu dôjde, keď obsluha stlačí tlačidlo stop.
Done (OK) (Hotovo (v poriadku))	Spracovanie je dokončené, nenastali žiadne neočakávané udalosti.
Done (notification) (Hotovo (oznámenie))	Spracovanie je dokončené, vyskytli sa neočakávané udalosti. Podrobnosti nájdete v správe o udalostiach cyklu.


5.1.6.2 Priebeh cyklu

Lišta priebehu pod každým obrázkom podnosu na sklíčka poskytuje vizuálne zobrazenie priebehu cyklu. Lišta priebehu zobrazuje kritické časy, ukazuje aktuálny priebeh vzhľadom na kritické časy a používa nasledujúce farby na znázornenie štyroch fáz priebehu cyklu:

- Modrá – podnos na sklíčka je uzamknutý, spracovanie sa nezačalo.
- Červená – spracovanie sa nezačalo a časový limit spustenia bol prekročený.
- Zelená – spracováva sa.
- Fialová – cyklus bol dokončený a teraz sa hydratuje.

Kurzor myši môžete v sekcii priebehu cyklu pozastaviť, aby ste zobrazili stav cyklu, napríklad „Time since locked“ (Čas od uzamknutia), „Time to completion“ (Čas do ukončenia) a „Time since completion“ (Čas od ukončenia), ako je uvedené na [Obrázok 5-21](#).


Obrázok 5-21: Zobrazenie stavu cyklu

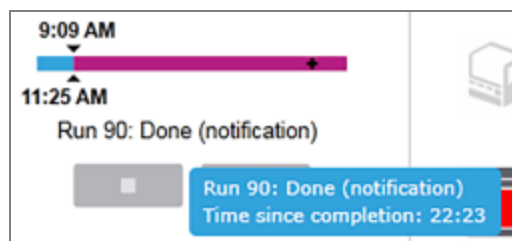

Sklíčka pripravené – začínajú

Po nasnímaní sklíčok a príprave cyklu na spustenie a na krátku dobu po stlačení tlačidla spustenia alebo po spustení odloženého štartu sa na lište zobrazia nasledujúce položky (pozrite si [Obrázok 5-22](#), kde sú uvedené čísla položiek).

Obrázok 5-22: Priebeh cyklu (začiatok)

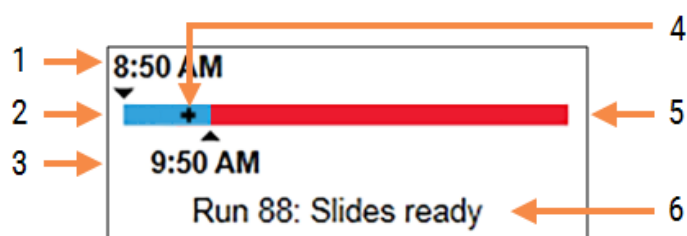

Legenda

- | | |
|---|--|
| 1 Čas uzamknutia podnosu | 4 Aktuálny priebeh |
| 2 Prijateľné začiatkové obdobie (modrý pruh) (pozrite si časť Prijateľné začiatkové obdobie a alarm (Sekcia na strane 128)). | 5 Čas začiatku bol prekročený (červený pruh) |
| 3 Prijateľný časový limit začiatku | 6 Stav cyklu (pozrite si časť 5.1.6.1 Stav cyklu) |

Prijateľné začiatkové obdobie a alarm

Spracovanie vždy začnite čo najskôr po uzamknutí podnosov na sklíčka. Sklíčka nie sú hydratované počas „začiatkového obdobia“ (medzi uzamknutím podnosu a začiatkom spracovania), ak je teda toto obdobie príliš dlhé, v prípade odvoskovaných sklíčok môže dôjsť k poškodeniu tkaniva. Softvér BOND vám pomôže monitorovať tento stav vďaka sledovaniu časov od uzamknutia podnosov a zobrazeniu prijateľnej maximálnej začiatkového obdobia pre vložený typ sklíčka (voskovaný alebo odvoskovaný). Prijateľné začiatkové obdobia sa vizuálne zobrazia ako modrý pruh v lište priebehu „Slides ready“ (Sklíčka pripravené) (pozrite vyššie). Pokiaľ ide o odvoskované sklíčka, ak spracovanie nezačalo nejaký čas po prijateľnom začiatkovom období, zobrazí sa alarm.

Nižšie sú uvedené začiatkové obdobia a doba alarmu pre odvoskované sklíčko. Všetky časy sú od uzamknutia podnosov:

Prijateľné začiatkové obdobie alebo alarm	Čas (min.) od uzamknutia podnosov
Prijateľné začiatkové obdobie pre odvoskované sklíčka	15
Čas pre odvoskované sklíčko do spustenia alarmu	25
Prijateľné začiatkové obdobie pre voskované sklíčka	60


Ak sa spracovanie nezačalo v začiatkovom období, môžete vybrať podnosy a manuálne hydratovať sklíčka. Pri opätovnom vložení podnosu spustí softvér BOND nový cyklus, prideli nové číslo identifikátora cyklu a znova spustí odpočítavanie obdobia.

Prijateľné časové začiatkové limity sa vzťahujú iba na cykly s okamžitým štartom, nevzťahujú sa na cykly s odloženým štartom.

Naplánované

Po spustení cyklu pomocou tlačidla spustenia alebo odloženého štartu je cyklus v systéme naplánovaný. V období medzi plánovaním a začiatkom spracovania, ktoré môže byť dlhšie v prípade odloženého štartu, zobrazuje lišta priebehu tieto položky (pozrite si [Obrázok 5-23](#), na ktorom sú uvedené čísla položiek).

Obrázok 5-23: Priebeh cyklu (štart, s odloženým štartom)

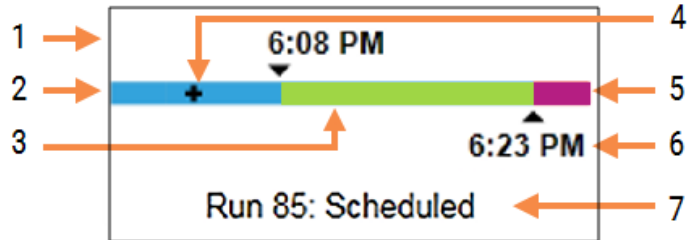


Legenda

- | | |
|--|--|
| 1 Čas, kedy je naplánovaný začiatok cyklu. | 5 Doba hydratácie po spracovaní (fialový pruh). |
| 2 Odloženie pred začiatkom (modrý pruh). | 6 Približný čas ukončenia cyklu. |
| 3 Doba spracovania (zelený pruh). | 7 Stav cyklu (pozrite si časť 5.1.6.1 Stav cyklu) |
| 4 Aktuálny priebeh | |

Počas spracovania

Počas fázy spracovania sa na lište zobrazujú nasledujúce položky (pozrite si [Obrázok 5-24](#), kde sú uvedené čísla položiek).

Obrázok 5-24: Priebeh cyklu (spracovanie)

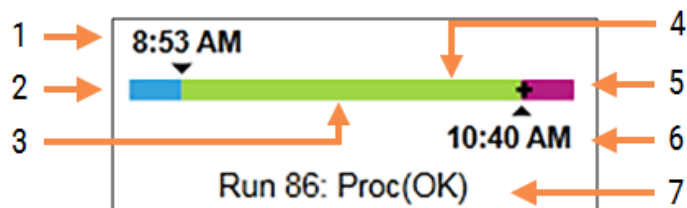

Legenda


- | | |
|--|--|
| 1 Plánovaný čas začiatku | 5 Doba hydratácie po spracovaní (fialový pruh). |
| 2 Začiatkové obdobie – modrá: začiatok v poriadku, červená: prekročený limit začiatku. | 6 Približný čas ukončenia cyklu. |
| 3 Doba spracovania (zelený pruh). | 7 Stav cyklu (pozrite si časť 5.1.6.1 Stav cyklu) |
| 4 Aktuálny priebeh | |

5.1.7 Spustenie alebo zastavenie cyklu

Cyklus spustíte vložení a uzamknutím podnosu na sklíčka. Podnos je nasnímaný a systém skontroluje nasledujúce, aby zistil, či môže byť spracovaný:

- všetky sklíčka sú kompatibilné,
- k dispozícii sú všetky reagenty.

Po nasnímaní sklíčok je stav cyklu nastavený na **Slides ready** (Sklíčka pripravené) (pozrite si časť [5.1.6.1 Stav cyklu](#)) a indikátor priebehu bude zobrazovať počiatočnú fázu (pozrite si časť [5.1.6.2 Priebeh cyklu](#)). Po vyriešení nekompatibility sklíčok sa všetky sklíčka identifikujú a budú vykonané kontroly, aby sa zabezpečilo, že sú prítomné všetky požadované reagenty.


- Ak chcete spustiť cyklus čo najskôr, kliknite na položku . Ak chcete spustiť odložený štart, kliknite pravým tlačidlom myši na podnos a z kontextovej ponuky vyberte položku **Delayed start** (Odložený štart). Ďalšie pokyny nájdete v časti [5.1.8 Odložený štart](#).
 - Stav cyklus je nastavený na **Starting** (Spustenie) po dokončení kontroly a plánovania pred spustením. Indikátor priebehu zostáva v počiatočnej fáze.
 - Po dokončení plánovania sa stav zmení na **Scheduled** (Naplánované). Indikátor priebehu teraz zobrazuje fázu spracovania. Zobrazí sa plánovaný čas spustenia a na ľavom konci indikátoru sa zobrazí začiatkový stav (OK alebo prekročený časový limit).
 - Keď sa spracovanie začne v naplánovanom čase, stav sa zmení na **Proc (OK)** (Spracovanie (v poriadku)). Ak bol prekročený časový limit spustenia, výstraha alebo alarm sa vymaže, keď sa spracovávanie skutočne spustí. Počiatočná sekcia ukazovateľa priebehu však zostáva červená.
 - Upozorňujeme, že stavy **Starting** (Spustenie) a **Scheduled** (Naplánované) môžu nejaký čas trvať a je možné, že bude prekročený časový limit spustenia. Ak k tomu dôjde, môžete pred reštartovaním odomknúť podnos na sklíčka a sklíčka manuálne hydratovať. Ak odomknete podnos pred spustením spracovania, cyklus sa nepovažuje za prerušený a môže sa znova spustiť.



Mali by ste spustiť iba jeden cyklus naraz počkať, kým sa tento cyklus spustí/naplánuje, a až potom spustiť ďalší cyklus. Po každom spustení počkajte chvíľu, aby ste sa uistili, že bol úspešne spustený. Ak nie, stav cyklu sa nastaví na možnosť **Rejected/Slides ready**. (Odmietnuté/sklíčka pripravené). Pozrite si časť [5.1.6.1 Stav cyklu](#). Následne by ste mali vygenerovať správu o udalostiach cyklu, aby ste zistili, prečo sa cyklus nespustil (pozrite si časť [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)).

5.1.7.1 Zastavenie cyklu

Po stlačení tlačidla spustenia (alebo aktivácii odloženého štartu), až kým sa skutočne nezačne spracovanie, pokým je cyklus v stave **Starting** (Spustenie) alebo **Scheduled** (Naplánované), sa spracovanie môže na jeden cyklus zastaviť bez toho, aby bol cyklus prerušený. Ak chcete zrušiť požiadavku na spracovanie v tomto okamihu, odomknite podnos na sklíčka na module spracovania (počas tejto doby sú tlačidlá spustenia a prerušenia vypnuté). Informácie o sklíčkach zostávajú v systéme a cyklus sa môže podľa potreby znova spustiť neskôr. Do zoznamu **Slide history** (História sklíčok) sa zapíše jeden riadok o odmietnutom cykle.

Ak chcete cyklus prerušiť po spustení spracovania, kliknite na položku . Modul spracovania preruší operáciu cyklu po dokončení aktuálneho kroku. Stav sklíčok v okne **Slide history** (História sklíčok) sa zmení na **Done (notification)** (Hotovo (oznámenie)).



Prerušenie cyklu dôkladne zvážte, pretože prerušené cykly nie je možné reštartovať a akékoľvek sklíčka, pre ktoré nebolo spracovanie dokončené, môžu byť kompromitované.

5.1.8 Odložený štart

Cykly s voskovanými sklíčkami sa môžu napláňovať tak, aby sa začalo v určenom čase v budúcnosti (do jedného týždňa od aktuálneho času) v systéme BOND-III a BOND-MAX. Napríklad cykly, ktoré sa začali cez noc, je možné načasovať tak, aby skončili krátko pred začiatkom práce nasledujúci deň. Sklíčka sú uložené bezpečne, stále voskované, až kým sa nezačne spracovanie a doba hydratácie, ktorá nasleduje po spracovaní, sa minimalizuje.



Niektoré reagenty, ktoré nie sú od spoločnosti Leica Biosystems, by mohli mať zhoršenú kvalitu, ak by sa v moduloch spracovania ponechali po dlhú dobu v odloženom štarte. Prečítajte si informácie o použití a skladovaní reagentov v ich kartách údajov. Ako vždy, spoločnosť Leica Biosystems odporúča umiestniť kontrolnú vzorku tkaniva na podložné sklíčka s testovacím tkanivom.



Ak plánovaný čas ukončenia nie je vhodný, pomocou tlačidla **Load / Unload** (Vložiť/vyložiť) zdvihnite a znova spustíte zostavu na farbenie sklíčok. Po opätovnom naskenovaní sklíčok je teraz možné upraviť čas odloženého štartu tak, aby odrážal požadovaný čas ukončenia.

5.1.8.1 Nastavenie času odloženého štartu

Ak chcete spustiť cyklus s odloženým štartom, pripravte sklíčka ako obvykle a uzamknite podnos na sklíčka. Keď je stav cyklu **Slides ready** (Sklíčka pripravené) vyberte **Delayed start** (Odložený štart) kliknutím pravým tlačidlom z kontextovej ponuky podnosu na obrazovke **System status** (Stav systému).

Nastavte dátum a čas, kedy sa má podnos spustiť v dialógovom okne **Delayed start** (Odložený štart) a kliknite na tlačidlo **OK** (pozrite si časť **Použitie výberov dátumu a času** (Sekcia na strane 225)). Systém prejde do stavu **Starting** (Spustené) ako obvykle a naplánuje cyklus v koordinácii s inými operáciami. Podnos potom čaká v stave **Scheduled** (Naplánované) do stanoveného času začiatku, keď sa začne normálne spracovanie.

5.2 Obrazovka stavu protokolu




Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Na tejto obrazovke sa zobrazujú podrobné informácie o stave jednotlivých sklíčok.

Ak chcete zobraziť obrazovku **Protocol status** (Stav protokolu), prejdite na obrazovku **System status** (Stav systému) a kliknite na kartu **Protocol status** (Stav protokolu).

Obrázok 5-25: Obrazovka **Protocol status** (Stavu protokolu)

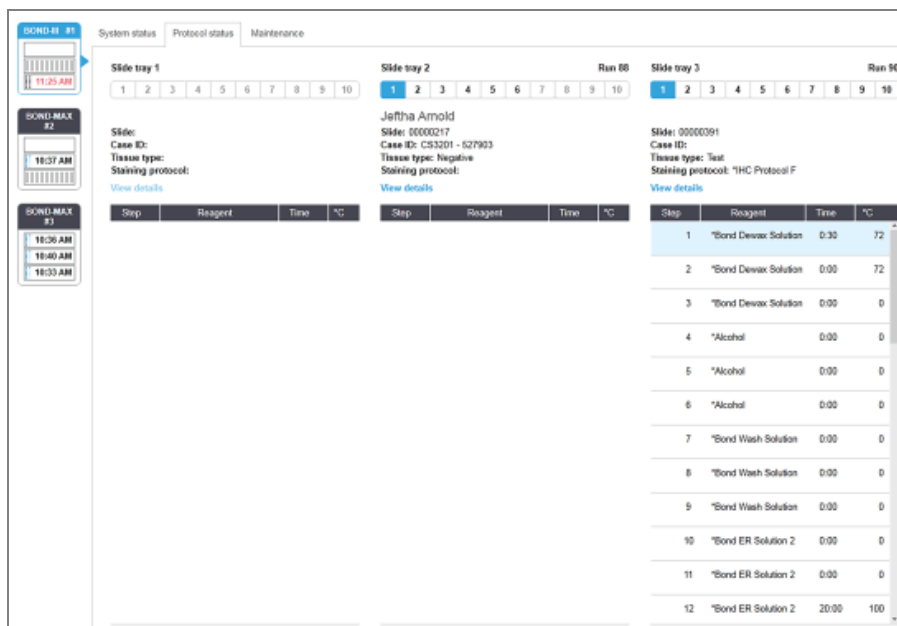


Ak chcete zistiť, ako cyklus spracováva sklíčko, kliknite na príslušné tlačidlo umiestnenia sklíčka v hornej časti obrazovky. Tlačidlá možností zodpovedajúce pozíciám bez sklíčka sú stlmené a nemôžete ich vybrať.




Ak je meno pacienta príliš dlhé na to, aby sa zmestilo na dostupné miesto (podnos na sklíčka 1, 2 a 3), jeho meno bude skrátene s použitím „...“ na konci. Ak chcete vidieť celé meno pacienta v rozbaľovačom poli, prejdite kurzorom myši na skrátene meno.

Keď vyberiete pozíciu sklíčka, softvér zobrazí niektoré údaje o sklíčku a postup protokolu. Ak chcete zobraziť ďalšie údaje o sklíčku, kliknite na položku **View details** (Zobraziť detaily), aby sa otvorilo dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčok).

Kroky protokolu pre vybrané sklíčko sa zobrazia pod údajmi o sklíčku. Aktuálny krok je zvýraznený modrou farbou.

Dokončené kroky ukazujú začiarnutie v zelenom kruhu alebo ikonu , ak sa vyskytli neočakávané udalosti.

Ak sa vykonali všetky požadované akcie pre aktuálny krok, ale pred začiatkom nasledujúceho kroku existuje čakacia doba, značka začiatku alebo  je sivá. Zostane sivá až do začatia nasledujúceho kroku, keď sa zmení na normálnu farbu.

Kliknutím na zoznam krokov a výberom položky **Run events** (Udalosti cyklu) v rozbaľovacej ponuke môžete zobrazit udalosti cyklu. Z rozbaľovacej ponuky môžete tiež otvoriť dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčok).


5.3 Obrazovka údržby



Informácie o údržbe modulu spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME. Nižšie uvedené informácie sa nevzťahujú na modul spracovania BOND-PRIME.

Ak chcete zobrazit obrazovku **Maintenance** (Údržba), prejdite na obrazovku **System status** (Stav systému) a kliknite na záložku **Maintenance** (Údržba).

Obrázok 5-26: Na obrazovke **Maintenance** (Údržba)

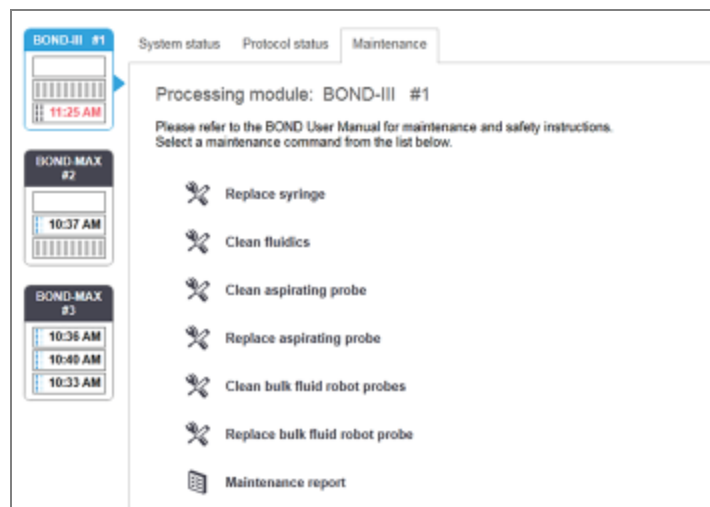

Na obrazovke **Maintenance** (Údržba) sa nachádzajú príkazové tlačidlá pre celý rad úloh údržby uvedených nižšie:

Príkaz	Opis
Replace syringe (Vymeňte injekčnú striekačku)	Pri výmene injekčnej striekačky alebo injekčných striekačiek kontrolujte modul spracovania. Pozrite si časť 12.13 Injekčné striekačky .
Clean fluidics (Vyčistite fluidiku)	Prepláchnite fluidický systém. Pozrite si časť Čistenie fluidiky (Sekcia na strane 308) .

Príkaz	Opis
Vyčistite nasávaciu sondu	Vyčistite nasávaciu sondu pomocou systému na čistenie nasávacej sondy BOND. Pozrite si časť 12.6.1 Čistenie nasávacej sondy .
Vymeňte nasávaciu sondu	Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.
Clean bulk fluid robot probes (Vyčistite sondy s robotmi na nebalenú tekutinu)	Posunie roboty na nebalenú tekutinu (iba BOND-III) do polohy, aby sondy mohli byť utreté dočista. Pozrite si časť 12.12.1 Čistenie sond robota na nebalenú tekutinu .
Replace bulk fluid robot probes (Vymeňte sondy s robotom na nebalenú tekutinu)	Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.
Maintenance report (Správa o údržbe)	Vygenerujte správu o údržbe pre vybraný modul spracovania. Tento príkaz je vždy k dispozícii. Pozrite si časť 5.3.1 Správa o údržbe .

Na obrazovke **Maintenance** (Údržba) sa zobrazuje názov aktuálne vybraného modulu spracovania a priradené tlačidlá príkazov údržby. Pri vykonávaní úlohy údržby, ktorú vyberiete, vás bude sprevádzať niekoľko dialógových okien.

Vždy, keď nie je k dispozícii úloha údržby, napríklad keď už prebieha údržba, jej príkazové tlačidlo je deaktivované. Všetky príkazové tlačidlá (okrem **Maintenance report** (Správa o údržbe)) sú deaktivované, keď je modul spracovania odpojený.

5.3.1 Správa o údržbe



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

V správe o údržbe sa uvádzajú informácie o konkrétnom module spracovania na vybraný časový rámec.

- 1 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).
- 2 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Maintenance report** (Správa o údržbe).

Obrázok 5-27: Dialógové okno správy o údržbe

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte modul spracovania a potom pomocou tlačidiel **From** (Od) a **To** (Do) vyberte požadovaný časový rámec. Prípadne môžete kliknúť na položku **Last twelve months** (Posledných dvanásť mesiacov) a nastaviť časový rámec na toto obdobie.

Kliknutím na možnosť **Generate** (Generovať) vygenerujete správu o údržbe.

Správa sa zobrazí v novom okne. V pravom hornom rohu správy sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
Facility (Zariadenie)	Názov prevádzky, ako je uvedený v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta správy Laboratory settings (Laboratórne nastavenia), pozrite si časť 10.5.1 Laboratórne nastavenia
Časový úsek	Dátumy „od“ a „do“ za obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje
Modul spracovania	Jedinečný názov modulu spracovania, ako je uvedený v poli Name (Názov) na obrazovke klienta správy Hardware configuration (Hardvérová konfigurácia); pozrite si časť 10.6.1 Moduly spracovania .
Sériové číslo	Jedinečné sériové číslo modulu spracovania

Tu uvádzame dôležité body týkajúce sa správy:

- Ikona upozornenia sa zobrazí nad ikonou modulu spracovania na obrazovke System status (Stav systému) (ako v časti 5.1.2 Stav hardvéru) s oznámením, ktoré po kliknutí pravým tlačidlom myši pripomenie, dokedy je tieto úlohy údržby potrebné vykonať (v tom čase sa odhadovaný dátum zobrazí spolu s textom „Due now“ (Termín teraz).
- Odhadované dátumy ďalších úkonov údržby sú založené na počte spracovaných sklíčok a/alebo odporúčanom časovom období medzi jednotlivými úkonmi.
- Ak pre časové obdobie správy neexistuje história udalostí, namiesto tabuľky histórie sa zobrazí vyhlásenie v tomto zmysle.
- Prvým dátumom v tabuľke histórie je buď začiatok obdobia správy alebo dátum uvedenia do prevádzky modulu spracovania, ak k tomu došlo neskôr. Položky v priradených stĺpcoch „Slides since last maintenance/replacement“ (Sklíčka od poslednej údržby/výmeny) vždy zobrazujú 0 sklíčok.
- Posledným dátumom v tabuľke histórie je koniec vykazovaného obdobia.
- Pre každú zostavu na farbenie sklíčok sú počty sklíčok a tiež súhrnný celkový počet sklíčok pre všetky 3 zostavy. Po každej úspešnej údržbe sa počet sklíčok vynuluje.
- Pre každú sondu s robotom na nebalenú tekutinu v zostave na farbenie sklíčok sú individuálne počty sklíčok (iba BOND-III).
- Pre injekčnú striekačku každej zostavy na farbenie sklíčok sú individuálne počty sklíčok (iba BOND-III).
- Pre hlavnú injekčnú striekačku je samostatný počet sklíčok.

6

Nastavenie sklíčka (na riadiacom zariadení BOND)

Štandardný pracovný postup na vytvorenie sklíčok určených na spracovanie pomocou systému BOND zahŕňa nasledujúce hlavné kroky:

- 1 Príprava sekcií na sklíčkach.
- 2 Vytvorenie prípadu pre sklíčka v softvéri BOND (alebo prípad možno importovať zo systému LIS).
- 3 V prípade potreby pridajte alebo upravte údaje lekára.
- 4 Zadanie údajov sklíčok (alebo ich možno importovať zo systému LIS).
- 5 Vytvorenie kontrolných sklíčok podľa štandardných postupov laboratória.
- 6 Označenie sklíčok (pokiaľ už nie sú označené štítkami LIS).
- 7 Vloženie sklíčok na podnos na sklíčka a vloženie podnosov na sklíčka do modulu spracovania.

Keď sa vaše sklíčka začnú spracovávať, obrazovka **Slide history** (História sklíčok) umožňuje vytvárať rôzne správy o sklíčkach, prípadoch a cykloch. Prečítajte si časť **9 História sklíčok (na riadiacom zariadení BOND)** pre viac informácií.

Ak štandardný pracovný postup nevyhovuje vášmu laboratóriu, existujú alternatívne pracovné postupy.

Táto kapitola má nasledujúce časti:

- [6.1 Obrazovka nastavenia sklíčka](#)
- [6.2 Práca s kontrolnými vzorkami](#)
- [6.3 Práca s prípadmi](#)
- [6.4 Správa lekárov](#)
- [6.5 Práca so sklíčkami](#)
- [6.6 Označovanie sklíčok](#)
- [6.7 Súhrnná správa o nastavení sklíčok](#)
- [6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu](#)
- [6.9 Kompatibilita sklíčok](#)

6.1 Obrazovka nastavenia sklíčka

Obrazovka **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) zobrazuje prípady a sklíčka zadané do systému BOND, ale ešte nespracované. V prípade systémov integrovaných do systému LIS zobrazuje prípady a sklíčka importované zo systému LIS. Pre systémy, ktoré nie sú LIS, na tejto obrazovke vytvárate a podľa potreby upravujete prípady a sklíčka. Sklíčka musia patriť do prípadu, takže pred vytvorením sklíčok musíte vytvoriť prípad.

Obrazovku **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) zobrazíte kliknutím kliknite na ikonu **Slide setup** (Nastavenie sklíčka)



na paneli funkcií.

Obrázok 6-1: Obrazovka **Slide setup** (Nastavenie sklíčka)

Case ID	Patient name	Doctor name	Slides
LS0012 - 45216	Shady, Albert	Joseph	1
20130416-ISHRefine	Benjamin Hightower	Kevin Pannell	10
20130416-IHC	Fannie Hurley	Arthur Josey	10
20130402-IHC5	Adam Smith	Kevin Pannell	10
CS104 - 254862	Ann Chovey	Cecilia Hoy	12
CS145 - 254789 1A	Olive Yew	Kevin Pannell	5
CS160 - 254719	Liz Erd	Thomas Matthews	1
CS164 - 255789	Ray O'Sun	Debbie Hanrahan	3
CS204 - 255789 4B	Clark Kent	Suzanne Rhinehart	3
CS205 - 255790	Chris P. Bacon	Arthur Josey	1
CS205 - 255791	Marsha Mellow	Nicholas Monahan	10
CS205 - 255792	Suzzan Max	Nicholas Monahan	10
CS211 - 256001	Zaone Marshall	Deanna Hayman	7
CS101 - 252401	Sally Faulkner	Jacob Glaser	3
CS102 - 252413	James Donovan	Jacob Glaser	1
LS0012 - 45214	Barb, Akew	Jenny	1
CS3201 - 527890	Reeve Ewer	Jack Browne	11
CS3201 - 527891	Theresa Brown	Jack Browne	14
CS3201 - 527892	Tex Rytz	Arthur Josey	11

Positive tissue controls: 21
Negative tissue controls: 25

Total cases: 28
Total slides: 143

Obrázok 6-1 zobrazuje obrazovku **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Pravá horná časť obrazovky obsahuje funkcie na prácu s prípadmi, pravá časť obrazovky obsahuje funkcie na prácu so sklíčkami.

6.2 Práca s kontrolnými vzorkami

Spoločnosť Leica Biosystems odporúča rutinné používanie kontrol v systéme BOND. Niektoré testovacie produkty obsahujú svoje vlastné kontrolné sklíčka, ale v návode k produktu sa môžu odporúčať ďalšie interné kontroly. Ďalšie podrobnosti o odporúčaní kontroly kvality nájdete v špecifických návodoch na použitie (IFU) pre testovacie produkty. Majte na pamäti, že kontroly by mali byť skúškou celého procesu. Pozrite si časť **14.3 Kontrola kvality**, kde nájdete ďalšie informácie.



Pre najprimeranejšie testovanie výkonnosti systému BOND spoločnosť Leica Biosystems dôrazne odporúča umiestniť vhodnú kontrolnú vzorku tkaniva na rovnaké podložné sklíčko ako tkanivo pacienta.

Zatiaľ čo umiestnenie kontrolnej vzorky tkaniva s testovacím tkanivom sa dôrazne odporúča, softvér BOND tiež umožňuje snímanie sklíčok iba s kontrolnými vzorkami tkanivami a kontroly reagencie. Dbajte na to, aby sklíčka s iba kontrolnou vzorkou tkaniva boli dobre označené, aby nedošlo k zámene s testovanými vzorkami pacienta.

6.2.1 Kontrolná vzorka tkaniva

Každé sklíčko musí byť zadané do softvéru BOND ako sklíčko s jedným z nasledujúcich typov tkanív:

- testovacie tkanivo,
- negatívne tkanivo,
- pozitívne tkanivo.

Toto sa nastaví v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) (pozrite si časť **6.5.2 Vytvorenie sklíčka**). Akékoľvek sklíčko s testovacím tkanivom pacienta by sa malo nastaviť ako Test tissue (Testovacie tkanivo). Nastavenia kontroly Positive tissue (Pozitívne tkanivo) a Negative tissue (Negatívne tkanivo) používajte výhradne pre sklíčka len s kontrolným tkanivom.

Kedykoľvek sa zmení typ tkaniva pre nové sklíčko v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko), pole **Marker** (značkovač) sa automaticky vymaže, aby bolo zaistené, že pre tkanivo vyberiete správny značkovač.

Sklíčka s negatívnym alebo pozitívnym tkanivom sú označené symbolom - alebo + na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Na obrazovke **Slide history** (História sklíčka) sa pre každé sklíčko zobrazí Test (Testovacie), Negative (Negatívne) alebo Positive (Pozitívne) v stĺpci **Type** (Typ).

Na to, aby boli samotné sklíčka jasne zvýraznené ako kontroly, zahrňujeme položku Tissue type (Typ tkaniva) ako jedno z informačných polí do predvolených šablón štítkov sklíčok. To vytlačí veľké (+) na štítky s pozitívnou kontrolnou vzorkou tkaniva a (-) na štítky s negatívnou kontrolnou vzorkou tkaniva. Pri testovacom tkanive sa v poli nevytlačí nič. Odporúčame zahrnúť toto pole do všetkých ostatných štítkov sklíčok, ktoré nakonfigurujete (pozrite si časť **10.3 Labels (Štítky)**).

6.2.2 Kontrolná reagencia

Sklíčka sa nastavujú pomocou kontrolnej reagentie výberom vhodnej reagentie ako značkovača namiesto štandardných protilátok alebo sond počas konfigurácie sklíčka.

Pokiaľ ide o IHC, softvér BOND obsahuje možnosť negatívnej kontrolnej reagentie. S IHC vybraným v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) zvolíte možnosť ***Negative** (Negatívne) z rozbaľovacieho zoznamu **Marker** (Značkovač). Spoločnosť BOND poskytuje roztok BOND Wash Solution pre tieto kroky.

Pokiaľ ide o ISH, softvér BOND obsahuje negatívne a pozitívne kontrolné reagentie pre RNA a DNA. Tieto reagentie je potrebné zakúpiť, zaregistrovať a vložiť do systému BOND. Vyberte príslušnú kontrolnú sondu z rozbaľovacieho zoznamu **Marker** (Značkovač).

Sklíčka s kontrolnými reagentiami nie sú osobitne označené inak ako názvom značkovača zobrazeným na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) a na štítku sklíčka, ak je pole značkovača zahrnuté v príslušnej šablóne štítka sklíčka.

6.3 Práca s prípadmi

Táto časť opisuje funkcie v ľavej časti obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčok), ktoré vám umožnia pracovať s prípadmi. Podsekcie nasledujúce po popisnej časti poskytujú postupy na pridávanie, úpravu a odstraňovanie údajov o prípade.

Nižšie uvedené časti:

- [6.3.1 Kontroly prípadov a informácie o aktívnych prípadoch](#)
- [6.3.2 Identifikácia prípadu](#)
- [6.3.3 Pridanie prípadu](#)
- [6.3.4 Duplikácia, obnovenie a expirácia prípadu](#)
- [6.3.5 Úpravy prípadu](#)
- [6.3.6 Kopírovanie prípadu](#)
- [6.3.7 Možnosť celodenného prípadu](#)
- [6.3.8 Správa o prípade](#)

6.3.1 Kontroly prípadov a informácie o aktívnych prípadoch

Kliknutím na položku **Add case** (Pridať prípad) pridáte podrobnosti o novom prípade (pozrite si časť [6.3.3 Pridanie prípadu](#)).

Kliknutím na položku **Edit case** (Upraviť prípad) upravíte detaily existujúceho prípadu (pozrite si časť [6.3.5 Úpravy prípadu](#)).

Kliknutím na položku **Delete case** (Odstrániť prípad) odstránite existujúci prípad (pozrite si časť [6.3.5.1 Odstránenie prípadu](#)).

Kliknutím na položku **Copy case** (Kopírovať prípad) pridáte kópiu prípadu a sklíčka pre daný prípad (pozrite si časť [6.3.6 Kopírovanie prípadu](#)).

Príkazy **Edit** (Upraviť), **Delete** (Odstrániť) a **Copy** (Kopírovať) sú prístupné aj v kontextovom okne po kliknutí pravým tlačidlom myši na prípad.

Kliknutím na položku **Case report** (Správa o prípade) (pod zoznamom prípadov) zobrazíte správu pre vybraný prípad (pozrite si časť [6.3.8 Správa o prípade](#)).

Tabuľka pod tlačidlami zobrazuje informácie o aktívnych prípadoch takto:

Case ID (Identifikátor prípadu)	Identifikácia prípadu. Môže to byť akýkoľvek alfanumerický znak. Keďže toto pole môže obsahovať písmená aj čísla, kliknutím na záhlavie stĺpca Case ID (Identifikátor prípadu) v tabuľke sa toto pole zoradí ako text – identifikátor začínajúci 10 bude zoradený pred identifikátor začínajúci 2.
Meno pacienta	Identifikácia pacienta.
Meno lekára	Meno lekára alebo odporúčajúceho patológa zodpovedného za pacienta.
Sklíčka	Počet nespracovaných sklíčok nakonfigurovaných pre zvolený prípad. Keď sa spracovanie začne na sklíčkach, sú presunuté z obrazovky Slide setup (Nastavenie sklíčok) do obrazovky Slide history (História sklíčok) a počet bude aktualizovaný.

Prípad s červeným pruhom na ľavej strane znamená, že má jeden alebo viac prioritných sklíčok LIS (pozrite si časť [11.2.5 Prioritné sklíčka](#)).

Pod zoznamom aktívnych prípadov je uvedený súhrn všetkých prípadov a sklíčok takto:

Pozitívne kontrolné vzorky tkaniva	Celkový počet pozitívnych kontrolných vzoriek tkaniva pre všetky aktuálne zadané a nespustené prípady.
Negatívne kontrolné vzorky tkaniva	Celkový počet negatívnych kontrolných vzoriek tkaniva pre všetky aktuálne zadané a nespustené prípady.
Celkový počet prípadov	Celkový počet aktívnych prípadov.
Celkový počet sklíčok	Celkový počet sklíčok pre všetky aktuálne zadané a nespustené prípady.

6.3.2 Identifikácia prípadu

Systém BOND používa dva primárne identifikátory prípadu: identifikátor prípadu a číslo prípadu (**Case ID** a **Case No.** v uvedenom poradí v softvéri).

- **Case ID** (Identifikátor prípadu): identifikátor prípadu zadaný používateľom pomocou schémy identifikácie laboratória. Pre prípady vytvorené v systéme BOND sa identifikátor prípadu zadáva v dialógovom okne **Add case** (Pridať prípad) pri vytváraní prípadov. V prípade systémov LIS-ip sa identifikátor prípadu prijíma zo systému LIS (kde sa môže nazývať „číslo záznamu“ alebo inak).
- **Case No.:** (Prípad č.:) jedinečné identifikačné číslo, ktoré systém BOND automaticky priradí každému prípadu v systéme (vytvorené v systéme BOND aj prijaté zo systému LIS). Číslo prípadu sa zobrazuje v dialógovom okne **Case properties** (Vlastnosti prípadu).

Vo verziách BOND pred sa nevyžadovalo, aby identifikátory prípadov boli jedinečné, takže bolo možné mať dva alebo viac prípadov s rovnakým identifikátorom. Prípady by však pravdepodobne mali odlišné mená pacientov a určite by mali rôzne čísla prípadov. Vo verziách BOND 4.1 a neskôr všetky nové prípady musia byť jedinečné.

Prípady sa tiež často identifikujú podľa mena pacienta, mená pacientov však nie sú povinné a nemusia byť jedinečné.

6.3.3 Pridanie prípadu

Ak chcete pridať prípad, začnite na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) a vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) kliknite na položku **Add case** (Pridať prípad) a zobrazí sa dialógové okno **Add case** (Pridať prípad) (pozrite si časť **Obrázok 6-2**).

Obrázok 6-2: Dialógové okno **Add case** (Pridať prípad)

- Podľa potreby zadajte podrobnosti do polí Case ID (Identifikátor prípadu), Patient name (Meno pacienta), Case comments (Komentáre k prípadu) a Doctor (Lekár).



Prípady je možné pridávať aj bez zadania informácií o prípade.

- Ak požadovaný lekár nie je v zozname lekárov, pridajte ho kliknutím na položku **Manage doctors** (Správa lekárov) na otvorenie dialógového okna **Manage doctors** (Správa lekárov) (pozrite si časť [6.4 Správa lekárov](#)).
- Zvoľte dávkovací objem pre sklíčka vytvorené pre tento prípad, ak nie je rovnaký ako už nakonfigurovaný predvolený dávkovací objem.

Upozorňujeme, že pre všetky sklíčka spracované na moduloch spracovania BOND-III a BOND-PRIME vyberte dávkovací objem 150 µl. Okrem toho pre všetky sklíčka ISH vyberte dávkovací objem 150 µl pre všetky typy modulov spracovania.

Informácie o použiteľných oblastiach sklíčok a dávkovacích objemoch nájdete v časti [6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach](#).

- Zvoľte možnosť prípravy v zozname **Preparation protocol** (Prípravný protokol) (pozrite si [Obrázok 6-2](#)), aby sa to stalo predvoleným pre sklíčka vytvorené pre tento prípad.
- Ak chcete dialógové okno opustiť bez zadania údajov do systému, kliknite na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť).
- Ak chcete zadať údaje o prípade, kliknite na tlačidlo **OK**.

Prípad bude pridaný do zoznamu prípadov.



Ak identifikátor prípadu už v systéme existuje, otvorí sa dialógové okno **Case ID duplication** (Duplikácia identifikátorov prípadu) (pozrite si časť [6.3.4 Duplikácia, obnovenie a expirácia prípadu](#)).

6.3.4 Duplikácia, obnovenie a expirácia prípadu

Verzie softvéru pred BOND 4.1 umožňovali, aby niektoré prípady mali rovnaký identifikátor prípadu. Takéto prípady sa vo všeobecnosti dali rozlíšiť podľa mena pacienta a rozlíšenie bolo vždy zaručené číslom prípadu, ktoré je vždy jedinečné. Systém BOND už neumožňuje, aby nové prípady mali rovnaký identifikátor ako existujúce prípady – každému novému prípadu musí byť pridelený jedinečný identifikátor alebo musí byť identifikovaný ako rovnaký prípad už v systéme.

Ak zadáte prípad s identifikátorom prípadu, ktorý sa už v systéme nachádza, zobrazí sa dialógové okno **Case ID duplication** (Duplikácia identifikátoru prípadu), ktoré zobrazuje existujúci prípad s rovnakým identifikátorom. Ak chcete použiť existujúci prípad, vyberte ho a kliknite na položku **Use selected** (Použiť vybrané) (pozrite si tiež časť [Zlúčenie prípadov \(Sekcia 6.3.4.1 na strane 144\)](#)). V opačnom prípade zrušte dialógové okno a zmeňte identifikátor prípadu, aby sa prípad vytvoril ako nový.

Prípady v dialógovom okne **Case ID duplication** (Duplikácia identifikátoru prípadu) mohli byť odstránené, exspirované (prípady, v ktorých boli všetky sklíčka spracované – pozrite nižšie), alebo to môžu byť súčasné prípady, ktoré sú stále uvedené na zozname na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčok). Ak zvolíte prípad, ktorý je exspirovaný, a obnovíte ho do zoznamu prípadov, prípad je označený ako „obnovený“.

Pozrite si časť **Duplicitný identifikátor prípadu (Sekcia na strane 240)**, kde nájdete ďalšie informácie o duplicitných identifikátoroch prípadov pre prípady LIS.

6.3.4.1 Zlúčenie prípadov

Ak upravíte identifikátor prípadu tak, aby sa zhodoval s identifikátorom existujúceho prípadu, a potom kliknete na tlačidlo **Use selected** (Použiť vybrané) v dialógovom okne **Case ID duplication** (Duplikácia identifikátoru prípadu), ktoré sa následne zobrazí, všetky nespracované sklíčka z upraveného prípadu bude presunuté do existujúceho prípadu.



Je možné upraviť iba prípad, ktorý má nespracované sklíčka, preto nie je možné zmeniť prípad, ku ktorému sú priradené spracované sklíčka.

6.3.4.2 Životnosť spracovaného prípadu

Po spustení spracovania posledného sklíčka v prípade bude prípad (podľa predvoleného nastavenia) odstránený z obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) a zobrazí sa na obrazovke **Slide History** (História sklíčok).

Systém BOND môžete nastaviť na uchovávanie prípadov na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) počas nastaveného počtu dní po spracovaní posledných sklíčok v prípadoch. Položku **Processed case lifetime** (Životnosť spracovaného prípadu) nastavíte v klientovi správy na obrazovke **Laboratory** (Laboratórium) (pozrite si časť **10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka**).

Prípady, ktoré exspirovali, sú uložené v systéme, ale nedajú sa zobrazíť. Prípady, ktoré exspirovali, sa dajú obnoviť do zoznamu opätovným pridaním prípadu (jeho obnovou) alebo pridaním sklíčka do prípadu prostredníctvom systému LIS.



Prípady, ktoré neobsahujú žiadne spracované sklíčka, sa z obrazovky nastavenia sklíčka nikdy automaticky neodstránia.

6.3.5 Úpravy prípadu

Ak chcete upraviť podrobnosti o prípade, vyberte ho v zozname a kliknite na položku **Edit case** (Upraviť prípad). Softvér zobrazí dialógové okno **Case properties** (Vlastnosti prípadu). Môžete ho použiť rovnakým spôsobom ako dialógové okno **Add case** (Pridať prípad) popísané vyššie.



Ak upravíte podrobnosti o prípade, pre ktorý boli štítky sklíčok vytlačené, pred spracovaním sklíčka štítkov znova vytlačte (na obrazovke sa objaví správa v tomto zmysle).

6.3.5.1 Odstránenie prípadu

Ak chcete prípad odstrániť, vyberte ho v zozname a kliknite na tlačidlo **Delete case** (Odstrániť prípad).



Keď prípad BOND na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) obsahuje iba nespracované sklíčka, prípad môžete ručne odstrániť, čím ho necháte expirovať. (Všetky prípady LIS expirujú automaticky, keď neobsahujú žiadne nespracované sklíčka.)



Prípad nemôžete manuálne odstrániť, ak obsahuje nejaké spracovávané alebo spracované sklíčka.

Odstránením prípadu sa odstránia aj všetky nespracované sklíčka vytvorené pre tento prípad.

Údaje o odstránených prípadoch môžete obnoviť, ale nie ich sklíčka.

6.3.6 Kopírovanie prípadu

Kopírovanie prípadu poskytuje pohodlný spôsob, ako pre pacienta nastaviť nový prípad. Údaje o prípade môžete v novom prípade zmeniť, ak si to budete želať, alebo ich ponechať nezmenené. Automaticky sa vytvorí nové číslo prípadu a musíte zadať nový identifikátor prípadu.



Prípad nemožno skopírovať, ak obsahuje sklíčko, ktoré odkazuje na odstránený protokol.

Skopírované sklíčka sú pripravené na tlač štítka a spracovanie na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Kliknutím pravým tlačidlom myši na sklíčka a vybratím položky **Delete slide** (Odstrániť sklíčko) odstránite nežiaduce sklíčka.

Ak chcete skopírovať prípad:

- 1 Vyberte prípad, ktorý chcete skopírovať, v zozname prípadov v ľavej časti okna **Slide setup** (Nastavenie sklíčka).
- 2 Kliknite na položku **Copy case** (Kopírovať prípad), softvér zobrazí dialógové okno **Copy case** (Kopírovanie prípadu).
- 3 Zadajte nový identifikátor prípadu a podľa potreby upravte údaje prípadu.
- 4 Podľa potreby zvolte položku **Unprocessed slides** (Nespracované sklíčka) alebo **All slides** (Všetky sklíčka).
 - Nespracované sklíčka – kopírovanie iba nespracovaných sklíčok z pôvodného prípadu.
 - Všetky sklíčka – kopírovanie všetkých sklíčok (nespracovaných, spracovávaných a spracovaných) z pôvodného prípadu. Systém označí všetky sklíčka v novom prípade ako nespracované.

5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Systém vytvorí nový prípad a skopíruje sklíčka vrátane akýchkoľvek komentárov podľa vybranej možnosti. Všetky skopírované sklíčka (vrátane LIS) sa správajú rovnako ako sklíčka vytvorené v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) (pozrite si časť [6.5.1 Opis polí sklíčka a kontrol](#)).

6.3.7 Možnosť celodenného prípadu

Systém BOND môže byť nakonfigurovaný tak, že automaticky vytvorí nový prípad každých 24 hodín, čo umožní vytvorenie všetkých sklíčok pre každý deň v rovnakom, jednom prípade. To môže ušetriť čas pre laboratóriá spracúvajúce malý počet podložných sklíčok, pretože nezadávajú mená pacientov a identifikátory prípadov. Každý denný prípad má tieto vlastnosti:

- identifikátor prípadu je nastavený na dátum nového dňa,
- predvolený dávkovací objem a protokol prípravy sa nastavujú na predvolené hodnoty systému stanovené v klientovi správy, môžu byť upravené.
- Polia **Patient name** (Meno pacienta) a **Doctor** (Lekár) zostávajú prázdne a nedajú sa zmeniť.

Jednotlivé prípady môžete stále vytvárať zvyčajným spôsobom, pričom je zapnutá možnosť celodenných prípadov. Pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#), kde sú pokyny na nastavenie možnosti celodenného prípadu.

6.3.8 Správa o prípade

Môžete vytvárať správy pre jednotlivé prípady. V správach sa uvádzajú základné údaje o prípade a informácie o všetkých sklíčkach v prípadoch, napr. identifikátory sklíčok a v nich použité protokoly a reagenty. Ak je správa určená na tlač, je v nej priestor na písanie poznámok ku každému sklíčku. Pozrite si časť [9.6 Správa o prípade](#), kde je uvedený úplný opis.

Vytváranie správ o prípadoch v oknách **Slide setup** (Nastavenie sklíčok) a **Slide history** (História sklíčok). Vyberte príslušný prípad alebo sklíčko a potom kliknite na tlačidlo **Case report** (Správa o prípade). Správy o prípadoch obsahujú iba údaje o reagentoch pre sklíčka, ktoré boli spracované a odomknuté z modulu spracovania.

6.4 Správa lekárov

Systém BOND ukladá zoznam lekárov, ktorí môžu prípadne pridať podrobnosti o prípade. Vyberte si zo zoznamu preferovaných lekárov v dialógovom okne **Add case** (Pridať prípad) alebo **Case properties** (Vlastnosti prípadu) alebo pridajte a upravujte lekárov v dialógovom okne **Manage doctors** (Správa lekárov), otvorenom z rovnakých dialógových okien s vlastnosťami prípadu.

Pre každého lekára sú zobrazené nasledujúce polia:

- Name (Meno): – meno lekára,
- LIS ID: – jedinečný identifikátor poskytnutý laboratórnym informačným systémom (ak je to použiteľné),
- Pref.: – preferovaný stav lekára (pri vytváraní prípadov sú v rozbaľovacom zozname k dispozícii iba preferovaní lekári). Tento štatút sa nastavuje v dialógovom okne **Edit doctor** (Upraviť lekára).

Tieto hodnoty sú uvedené aj v dialógovom okne **Edit doctor** (Úprava lekára). Okrem toho má dialógové okno **Edit doctor** (Úprava lekára) nasledujúce položky:

- ID: – jedinečný identifikátor automaticky vygenerovaný a pridelený systémom BOND,
- Comments (Komentáre): – upraviteľné pole pre všeobecný komentár alebo ďalšie informácie o názve.

Ak je otvorené dialógové okno **Manage doctors** (Správa lekárov), kliknite na položku **Add** (Pridať) alebo **Edit** (Upraviť) na pridanie nových lekárov alebo upravenie údajov existujúcich lekárov. Úpravy je možné robiť len v poli s komentármi a meniť preferovaný štatút – po vytvorení lekára nemôžete zmeniť jeho meno.

Lekárov môžete odstrániť v dialógovom okne **Manage doctors** (Správa lekárov). Prípady, ktoré už boli vytvorené s odstráneným lekárom, naďalej zobrazujú meno lekára, ale pre nové prípady nie je lekár k dispozícii. Meno odstráneného lekára nemôžete znova použiť pre nového lekára.

6.5 Práca so sklíčkami

Táto časť popisuje vytváranie a správu sklíčok na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Záverečná časť popisuje nastavenie dávkovacieho objemu a spôsob, akým ovplyvňuje umiestnenie tkaniva na sklíčkach.


- [6.5.1 Opis polí sklíčka a kontrol](#)
- [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)
- [6.5.3 Kopírovanie sklíčka](#)
- [6.5.4 Úpravy sklíčka](#)
- [6.5.5 Odstránenie sklíčka](#)
- [6.5.6 Manuálna identifikácia sklíčka](#)
- [6.5.7 Pridanie panela sklíčok](#)
- [6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach](#)

6.5.1 Opis polí sklíčka a kontrol

V hornej časti zoznamu sklíčok sú dve tlačidlá:

- Kliknite na položku **Add slide** (Pridať sklíčko), aby ste pridali sklíčko pre vybraný prípad.
- Kliknite na položku **Add panel** (Pridať panel), aby ste pridali panel pre vybraný prípad.
- Prečítajte si časť [6.5.7 Pridanie panela sklíčok](#) pre viac informácií.


Zoznam sklíčok v pravej časti obrazovky zobrazuje údaje sklíčok pre prípad vybraný v ľavej časti obrazovky. Každé sklíčko zobrazuje identifikátor sklíčka a podrobnosti o protokoloch, ktoré majú byť preň spustené. Oblasti štítkov na pravej strane sklíčok sú farebne označené podľa toho, kde boli vytvorené:

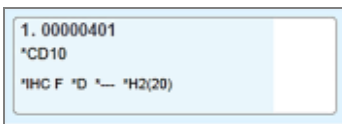

Biela:

Sklíčko vytvorené v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko)


(pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#))

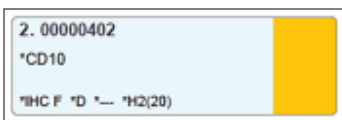

Žltá:

Sklíčko vytvorené v dialógovom okne **Slide identification** (Identifikácia sklíčka)

(pozrite si časť [6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu](#))

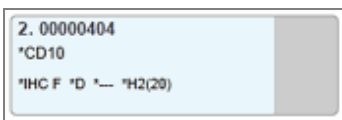


Svetlosivá:

Sklíčko LIS


(pozrite si časť [11 Integrovaný balík LIS \(na BOND riadiacom zariadení\)](#))

Na sklíčkach sú zobrazené aj nasledujúce symboly:




Znamienko mínus:

Sklíčko s negatívnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v časti [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#))

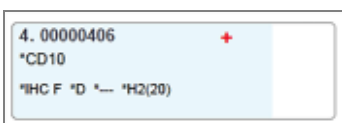


Znamienko plus:

Sklíčko s pozitívnou vzorkou tkaniva (pozrite krok 4 v časti [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#))



Červené P:

Sklíčko s prioritou systému LIS (pozrite si časť [11.2.5 Prioritné sklíčka](#))

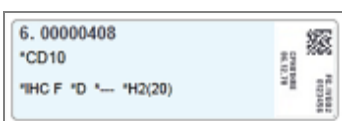

Vzorový štítok:

štítok sklíčka bol vytlačený

Dvojitým kliknutím na sklíčko otvoríte dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka). Kliknutím pravým tlačidlom myši odstránite sklíčko alebo preň vytlačíte štítok.

6.5.2 Vytvorenie sklíčka

Ak chcete vytvoriť sklíčka pre systém HER2 IHC Bond™ Oracle™, pozrite si návod na použitie (IFU), ktorý sa dodáva s produktom.

Vytvorenie nového sklíčka:

- 1 V zozname prípadov kliknite na prípad.
- 2 Kliknutím na položku **Add slide** (Pridať sklíčko) zobrazíte dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka).

Obrázok 6-3: Dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka)

The screenshot shows the 'Add slide' dialog box with the following details:

- Slide comments:** (Empty text field)
- Tissue type:**
 - Test tissue
 - Negative tissue
 - Positive tissue
- Dispense volume:**
 - 100 µL
 - 150 µL
- Staining mode:**
 - Single (dropdown)
 - Routine (dropdown)
- Process:**
 - IHC
 - ISH
- Marker:** *CD5 (4C7) (dropdown)
- Protocols:**
 - Staining: *IHC Protocol F (dropdown)
 - Preparation: *Dewax (dropdown)
 - HIER: *HIER 20 min with ER2 (dropdown)
 - Enzyme: *- - - (dropdown)
- Marker UPI:** Auto (dropdown)
- Detection System UPI:** Auto (dropdown)

Nové sklíčko je automaticky očíslované s jedinečným **iSlide ID** (Identifikátorom sklíčka), to sa však nezobrazí, kým sa sklíčko neuloží po kliknutí na položku **Add slide** (Pridať sklíčko) v dialógovom okne.

- 3 Ak chcete, pridajte komentár ku sklíčku.
- 4 Vyberte typ tkaniva (testovacie tkanivo, negatívne tkanivo, pozitívne tkanivo) kliknutím na jedno z prepínacích tlačidiel v skupine **Tissue type** (Typ tkaniva).

Pozrite si časť [6.2.1 Kontrolná vzorka tkaniva](#) pre všeobecnejšie informácie o kontrolných vzorkách časť [14.3.2 Kontrolné vzorky tkanív](#).

- 5 Ak je to potrebné, zmeňte dávkovací objem pre sklíčko (pozrite si časť [6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach](#)).
- 6 Vyberte režim farbenia.
 - a V poli **Staining mode** (Režim farbenia) vyberte položku **Single** (Jednoduché) (predvolené), ak sa použije jednoduché farbenie, prípadne **Sequential multiplex** (Sekvenčné multiplexové farbenie) alebo **Parallel multiplex** (Paralelné multiplexové farbenie) pre sklíčko s multiplexovým farbením (pozrite si časť [7.1.1 Režimy farbenia](#)).
 - b Vyberte položku **Routine** (Rutinné) (predvolené) v druhom poli (položku **Oracle** vyberte len v prípade, že je to uvedené v pokynoch pre systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC).
 - c Pre sekvenčné multiplexové farbenie vyberte počet farbení z rozbaľovacieho zoznamu **Stains** (Farbenia). Môžete zvoliť maximálne dve farbenia.

Zobrazené karty závisia od zvoleného režimu farbenia:

- Jednoduché – karta **Single** (Jednoduché)
- Paralelné multiplexové – karta **Parallel multiplex** (Paralelné multiplexové farbenie).
- Sekvenčné multiplexové – karta pre každé farbenie (napríklad, karta **First** (Prvé), karta **Final** (Posledné)).

The screenshot shows the 'Add slide' dialog box with the following details:

- Slide comments:** [Text input field]
- Tissue type:**
 - Test tissue
 - Negative tissue
 - Positive tissue
- Dispense volume:**
 - 100 µL
 - 150 µL
- Staining mode:**
 - Sequential multiplex [Dropdown]
 - Routine [Dropdown]
 - First [Button]
 - Final [Button]
- Process:**
 - IHC
 - ISH
- Marker:** [Dropdown]
- Protocols:** [Section header]
- Preparation:** [Dropdown]

At the bottom of the dialog are two buttons: **Add slide** and **Close**.

7 Na každej zobrazenej karte:

- a Vyberte postup farbenia (**IHC** alebo **ISH**).
- b Vyberte primárnu protilátku alebo sondu z rozbaľovacieho zoznamu **Marker** (Značkovač):
- c Ak chcete spustiť negatívnu kontrolnú reagenciu IHC, vyberte buď predvolenú negatívnu reagenciu ***Negative** (Negatívne) alebo negatívnu reagenciu, ktorú ste vytvorili (prečítajte si časť **14.3.3 Negatívna kontrolná reagencia pre IHC**).
- d Ak chcete spustiť negatívnu kontrolnú reagenciu ISH, vyberte ***RNA Negative Control Probe** (RNA negatívna kontrolná sonda) alebo ***DNA Negative Control** (DNA negatívna kontrola).
- e Ak chcete spustiť pozitívnu kontrolnú reagenciu ISH, vyberte ***RNA Positive Control Probe** (RNA pozitívna kontrolná sonda) alebo ***DNA Positive Control Probe** (DNA negatívna kontrolná sonda).



Ak chcete pridať alebo odstrániť položky z rozbaľovacieho zoznamu **Marker** (Značkovač), vyberte alebo zrušte výber poľa **Preferred** (Preferované) pre reagenciu na obrazovke softvéru **Reagent Setup** (Nastavenie reagencie). Pozrite si časť **8.2.1 Pridanie alebo úprava reagencie** pre viac informácií.

- f Vyberte vhodný protokol pre každú fázu spracovania.
 - g Ak vyberiete primárnu protilátku alebo sondu, softvér zadá predvolené protokoly. Skontrolujte, či sú pre každú fázu nastavené správne protokoly a v prípade potreby vyberte nový protokol z príslušného rozbaľovacieho zoznamu. Vyberte ***---**, ak sa v konkrétnej fáze nevyžaduje protokol.
 - h Predvolené protokoly sa nastavujú na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagencie). Pozrite si časť **8.2.1 Pridanie alebo úprava reagencie**.
 - i Ak chcete pridať alebo odstrániť položky z rozbaľovacieho zoznamu **Protocol** (Protokol), vyberte alebo zrušte výber poľa **Preferred** (Preferované) pre protokol na obrazovke **Protocol setup** (Nastavenie protokolu). Pozrite si časť **7.2.1 Podrobnosti protokolu** pre viac informácií.
 - j Pre sklíčka **ISH** môžete vybrať protokol aplikácie sondy a protokol odstránenia sondy. Alebo sa môžete rozhodnúť, že nebudete mať žiadny protokol aplikácie sondy ani žiadny protokol odstránenia sondy.
 - k Ak nie je zvolený žiadny protokol aplikácie sondy alebo protokol odstránenia sondy, uistite sa, že sú zrušené aj protokoly hybridizácie a denaturácie.
- 8 Pri jednom farbení by ste vo všeobecnosti mali ponechať predvolenú funkciu **Auto** (Automaticky) pre jedinečné identifikátory produktov (UPI) na ľavej strane dialógového okna. Ak však chcete vybrať konkrétne číslo šarže pre konkrétne sklíčko (napr. na overenie medzi šaržami), vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu v nasledujúcich poliach:
- **Marker UPI** – UPI nádoby na reagencie pre značkovač
 - **Detection System UPI** – UPI detekčného systému.

Na spracovanie sklíčok v rovnakom cykle (v systéme BOND-MAX a BOND-III) musia byť identifikátory UPI rovnaké alebo je potrebné vybrať možnosť **Auto** (Automaticky).

- 9 Kliknite na možnosť **Add slide** (Pridať sklíčko).

Položka **Add slide** (Pridať sklíčko) pridá sklíčko s údajmi aktuálne zobrazenými v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) a potom ponechá dialógové okno otvorené. To uľahčuje rýchle pridanie viacerých sklíčok pre vybraný prípad.

- 10 Kliknite na položku **Close** (Zatvoriť) po dokončení pridávania sklíčok pre tento prípad.

6.5.3 Kopírovanie sklíčka



Sklíčko nemožno skopírovať, ak odkazuje na odstránený protokol.

Kopírovanie existujúceho sklíčka:

- 1 Dvakrát kliknite na sklíčko, ktoré chcete skopírovať, a otvorte dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka).
- 2 Kliknite na položku **Copy slide** (Kopírovať sklíčko).
Dialógové okno sa zmení na okno **Add slide** (Pridanie sklíčka) s tlačidlom **Add slide** (Pridať sklíčko).
- 3 Skontrolujte údaje sklíčka a podľa potreby ich upravte.
- 4 Kliknite na možnosť **Add slide** (Pridať sklíčko).

Nové sklíčko vrátane akýchkoľvek komentárov sa pridá do rovnakého prípadu ako skopírované sklíčko.

6.5.4 Úpravy sklíčka

Ak chcete upraviť podrobnosti o sklíčku na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka), dvakrát naň kliknite a otvoríte dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka). Zmeňte podrobnosti podľa popisu v časti [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#).



Ak upravíte podrobnosti o sklíčku, pre ktoré už bol štítok vytlačený, pred spracovaním sklíčka štítok znova vytlačte.

6.5.5 Odstránenie sklíčka

Ak chcete sklíčko odstrániť zo zoznamu sklíčok, kliknite naň pravým tlačidlom myši v zozname sklíčok na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) a potom vyberte vo vedľajšej ponuke položku **Delete slide** (Odstrániť sklíčko). Vybrané sklíčko môžete odstrániť aj pomocou klávesu Delete (Odstrániť).


6.5.6 Manuálna identifikácia sklíčka

Akokoľvek sklíčko v systéme BOND je možné kedykoľvek identifikovať. Kliknite na ikonu **Search** (Vyhľadávanie)



na paneli funkcií a otvoríte dialógové okno **Manual ID entry** (Manuálne zadanie identifikátora).

Obrázok 6-4: Dialógové okno pre manuálne zadanie identifikátora

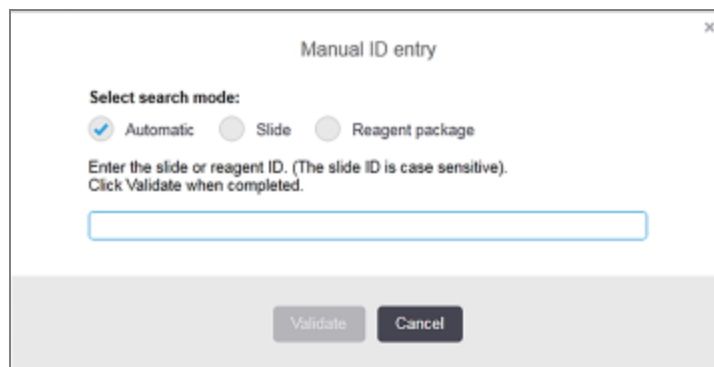

Pri sklíčkach so štítkami s dvojrozmernými čiarovými kódmi, napríklad tými, ktoré vytlačí systém BOND, nasnímajte štítok a pre dané sklíčko otvoríte dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka). Alebo manuálne zadajte 8-ciferný číselný identifikátor vrátane počiatkových núl a potom kliknite na položku **Validate** (Overiť).

6.5.7 Pridanie panela sklíčok

Panel je preddefinovaná súprava značkovačov s pridruženými typmi tkanív. Pomocou panelov môžete rýchlo pridať niekoľko sklíčok so značkovačmi, ktoré sa bežne používajú spoločne, pozrite si časť [8.4 Obrazovka panela reagencií](#).

Ak chcete pridať panel sklíčok do prípadu, postupujte nasledovne z obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčok):

- 1 Kliknite na položku **Add panel** (Pridať panel). Otvorí sa dialógové okno **Add slides from panel** (Pridať sklíčka z panela).
- 2 V rozbaľovacom zozname zvolte panel. Zobrazia sa sklíčka v paneli.
- 3 Ak je to potrebné, niektoré zo sklíčok vylúčte zrušením začiarknutia políčok a potom kliknite na položku **Add Slides** (Pridať sklíčka).

Systém BOND pridá sklíčka do prípadu.

- Pre ISH sklíčka sa dávkovací objem automaticky nastaví na 150 µl.
- Pre IHC sklíčka je dávkovací objem nastavený na predvolenú hodnotu prípadu.
- Pre všetky sklíčka je prípravný protokol nastavený na predvolené nastavenie prípadu.



Panely sa dajú použiť na pridanie sklíčok v režimoch farbenia Single (Jednoduché) alebo Parallel multiplex (Paralelné multiplexové nanášanie), ale nie Sequential multiplex (Sekvenčné multiplexové nanášanie).

6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach

Softvér BOND má dve nastavenia objemu dávkovania, nastavené pre každé sklíčko v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) (pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)).



Nastavenie 100 µl je možné použiť iba pre sklíčka IHC na module spracovania BOND-MAX – všetky sklíčka spracované v systéme BOND-III a BOND-PRIME a všetky sklíčka ISH (na oboch typoch modulov spracovania) musia používať nastavenie 150 µl. Modul spracovania BOND-PRIME používa inú metódu dávkovania, ako je tá opísaná nižšie (pozrite si [7 Protokoly \(na riadiacom zariadení BOND\)](#)).

V rámci modulov spracovania BOND-III a BOND-MAX nastavenie objemu dávkovania určuje pozíciu dávkovania reagensu na sklíčko, ako aj vydávaný objem:

- Pre dávky 100 µl sú krycie sklíčka Covertile stiahnuté späť približne do polovice sklíčka a nasávací sonda dodáva protilátku na hornú stranu krycích sklíčok Covertile (približne do polovice sklíčka).
- Pre dávky 150 µl krycie sklíčka Covertile pokrývajú väčšiu časť podložných sklíčok. Reagencia je opäť podávaná na vrchnú stranu krycích sklíčok Covertile, takže väčšia plocha podložných sklíčok dostáva reagensu.

Rozdiel v oblastiach podložných sklíčok, ktoré dostanú reagensu, znamená, že je dôležité správne umiestniť tkanivo. Pre dávky 100 µl je obvykle možné farbenie iba jednej vzorky a mala by sa umiestniť na dolnú polovicu sklíčka (mimo štítok). Pre dávky 150 µl sa dve vzorky tkaniva ľahšie zmestia na podložné sklíčka, alebo ak sa použije iba jedna, mala by sa umiestniť do stredu sklíčka. Úžitkové plochy sklíčka pre rôzne nastavenia objemu dávkovania sú uvedené na [Obrázok 6-5](#). Sklíčka Leica BOND Plus a Leica BOND Apex sú označené tak, aby zobrazovali oblasti, na ktoré sa má tkanivo umiestniť.

Obrázok 6-5: Úžitkové plochy sklíčka pre rôzne nastavenia objemu dávkovania

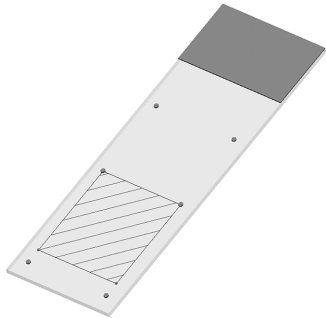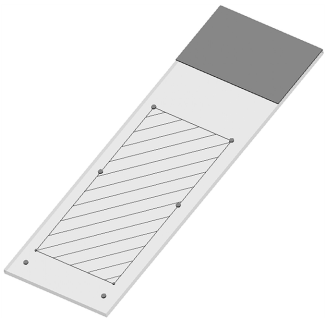	100µl	150µl
Úžitková plocha		

- Šrafované oblasti ukazujú, kde môže byť tkanivo umiestnené na sklíčka s rôznymi objemami dávkovania.
- Zobrazené bodky označujúce polohu sú na sklíčkach Leica BOND Plus a Leica BOND Apex (pozrite si časť [2.6.1 Sklíčka](#)).

Moduly spracovania BOND-III a BOND-PRIME predvolene dávajú iba 150 µl – ak sú vložené sklíčka s objemom dávkovania 100 µl, nebude možné spustiť spracovanie.

Pre sklíčka IHC v systémoch BOND-MAX a BOND-III sú objemy dávkovanej protilátky uvedené v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) – 100 µl alebo 150 µl. Pre sklíčka ISH (pre oba typy modulov spracovania) je vynútené nastavenie 150 µl a moduly spracovania používajú pozície 150 µl krycích sklíčok Covertile a sondy. Systém BOND však dávkuje viac ako 150 µl sondy:

- pre sondy RNA systém BOND dávkuje 220 µl v dvoch krokoch – 150 µl a 70 µl,
- pre sondy RNA systém BOND dávkuje 240 µl v dvoch krokoch – 150 µl a 90 µl.

V závislosti od protokolu sa pri premývaní a ďalších krokoch použijú odlišné objemy.

Predvolené nastavenie objemu dávkovania

Pre IHC na systéme BOND-MAX je možné objem dávkovania (150 µl alebo 100 µl) nastaviť pre každé jednotlivé sklíčko, avšak softvér BOND umožňuje konfigurovať dve úrovne predvolených nastavení. Môžete nastaviť predvolenú hodnotu pre celý systém (pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)). Toto nastavenie je možné prepísať pre jednotlivé prípady s predvolenými hodnotami prípadov nastavenými v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) (pozrite si časť [6.3.3 Pridanie prípadu](#)). Nakoniec je možné nastaviť objem dávkovania pre jednotlivé sklíčka v dialógovom okne **Add slide** (Pridať sklíčko) (pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)).

Všetky sklíčka musia mať rovnaký objem dávkovania, ktorý sa má spracovať spolu v tom istom cykle (pozrite si časť [6.9 Kompatibilita sklíčok](#)).

6.6 Označovanie sklíčok

Všetky sklíčka, ktoré sú farbené v systéme BOND, musia byť označené, aby ich softvér dokázal identifikovať a následne pre ne spustiť správne protokoly. Všetky štítky sklíčok vytvorené v systéme BOND majú identifikátor štítka (uvedený v alfanumerických znakoch ako 2-rozmerný čiarový kód), ktorý sa používa na automatickú identifikáciu sklíčok na moduloch spracovania. Štítky vytvorené v systéme LIS (s identifikátormi 2-rozmerným čiarovým kódom) sa dajú tiež automaticky identifikovať. Na štítky sklíčok by sa však vždy mali uvádzať dodatočné informácie čitateľné človekom, aby sa dali sklíčka identifikovať, ak identifikátory štítkov nemožno automaticky identifikovať, napríklad ak sú rozmazané (pozrite si časť [10.3 Labels \(Štítky\)](#)).

Štítky sa musia nalepiť na sklíčka skôr, ako sa vložia do modulu spracovania. Dajte pozor, aby boli štítky správne pripevnené, aby mohol snímač identifikátorov efektívne skenovať identifikátory štítkov (pre 2-rozmerné čiarové kódy).

Na použitie so značkovačom štítkov Leica Biosystems musíte použiť značkovač sklíčok dodávaný spoločnosťou BOND.

- [6.6.1 Tlač štítkov a nalepenie na sklíčka](#)
- [6.6.2 Identifikátory sklíčok a identifikátory štítkov](#)

6.6.1 Tlač štítkov a nalepenie na sklíčka

- 1 Ak chcete vytlačiť štítok pre jedno sklíčko, kliknite pravým tlačidlom myši na sklíčko a potom vyberte položku **Print label** (Vytlačiť štítok). V tomto prípade sa nezobrazí dialógové okno **Print slide labels** (Tlač štítkov sklíčok). V systéme BOND-ADVANCE, ktorý obsahuje definované súbory, sa na vytlačenie štítku použije predvolený značkovač sklíčok. V opačnom prípade sa použije prvý značkovač v zozname (pozrite si časť [10.6.3 Značkovače sklíčok](#)).
- 2 Po nastavení všetkých sklíčok kliknite na položku **Print labels** (Vytlačiť štítky) na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka).
- 3 Vyberte, či chcete tlačiť štítky sklíčok pre:
 - All slide labels not yet printed (Všetky ešte nevytlačené štíty sklíčok) – sklíčka vo všetkých prípadoch, pre ktoré neboli vytlačené štítky,
 - All slide labels not yet printed for current case (Všetky ešte nevytlačené štíty sklíčok pre tento prípad) – sklíčka v aktuálnom prípade, pre ktoré neboli vytlačené štítky,
 - Current case (Aktuálny prípad) – všetky sklíčka pre aktuálne vybraný prípad vrátane tých, ktoré boli predtým vytlačené,

Štítky sklíčok sú vytlačené v poradí, v akom boli ich prípady vytvorené, a v rámci každého prípadu v poradí, v akom boli vytvorené sklíčka.

- 4 Vyberte štítok sklíčka, ktorý chcete použiť.

(Nastavte predvolený značkovač v klientovi správy na obrazovke **Hardware** (Hardvér), pozrite si časť [10.6.2 Súbory](#).)


- 5 Kliknite na položku **Print** (Tlačiť).

Ak prebieha tlač štítkov, v ľavej dolnej časti obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) sa zobrazí blikajúca ikona.



- 6 Uistite sa, že matná plocha sklíčka, na ktorú sa štítok nalepí, je úplne čistá a suchá.
- 7 Nalepte štítok s ID sklíčka zarovnaný paralelne s koncom sklíčka. Štítok by mal smerovať pravou stranou nahor (na rovnakej strane sklíčka ako tkanivo).
 - Zarovnajzte štítok v pravom uhle, pretože modul spracovania nedokáže správne nasnímať nezarovnané štítky.
 - Na zabezpečenie prilepenie vyvíjajte pevný tlak na celú oblasť tlačených štítkov BOND.
 - Tlačený štítok by mal byť úplne pripevnený k povrchu. Tlačený štítok by nemal prečnievať cez okraj sklíčka.
 - Ak sa štítok ponorí do tekutiny, pred uskladnením ho nechajte vyschnúť.

Obrázok 6-6: Umiestnite štítok do vnútra okrajov sklíčka

**Správne:**

Štítok je v pravom uhle a vo vnútri okrajov sklíčka.

**Nesprávne:**

Štítok presahuje okraje sklíčka.

**Nesprávne:**

Štítok je pokrivený.



POZOR: Umiestnite všetky časti štítka ku všetkým okrajom sklíčka. Odkrytý lepkavý povrch môže spôsobiť, že sa štítok sklíčka (a sklíčko) prilepí na krycie sklíčko Covertile alebo iné zariadenie a poškodí sklíčko.



Pri výmene pásky tlačiarne BOND a rolky štítkov vymeňte atramentovú pásku za rovnaké číslo produktu. Pokyny na výmenu roliek štítkov a atramentovej pásky sú súčasťou balenia.



V prípade tlačených štítkov, ktoré sú dlhšie ponorené v reagensii alebo sú súčasťou agresívneho postupu, zvážte nasledujúce:

- Štítok nalepte na sklíčko po spracovaní.
- Použite sekundárny identifikátor na povrchu sklíčka
- Zamedzte alebo obmedzte ponorenie pásky tlačiarne a štítkov BOND
- Použite ochranné prekrytie



Použitie atramentové valčeky budú obsahovať negatívne tlačených informácií. Ak informácie obsahujú osobne identifikovateľné informácie, použité atramentové valčeky sa musia zlikvidovať v súlade s laboratórnymi postupmi a/alebo miestnymi predpismi o ochrane osobných údajov.



Údaje o odolnosti lepidla a atramentu sú určené v podmienkach zákaznickeho testovania. Používanie pásky tlačiarne a štítkov BOND musí laboratórium overiť podľa jeho postupov a podmienok.

Externé odvoskovanie a získavanie epitopov

Odvoskovanie a získavanie epitopov, ak sa vykonáva mimo systému BOND, je najlepšie vykonávať po označení sklíčok. Tým sa zabráni vysychaniu sklíčok pri zadávaní údajov sklíčok a nastavovaní systému BOND na spustenie požadovaného protokolu (protokolov) a tiež sa tým zabráni ťažkostiam pri označovaní mokrych sklíčok po vykonaní týchto krokov.



Ak na odvoskovanie mimo modulu spracovania používate xylén, nedotýkajte sa štítka, aby sa tlač nerozmazávala.



Predĺžené namáčanie alebo vystavenie derivátom benzénu, D-limonénom a alifatickým uhľovodíkom, acetónu, vode a reagensiam na báze vody môže znížiť účinnosť lepidla štítka s identifikátorom sklíčka a spôsobiť možnú stratu integrity tlačne. Odporúčame, aby sa štítky dlhší čas neponárali. Pozrite si informácie o konkrétnom produkte na webovej stránke LBS.



POZOR: Na odvoskovanie na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX používajte iba roztok na odvoskovanie BOND.

Na odvoskovanie na moduloch spracovania BOND-PRIME používajte iba BOND-PRIME Dewax Solution.

Nepoužívajte xylén, náhradky xylénu a iné reagensie, ktoré môžu degradovať časti modulov spracovania a spôsobiť únik tekutiny.

6.6.2 Identifikátory sklíčok a identifikátory štítkov

Systém BOND poskytuje jedinečný identifikátor sklíčka zakaždým, keď je vytvorené nové **sklíčko**. Systém BOND tiež vytvára jedinečný identifikátor štítka zakaždým, keď je vytlačený **štítok sklíčka**. Identifikátor štítka je 2D čiarový kód.



Pre sklíčka systému LIS môže byť identifikátor definovaný systémom LIS a môže to byť akákoľvek číselná hodnota (s 8 alebo menej číslicami).

Identifikácia sklíčka



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Keď sú štítky umiestnené na sklíčkach, systém môže identifikovať sklíčka v každej pozícii v zostavách na farbenie sklíčok (prečítajte si časť [5.1.5.1 Automatická identifikácia sklíčok](#)).

Sklíčka bez identifikátora alebo s nerozpoznanými identifikátormi musia byť v systéme manuálne identifikované (prečítajte si časť [5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme](#)) alebo je potrebné vytlačiť štítok a nalepiť ho na sklíčko, ktoré bude znova nasnímané.

Nakonfigurujte informácie tak, aby sa zobrazovali na štítkoch sklíčok v klientovi správy na obrazovke **Label configuration** (Konfigurácia štítka) (pozrite si časť [10.3 Labels \(Štítky\)](#)).

6.7 Súhrnná správa o nastavení sklíčok

V súhrne o nastavení sklíčok sú uvedené všetky sklíčka (vo všetkých prípadoch), ktoré sú aktuálne nakonfigurované na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka). Sklíčka sú zoskupené podľa prípadu s poskytnutými údajmi, ako sú značkovače a objem dávkovania. V dolnej časti správy je zoznam všetkých reagencií a systémov reagencií podľa potrieb sklíčok v správe spolu s počtom testov pre každé z nich. Pre každý modul spracovania BOND existujú samostatné zoznamy.



Na zobrazenie detailov v správe musíte mať zadaný aspoň jeden modul spracovania BOND-PRIME.

Správa je cennou pomôckou pri príprave. Pomáha vám zaistiť, aby sklíčka vložené do každého zásobníka boli kompatibilné (pozrite si časť [6.9 Kompatibilita sklíčok](#)) a obsahuje reagenty a systémy reagentov, ktoré je potrebné vložiť.

Ak chcete vytvoriť správu o nastavení sklíčok, kliknite na tlačidlo **Slide setup summary** (Súhrn o nastavení sklíčok).

Pre každé sklíčko správa obsahuje nasledujúce informácie.

Pole	Opis
Slide ID (ID sklíčka)	Systém BOND priradí ku každému sklíčku jedinečný identifikátor.
Marker (Značkovač)	Značkovač (značkovače)
Staining protocol (Protokol farbenia)	Protokol farbenia.
Preparation (Príprava)	Protokol prípravy (ak existuje)
HIER (Teplom indukované získavanie epitopov)	Protokol HIER (ak existuje)
Enzyme (Enzým)	Protokol získavania enzýmom (ak existuje)
Dispense volume (Dávkovací objem)	Objem reagentu, ktorý sa má dávkovať (pozrite si časť 6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach)
Tissue type (Typ tkaniva)	Testovacie tkanivo, tkanivo pozitívnej kontroly alebo tkanivo negatívnej kontroly

Pre sklíčka so sekvenčným multiplexovým farbením sa zobrazujú najviac dva riadky v stĺpcoch Marker (Značkovač), Protocols (Protokoly), Dispense volume (Objem dávkovania) a Tissue type (Typ tkaniva), zoskupených podľa položky Slide ID (Identifikátor sklíčka).

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

V predvolenom nastavení je systém BOND nakonfigurovaný tak, že nové prípady a sklíčka môžu byť vytvorené po vložení podnosu na sklíčka do modulu spracovania a nasnímaní sklíčok.

Prvá časť uvedená nižšie uvádza pokyny na vytvorenie takéhoto improvizovaného prípadu a sklíčka. Druhá časť popisuje nastavenia možností pre alternatívne pracovné postupy.

- [6.8.1 Vytvorenie nových prípadov a/alebo sklíčok po nasnímaní](#)
- [6.8.2 Možnosti identifikácie sklíčok v systéme](#)

6.8.1 Vytvorenie nových prípadov a/alebo sklíčok po nasnímaní


Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu a po vložení a zobrazení sklíčok pridajte informácie o prípadoch a sklíčkach (postup je podobný postupu asistovanej identifikácie opísanému v časti [5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme](#), ale teraz zahŕňa aj vytváranie nových prípadov a sklíčok).

- 1 Vložte sklíčka obvyklým spôsobom do modulu spracovania.

Nie je potrebné vytvárať prípady alebo sklíčka v softvéri BOND ani tlačiť štítky, je možné použiť aj ručne písané štítky alebo štítky tretích strán.

Systém nerozpozná sklíčka, a preto zobrazí snímky štítkov.

Obrázok 6-7: Sklíčko nie je automaticky identifikované




Ak sa snímky štítkov konzistentne nezobrazujú pre konkrétny modul spracovania, môže byť nakonfigurovaný tak, aby nezachytával snímky štítkov sklíčok. Kontaktujte oddelenie podpory zákazníka a zariadenie, aby bolo toto nastavenie prekonfigurované pre daný modul spracovania.

- 2 Ak chcete spustiť dialógové okno **Slide identification** (Identifikácia sklíčka), vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
 - a Dvakrát kliknite na snímku sklíčka.
 - b Pravým tlačidlom myši kliknite na snímku a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť **Select manually** (Vybrať manuálne).

Zobrazí sa dialógové okno **Slide identification** (Identifikácia sklíčka) s dostupnými tlačidlami **New case** (Nový prípad) a **New slide** (Nové sklíčko) (položky 1 a 2 na [Obrázok 6-8](#)).

Obrázok 6-8: Dialógové okno identifikácie sklíčka so zobrazením stavu sklíčka

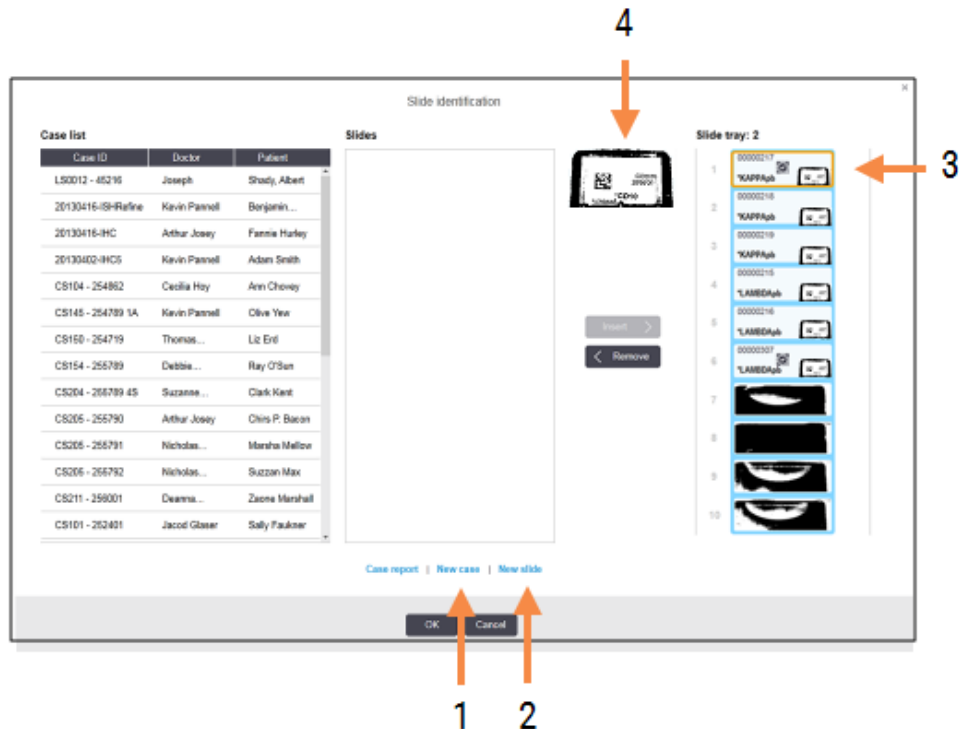

V niektorých laboratóriách môžu byť deaktivované tlačidlá **New case** (Nový prípad) alebo **New slide** (Nové sklíčko), pozrite si časť [6.8.2 Možnosti identifikácie sklíčok v systéme](#).

Aktívne sklíčko je zvýraznené na podnose na sklíčka (položka 3).

Dialógové okno obsahuje zväčšenú snímku štítka (položka 4), ktorá pomáha pri identifikácii sklíčka. Ak chcete vidieť ešte väčšie zväčšenie štítka, podržte kurzor nad sklíčkom v pravej table.

Na ľavej table sú uvedené všetky prípady s aktuálnymi sklíčkami. V predvolenom nastavení sa zobrazujú iba prípady so sklíčkami, pre ktoré boli vytlačené štítky (môžete to zmeniť tak, aby zahŕňali prípady so sklíčkami, pre ktoré neboli vytlačené štítky, pozrite si časť [6.8.2.2 Externé štítky sklíčok](#)).

Stredná tabla zobrazuje sklíčka nakonfigurované pre prípad vybraný v ľavej table, kde sklíčka ešte neboli priradené k žiadnym sklíčkam zobrazeným na module spracovania. Opäť platí, že v predvolenom nastavení sa zobrazujú iba sklíčka, pre ktoré boli vytlačené štítky, ale toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa zobrazili všetky sklíčka nakonfigurované pre prípad.



Uistite sa, že ste vybrali správnu snímku so štítkom, pretože v prípade nesprávneho výberu to môže mať vplyv na vaše sklíčka.

- 3 Ak chcete vytvoriť nový prípad, kliknite na položku **New case** (Nový prípad) (položka 1).
Vytvorte nový prípad pre vybrané sklíčko bežným spôsobom (prečítajte si časť [6.3.3 Pridanie prípadu](#)).
- 4 Po kliknutí na tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Add case** (Pridať prípad) vyberte nový prípad v zozname prípadov v dialógovom okne **Slide identification** (Identifikácia sklíčka).
- 5 Ak chcete vytvoriť nové sklíčko pre prípad, ktorý ste práve vytvorili, kliknite na položku **New slide** (Nové sklíčko) (položka 2).
Otvorí sa dialógové okno **Add slide** (Pridať sklíčko).
- 6 V softvéri vytvorte bežným spôsobom nové sklíčko pre fyzické sklíčko vybrané v pravej časti tably (prečítajte si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)).
Po jeho pridaní sa nové sklíčko zobrazí v strednej table dialógového okna (t. j. zatiaľ čo nový prípad zostane vybraný v ľavom zozname prípadov).
- 7 Na zabezpečenie toho, že je stále vybraná správna snímka štítku, kliknite na položku **Insert** (Vložiť), aby zodpovedal novému sklíčku v strednej table.
Sklíčko bude zo strednej tably odstránené a snímka štítku bude v pravej table nahradená, aby sa zobrazili systémové údaje pre sklíčko tak, ako boli zadané pre nové sklíčko, ktoré ste práve vytvorili.
Ak sklíčka spárujete nesprávne, môžete tento krok vrátiť späť výberom sklíčka v pravej table a kliknutím na položku **Remove** (Odstrániť).
- 8 Sklíčko sa teraz dá spracovať obvyklým spôsobom.
Zopakujte postup vytvárania nových prípadov a sklíčok pre zostávajúce sklíčka v podnose na sklíčka.

6.8.2 Možnosti identifikácie sklíčok v systéme

Nastavenia v klientovi správy môžu povoliť alebo vynútiť rôzne pracovné postupy identifikácie sklíčok jednotlivým povolením alebo zakázaním možností v dialógovom okne **Slide identification** (Identifikácia sklíčka).

6.8.2.1 Obmedzenie alebo zakázanie vytvorenia improvizovaných prípadov a sklíčok

V predvolenom nastavení umožňuje systém BOND vložiť sklíčka, ktoré neboli vytvorené v softvéri BOND (alebo importované zo systému LIS), a vytvoriť prípady a sklíčka v softvéri po nasnímaní sklíčok použitím dialógového okna **Slide identification** (Identifikácia sklíčok). Systém môžete voliteľne nastaviť tak, aby zakázal vytváranie nových prípadov týmto spôsobom (ale stále umožňoval vytváranie nových sklíčok pre existujúce prípady) alebo úplne zakázal vytváranie sklíčok (a prípadov) po načítaní sklíčok. V závislosti od vášho nastavenia môže byť vypnutá položka **New case** (Nový prípad) alebo obe položky **New case** (Nový prípad) a **New slide** (Nová sklíčko) v dialógovom okne **Slide identification** (Identifikácia sklíčok) (pozrite si [Obrázok 6-8](#)).

Obmedzte možnosti vytvorenia improvizovaných prípadov a sklíčok v klientovi správy na obrazovke **Settings** (Nastavenia) (pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)).

6.8.2.2 Externé štítky sklíčok

Systém BOND môžete nastaviť tak, aby pred spracovaním vyžadoval (alebo nevyžadoval), aby boli všetky sklíčka vytlačené systémom BOND. Pre sklíčka LIS a sklíčka, ktoré nie sú LIS, existujú samostatné nastavenia.

Pre sklíčka, ktoré nie sú LIS, predvolené nastavenie vyžaduje tlač systémom BOND. To znamená, že fyzické sklíčka bez štítkov vytlačených pomocou systému BOND sa automaticky nezhodujú so sklíčkami vytvorenými pre tieto sklíčka v softvéri (aj keď sú identifikátory rovnaké). Okrem toho nemôžete sklíčka porovnávať manuálne pomocou dialógového okna **Slide identification** (Identifikácia sklíčka), pretože sa tu zobrazujú iba sklíčka, ktoré boli vytlačené pomocou systému BOND. V dôsledku toho laboratóriá bez integrácie systémov BOND a LIS, ktoré štítky ručne vypisujú alebo ich tlačia na zariadeniach tretích strán, musia túto možnosť vypnúť. Týmto sú všetky sklíčka vytvorené v systéme k dispozícii na porovnávanie so sklíčkami vloženými do modulu spracovania bez ohľadu na to, či systém BOND štítky vytlačil alebo nie.

Ak chcete umožniť spracovanie sklíčok, pre ktoré štítky nevytlačil systém BOND, zrušte výber položky **Force printing BOND** (Vynútená tlač v systéme BOND) na obrazovke klienta správy **Settings** (Nastavenia) (pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)). (Nie je potrebné zrušiť výber položky **Force printing BOND** (Vynútená tlač v systéme BOND), len aby ste umožnili vytváranie improvizovaných prípadov a sklíčok – pozrite si časť [6.8.2.1 Obmedzenie alebo zakázanie vytvorenia improvizovaných prípadov a sklíčok](#).)



Sklíčka vytvorené pred zrušením výberu **Force printing BOND** (Vynútená tlač v systéme BOND) nebudú k dispozícii na spracovanie, kým sa nevytlačia ich štítky, aj keď sklíčka vytvorené po zrušení výberu tejto možnosti nebudú musieť mať štítky vytlačené.

Pre sklíčka LIS predvolené nastavenie nevyžaduje tlač systémom BOND. To znamená, že sklíčka so štítkami vytlačenými v systéme LIS sa môžu automaticky zhodovať so sklíčkami v softvéri BOND (importované zo systému LIS). Alebo, ak nie je možné vykonať automatickú zhodu (ak je napríklad rozmazaný štítok sklíčka), môžete sklíčka manuálne porovnať pomocou dialógového okna **Slide identification** (Identifikácia sklíčka). Ak však váš pracovný postup obsahuje sklíčka vytvorené v systéme LIS, ale chcete vynútiť, aby boli štítky vytlačené systémom BOND, aktivujte možnosť (vyberte položku **Force LIS printing in BOND** (Vynútená tlač v systéme BOND) na obrazovke klienta správy LIS – pozrite si časť **10.2 LIS (Laboratórny informačný systém)**).

6.9 Kompatibilita sklíčok



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Na to, aby sa kroky v každom cykle synchronizovali spôsobom, ktorý zabezpečí optimálne výsledky pre všetky sklíčka na podnose, sú sklíčka kontrolované na kompatibilitu softvérom BOND počas vkladania podnosov na sklíčka. Nekompatibilné sklíčka sa zobrazia na obrazovke **System status** (Stav systému). Pred spustením cyklu musíte odstrániť alebo vymeniť nekompatibilné sklíčka (pozrite si časť **5.1.4.4 Oprava nastavenia nekompatibilného sklíčka**).

Na to, aby boli bežné sklíčka kompatibilné, musia:

- mať rovnaký objem dávkovania,
- byť všetky určené na jednoduché farbenie alebo všetky na paralelné multiplexové farbenie alebo všetky na sekvenčné multiplexové farbenie,
- mať rovnaké UPI, ak bol špeciálne vybraný počas procesu pridania sklíčka;
- používať rovnaký protokol prípravy,
- používať rovnaký protokol farbenia a
- používať kompatibilné protokoly predbežnej úpravy a/alebo protokoly denaturácie a hybridizácie ISH.

Pravidlá kompatibility protokolov sú uvedené v časti **6.9.1 Kompatibilita protokolov**.

Správy o nastavení sklíčok (**6.7 Súhrnná správa o nastavení sklíčok**) poskytujú niekoľko pomocných informácií, ktoré vám pomôžu zaistiť vloženie kompatibilných sklíčok do každého podnosu.

6.9.1 Kompatibilita protokolov

Protokoly farbenia a prípravy majú prísne obmedzenia kompatibility, zatiaľ čo pri protokoloch predbežnej úpravy teplom a predprípravy enzýmom a protokoloch hybridizácie a denaturácie ISH existuje určitý priestor pre variabilitu. Kompatibilita týchto protokolov závisí od typu modulu spracovania (BOND-III alebo BOND-MAX), počtu a trvania krokov protokolu a stavu modulov spracovania počas týchto krokov. Protokoly sú kompatibilné, ak sú tieto faktory rovnaké alebo sa líšia spôsobom, ktorý je možné prispôbiť bez ovplyvnenia kvality farbenia.

Pravidlá kompatibility pre všetky typy protokolov sú uvedené nižšie.

6.9.1.1 Protokol farbenia

Pri každom sklíčku sa musí použiť rovnaký protokol farbenia. Pri cykloch sekvenčného dvojitého farbenia sa musia použiť rovnaké dva protokoly farbenia v rovnakom poradí.

Sklíčka pre imunohistochemický rozbor a pre in situ hybridizáciu sa nedajú kombinovať v cykloch jednoduchého farbenia, ale môžu sa kombinovať v cykloch sekvenčného multiplexového farbenia.

6.9.1.2 Protokoly prípravy

Pre protokoly dewax (odvoskovanie) a bake and dewax (zahrievanie a odvoskovanie)

- Rovnaký protokol sa musí použiť pre všetky sklíčka na podnose a
- Sklíčka s protokolom prípravy nemôžu byť zmiešané so sklíčkami bez protokolu prípravy.

6.9.1.3 Protokoly predbežnej úpravy

Sklíčka len so získavaním pomocou tepla, len so získavaním pomocou enzýmov, získavaním pomocou tepla a získavaním pomocou enzýmov a bez získavania epitopov môžu byť všetky spustené spoločne. Sklíčka, ktoré nedostávajú súčasnú predbežnú úpravu, sú hydratované, zatiaľ čo protokol beží na ostatných sklíčkach (teplom indukované získavanie vždy predchádza enzýmom indukovanému získavaniu).

Podobne sú kompatibilné všetky kombinácie sklíčok s ISH denaturáciou a hybridizáciou a bez nej.

Nasledujúce oddiely uvádzajú podmienky pre kompatibilitu protokolov predbežnej úpravy s protokolmi rovnakého typu predbežnej úpravy.

Predbežná úprava teplom

1 Protokoly predbežnej úpravy teplom sú kompatibilné, ak majú:

- rovnaký počet krokov a
- rovnaké časy inkubácie pre každý krok, s výnimkou krokov zahrievania.

Pri súbežných krokoch zahrievania sa pre všetky sklíčka použije najdlhšia doba nastavená pre daný krok. Sklíčka s kratšou nastavenou dobou trvania sa zahrievajú len po nakonfigurovanú dobu, po ktorej sa vypne napájanie ohrievača sklíčok.

2 Protokoly využívajúce roztoky na získavanie epitopov 1 a 2 sa v cykloch môžu kombinovať.

3 Sklíčka využívajúce predbežnú úpravu teplom sa môžu prevádzkovať v podnosoch so sklíčkami, ktoré nevyužívajú predbežnú úpravu teplom. Sklíčka, ktoré nie sú ošetrené predbežnou úpravou, sa hydratujú roztokom na získavanie epitopov pri teplote okolia, zatiaľ čo sa spracúvajú ostatné sklíčka.

Predpríprava enzýmu

- 1 Protokoly predprípravy enzýmu sú kompatibilné, ak majú:
 - rovnaký počet krokov a
 - rovnaké časy inkubácie pre každý krok.
- 2 V jednom cykle je možné aplikovať až 2 typy enzýmov.
- 3 Sklíčka využívajúce predprípravu enzýmom sa môžu prevádzkovať v podnosoch so sklíčkami, ktoré nevyužívajú predprípravu enzýmom. Sklíčka, ktoré nie sú ošetrené predprípravou enzýmom, sa hydratujú pri teplote okolia, zatiaľ čo sa spracúvajú ostatné sklíčka.

6.9.1.4 Denaturácia ISH

Protokoly denaturácie sú kompatibilné, ak majú rovnaké časy inkubácie. Inkubačné teploty sa môžu líšiť.

6.9.1.5 Hybridizácia ISH

Protokoly hybridizácie sú kompatibilné, ak majú rovnaké časy inkubácie. Inkubačné teploty sa môžu líšiť.

7

Protokoly (na riadiacom zariadení BOND)

V softvéri BOND predstavujú protokoly sériu krokov vykonaných na farbenie vzoriek tkaniva.

Váš systém BOND je dodávaný so súpravou preddefinovaných protokolov Leica Biosystems, ktoré nemožno upravovať alebo odstrániť. Preddefinované protokoly boli validované spoločnosťou Leica Biosystems. Prispôsobené protokoly však možno vytvoriť skopírovaním a úpravou existujúcich preddefinovaných protokolov.



VÝSTRAHA: Všetky prispôsobené protokoly musia byť overené v súlade s miestnymi laboratórnymi postupmi a požiadavkami. Možnosť vytvoriť a uložiť protokol neznamená, že je vhodný pre zamýšľanú úlohu.

Táto kapitola má nasledujúce časti:

- [7.1 Typy protokolov](#)
- [7.2 Obrazovka nastavenia protokolu](#)
- [7.3 Vytvorenie nových protokolov](#)
- [7.4 Úpravy používateľských protokolov](#)
- [7.5 Správy protokolu](#)
- [7.6 Preddefinované protokoly](#)

7.1 Typy protokolov

Všetky protokoly v systéme BOND majú „typ“ podľa konkrétnych funkcií, ktoré majú vykonávať. Napríklad protokoly predbežného farbenia HIER sú jedným typom, protokoly IHC so sekvenčným multiplexovým farbením sú iný typ.

- Typ protokolu nie je možné zmeniť.
- Ak chcete vytvoriť nový protokol, musíte skopírovať existujúci protokol typu, v ktorom má byť nový protokol. Kroky protokolu môžete potom podľa potreby upravovať.

Typicky sa v každom spracovaní uskutočňuje množstvo protokolov rôznych typov, aby sa pripravili sklíčka, aplikovali sa značky a potom sa aplikoval chromogén. Tieto sekvencie a protokoly, ktoré používajú, typicky vyžadujú modifikáciu pre multiplexové farbenie.

- [7.1.1 Režimy farbenia](#)
- [7.1.2 Sekvencie protokolu](#)

7.1.1 Režimy farbenia

Systém BOND má tri režimy farbenia:

- **Single** (Jednoduché) – aplikácia jedného značkovača a chromogénu na jedno sklíčko.
- **Parallel Multiplex** (Paralelné multiplexové) – aplikácia dvoch rôznych značkovačov a chromogénov na jedno sklíčko. Značkovače sa zmiešajú dohromady do „koktailu“ a aplikujú sa podľa protokolu jednoduchého farbenia.
- **Sequential multiplex** (Sekvenčné multiplexové) – aplikácia dvoch rôznych značkovačov a chromogénov na jedno sklíčko. Značkovače sa nanášajú jeden po druhom v samostatných protokoloch farbenia.

Každý protokol farbenia má „metódu farbenia“, ktorá označuje jeho úlohu vzhľadom na multiplexové alebo jednoduché farbenie.

Jednoduché farbenie má iba jednu metódu farbenia „Single“ (Jednoduché).

Paralelné multiplexové farbenie má iba jednu metódu farbenia „Parallel multiplex“ (Paralelné multiplexové).

Preddefinované protokoly sekvenčného multiplexového farbenia majú metódu farbenia „Single“ (Jednoduché), ktorú nie je možné zmeniť. Máte však možnosť tieto preddefinované protokoly skopírovať a upraviť spôsob farbenia tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám.

Sekvenčné multiplexové farbenie má nasledujúce metódy farbenia:

- **First** (Prvé) – používa sa ako prvý protokol v sekvenčnom multiplexovom farbení
- **Final** (Konečné) – používa sa ako posledný protokol v sekvenčnom multiplexovom farbení

Napríklad, používateľom vytvorený protokol môže byť nakonfigurovaný na použitie ako jednoduchý protokol, alebo môže byť tiež nakonfigurovaný na použitie ako predbežný protokol a/alebo konečný protokol. Nezapudnite skontrolovať celý protokol, aby ste sa ubezpečili, že všetky kroky sú vhodné pre všetky metódy farbenia (napríklad jednoduchý protokol má kontrastné farby, čo pre predbežné protokoly nie je potrebné).

Typy protokolov a metódy farbenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Type (Typ)		Metóda farbenia	Opis
Farbenie	Farbenie IHC – jednoduché farbenie	Jednoduché	Protokol na detekciu jednej protilátky pre jednoduché farbenie.
	Farbenie IHC – sekvenčné multiplexové farbenie	Jednoduché	Protokol na detekciu jednej protilátky pre jednoduché farbenie.
		Predbežné	Protokol pre detekciu prvej protilátky v sekvenčnom multiplexovom farbení
		Konečné	Protokol pre detekciu poslednej protilátky v sekvenčnom multiplexovom farbení
	Farbenie IHC Paralelné multiplexové farbenie	Paralelné multiplexové	Protokol na detekciu protilátok v koktaile v paralelnom multiplexovom farbení
	Detekcia ISH – jednoduchá	Jednoduché	Protokol na detekciu jednej sondy pre jednoduché farbenie.
	Detekcia ISH – sekvenčné multiplexové farbenie	Jednoduché	Protokol na detekciu jednej sondy pre jednoduché farbenie.
		Predbežné	Protokol pre detekciu prvej sondy v sekvenčnom multiplexovom farbení
		Konečné	Protokol pre detekciu poslednej sondy v sekvenčnom multiplexovom farbení
	Detekcia ISH Paralelné multiplexové farbenie	Paralelné multiplexové	Protokol na detekciu koktailových sond v paralelnom multiplexovom farbení (v súčasnosti v tejto kategórii nie sú žiadne protokoly)
Predbežné farbenie	Preparation (Príprava)	–	Odvoskovanie alebo zahrievanie sklíčka (pre adhéziu tkaniva), potom odvoskovanie tkaniva
	Predbežná úprava teplom	–	Získavanie epitopov pomocou tepla
	Predpríprava enzýmu	–	Získavanie epitopov pomocou enzýmov
	Denaturácia ISH	–	Denaturačné protokoly pre DNA ISH
	Hybridizácia ISH	–	Hybridizačné protokoly pre ISH

7.1.2 Sekvencie protokolu

Zvyčajne je pre každé sklíčko použitá sekvencia protokolu rôzneho typu. To závisí od výberu protokolov prípravy, získavania epitopov, denaturácie, hybridizácie a farbenia podľa vhodnosti pre tkanivo, značkovač a všeobecné laboratórne postupy. Tieto sekvencie je možné nastaviť pre každé sklíčko jednotlivo pri vytváraní sklíčka (pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)), avšak softvér BOND vám tiež umožňuje nastaviť predvolené protokoly na urýchlenie vytvorenia snímky, keď nie sú potrebné špeciálne protokoly:

- štandardný protokol prípravy (napr. *Dewax) je nastavený pre celý systém BOND v klientovi správy (pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)),
- predvolené hodnoty pre všetky ostatné typy protokolov sú stanovené pre každý značkovač, z obrazovky **Reagent Setup** (Nastavenie reagensie) (pozrite si časť [8.2.1 Pridanie alebo úprava reagensie](#)).

Nastavte vhodné predvolené protokoly tak, aby ste minimalizovali čas potrebný na prípravu jednotlivých sklíčok. V prípade potreby môžete pri vytváraní sklíčok zmeniť protokoly pre jednotlivé sklíčka.

Poradie, v ktorom sa spúšťajú protokoly v sekvencii, automaticky nastavuje softvér BOND a je toto poradie uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dávkovanie a odstraňovanie sond nie je zahrnuté v žiadnom protokole, k tomu tiež dochádza automaticky.

Poradie	Protokol (alebo sonda)	IHC alebo ISH	Komentár
1	Preparation (Príprava)	Obidva	Voliteľné odstránenie vosku v systéme v rámci prípravy na chémiu.
2	HIER (Teplom indukované získavanie epitopov) (teplom indukované získavanie epitopov)	Obidva	Pre väčšinu sklíčok sa používa buď protokol HIER, alebo EIER, niekedy však oba alebo žiadny.
3	EIER (enzýmom indukované získavanie epitopov)	Obidva	
4	Aplikácia sondy	ISH	Nevyberá si ju používateľ, v tomto prípade systém BOND automaticky obsahuje príslušný protokol.
5	Denaturácia	ISH	Denaturačný protokol pre sondy DNA. Sondy DNA by mali vždy používať denaturáciu.
6	Hybridizácia	ISH	Požadovaný protokol hybridizácie pre ISH alebo žiadny.
7	Odstránenie sondy	ISH	Nevyberá si ju používateľ, v tomto prípade systém BOND automaticky obsahuje príslušný protokol.

Poradie	Protokol (alebo sonda)	IHC alebo ISH	Komentár
8	Farbenie	Obidva	Požadovaný protokol na aplikáciu chromogénu a súvisiacich reagencií. V tomto protokole sú obsiahnuté primárne IHC.

Protokoly vybrané pre protokolové sekvencie môžu byť preddefinované alebo si môžete vytvoriť vlastné protokoly a vybrať ich (pozrite si [Kapitola 7.3: Vytvorenie nových protokolov](#)).

7.1.2.1 Protokoly a sekvencie protokolov pre sekvenčné multiplexové farbenie

Sekvenčné multiplexové farbenie v podstate spustí dve sekvencie protokolu farbenia, jeden po druhom. Môže ísť o akúkoľvek kombináciu protokolov IHC a/alebo protokolov ISH. Prvý značkovač zvyčajne, ale nie vo všetkých prípadoch, používa systém BOND Polymer Refine Detection System s DAB chromogénom a druhý značkovač používa systém BOND Polymer Refine Red Detection System s chromogénom Fast Red.


Niektoré protokoly v sekvencii aplikujúce druhý značkovač môžu byť často vynechané alebo, ak sú obsiahnuté, mali by byť modifikované. Kroky v protokoloch farbenia pre prvý a druhý značkovač by sa mali tiež typicky modifikovať (protokoly nevyhnutne vyžadujú určitú modifikáciu, aby mali príslušnú sadu metód farbenia, pozrite si časť [7.1.1 Režimy farbenia](#)). Nižšie uvádzame niektoré návrhy na modifikáciu protokolu a sekvencie protokolu pre sekvenčné multiplexové farbenie. Vo všetkých prípadoch by ste mali vykonať vlastné testy na overenie výsledkov.

- Protokoly prípravy (napr. odvoskovanie) sa môžu spúšťať iba v sekvencii pre prvý značkovač. Softvér neumožňuje výber protokolu prípravy pre protokol sekvencie druhého farbenia.
- Získavanie epitopu sa môže vyžadovať iba raz pred aplikáciou prvého značkovača. Ak je potrebné ďalšie získavanie epitopu pre druhý značkovač, môže postačovať kratšie trvanie alebo nižšia teplota.
- Ak sa vykonáva multiplexové farbenie dvoma sondami, denaturácia sa často vyžaduje iba raz pred nanosením prvého značkovača. Ak sa vyžaduje ďalšia denaturácia pre druhý značkovač, zvyčajne vyžaduje kratšie trvanie.
- V prípade protokolov farbenia sa vo všeobecnosti dosahujú lepšie výsledky, ak sa segment kontrastného farbenia (napr. hematoxylín) odstráni z konca prvého protokolu. Uchová sa pre druhý protokol.

7.2 Obrazovka nastavenia protokolu

Ak chcete pracovať s protokolmi, kliknite na ikonu **Protocol setup** (Nastavenie protokolu)  na paneli funkcií.

Obrázok 7-1: Obrazovka **Protocol setup** (Nastavenie protokolu)

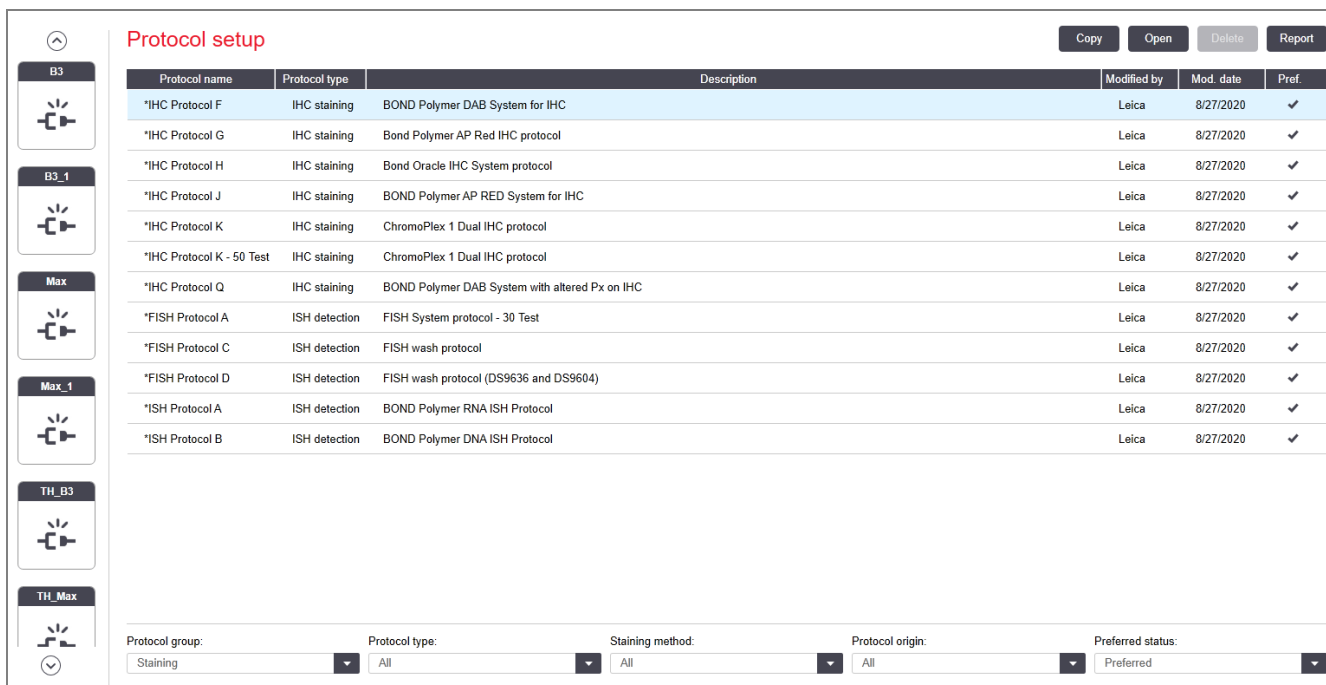

The screenshot shows the 'Protocol setup' interface. On the left, there is a sidebar with icons for different instrument models: B3, B3_1, Max, Max_1, TH_B3, and TH_Max. The main area is titled 'Protocol setup' and contains a table of protocols. At the top right of the table area are buttons for 'Copy', 'Open', 'Delete', and 'Report'. Below the table are filter options for 'Protocol group', 'Protocol type', 'Staining method', 'Protocol origin', and 'Preferred status'.

Protocol name	Protocol type	Description	Modified by	Mod. date	Pref.
*IHC Protocol F	IHC staining	BOND Polymer DAB System for IHC	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol G	IHC staining	Bond Polymer AP Red IHC protocol	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol H	IHC staining	Bond Oracle IHC System protocol	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol J	IHC staining	BOND Polymer AP RED System for IHC	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol K	IHC staining	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol K - 50 Test	IHC staining	ChromoPlex 1 Dual IHC protocol	Leica	8/27/2020	✓
*IHC Protocol Q	IHC staining	BOND Polymer DAB System with altered Px on IHC	Leica	8/27/2020	✓
*FISH Protocol A	ISH detection	FISH System protocol - 30 Test	Leica	8/27/2020	✓
*FISH Protocol C	ISH detection	FISH wash protocol	Leica	8/27/2020	✓
*FISH Protocol D	ISH detection	FISH wash protocol (DS9636 and DS9604)	Leica	8/27/2020	✓
*ISH Protocol A	ISH detection	BOND Polymer RNA ISH Protocol	Leica	8/27/2020	✓
*ISH Protocol B	ISH detection	BOND Polymer DNA ISH Protocol	Leica	8/27/2020	✓

Filter options at the bottom:

- Protocol group: Staining
- Protocol type: All
- Staining method: All
- Protocol origin: All
- Preferred status: Preferred

Obrazovka **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) obsahuje tabuľku, v ktorej sú uvedené jednotlivé protokoly spolu s niektorými základnými údajmi. Preddefinované protokoly majú uvedenú hviezdičku (*) ako prvý znak v názve a skrátený názov.

Z tejto tabuľky môžete vybrať protokol pre operácie, ako je kopírovanie, úpravy a generovanie správ. K týmto operáciám sa dostanete cez tlačidlá nad tabuľkou alebo pravým tlačidlom myši.

Filtre pod tabuľkou umožňujú nastaviť typ protokolu, ktorý sa má zobraziť. Môžete si vybrať medzi protokolmi farbenia a predbežného farbenia a ďalej ich upravovať tak, aby zobrazovali konkrétne typy protokolov (pozrite si časť [7.1 Typy protokolov](#)). Okrem toho môžete filtrovať metódu farbenia, pôvod protokolu a preferovaný stav.

Informácie v zozname protokolov sú popísané nižšie:

Názov	Opis	Možnosti
Protocol name (Názov protokolu)	Úplný názov protokolu.	Preddefinované (Leica Biosystems) protokoly vždy začínajú hviezdičkou (*).
Protocol type (Typ protokolu)	Opisuje funkciu protokolu.	Pozrite si časť 7.1 Typy protokolov .
Opis	Popisuje funkciu a aplikáciu protokolu.	
Modified by (Upravil)	Označuje, kto protokol vytvoril alebo naposledy upravil.	Leica označuje preddefinovaný protokol Leica Biosystems.
Mod. date (Dátum úpravy)	Dátum vytvorenia alebo poslednej úpravy protokolu.	
Pref.	Zobrazuje preferovaný stav protokolu.	<p>Začiarknuté – toto je preferovaný protokol, ktorý je k dispozícii na výber v dialógovom okne Add Reagent (Pridať reagensiu) a Add slide (Pridať sklíčko).</p> <p>Nie je začiarknuté – toto nie je preferovaný protokol a nie je k dispozícii na výber v dialógovom okne Add Reagent (Pridať reagensiu) a Add slide (Pridať sklíčko).</p>

7.2.1 Podrobnosti protokolu

Ak chcete otvoriť protokol uvedený v zozname na obrazovke **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) na zobrazenie alebo upravenie, dvakrát naň kliknite (alebo ho označte a potom kliknite na položku **Open** (Otvoriť)). Softvér zobrazí dialógové okno **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu) s podrobnosťami protokolu.

Pre preddefinované protokoly spoločnosti Leica Biosystems je možné upravovať iba preferované nastavenia, ale ostatné nastavenia je možné zmeniť pre používateľské protokoly.

Obrázok 7-2: Dialógové okno **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu) pre používateľský protokol

Edit protocol properties

Name: IHC Protocol F
 Abbreviated name: IHC F
 Description: BOND Polymer DAB System for IHC

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME [Import protocol](#) Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*MARKER	Leica Microsystems		28	15:00
4		*Post Primary	Leica Microsystems	✓		8:00
7		*Peroxide Block	Leica Microsystems	✓		3:00
10		*Polymer	Leica Microsystems	✓		8:00
14		*Mixed DAB - PRIME	Leica Microsystems	✓		5:00
15		*Mixed DAB - PRIME	Leica Microsystems	✓		5:00
18		*BOND-PRIME Hematoxylin	Leica Microsystems	✓		4:00

Show wash steps [Insert segment](#) | [Duplicate](#) | [Delete segment](#)

[Save](#) [Cancel](#)

Dialógové okno zobrazí kartu pre každý typ modulu spracovania (BOND-MAX, BOND-III a BOND-PRIME). Ak nie sú uvedené do prevádzky žiadne moduly spracovania, zobrazia sa len BOND-MAX a BOND-III. Na zobrazenie karty musíte uviesť aspoň jeden modul spracovania BOND-PRIME do prevádzky.

K dispozícii je tiež tlačidlo **Import protocol** (Importovať protokol), ktoré sa objaví pri vytváraní nového protokolu alebo pri úprave používateľského protokolu. Pozrite si časť [7.4.4 Viaceré typy modulov spracovania a verzie protokolov](#) pre viac informácií.

Vyberte položku **Show wash steps** (Zobraziť kroky premývania) pod tabuľkou a zobrazíte všetky kroky protokolu (vrátane krokov premývania). Zrušte výber, ak chcete skryť kroky premývania.

V dialógovom okne **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu) sa zobrazia nasledujúce informácie o protokole.

Názov	Celý názov protokolu.
Abbreviated name (Skrátený názov)	Skrátený názov protokolu, používaný napríklad na štítkoch sklíčok.
Opis	Stručné vyhlásenie opisujúce protokol.

Staining method (Metóda farbenia)	(Pozrite nižšie)
Protocol type (Typ protokolu)	Typ označuje funkciu protokolu a určuje prípustné kroky a reagentie.
Preferred detection system (Preferovaný detekčný systém)	Preferovaný detekčný systém pre tento protokol. Toto nastavenie sa nevzťahuje na protokoly predbežného farbenia.

Tabuľka pod informáciami o protokole v tomto dialógovom okne obsahuje zoznam jednotlivých krokov protokolu a jeho vlastností (pozrite si **Obrázok 7-2**). Upraviteľné kroky v používateľských protokoloch sú upravené v tejto tabuľke (pozrite si časť **7.4 Úpravy používateľských protokolov**).

V tabuľke sú uvedené nasledujúce podrobnosti:

Položka	Opis
Step No. (Krok č.)	Poradie, v ktorom sa vykonajú kroky protokolu.
Wash (Premývanie)	Začiarknuté, ak je daný krok krokom premývania.
Reagent (Reagencia)	Reagencia použitá v danom kroku.
Supplier (Dodávateľ)	Dodávateľ reagentie. Toto pole nie je možné upravovať.
Ambient (Okolité teplota)	Začiarknuté, ak je daný krok pri okolitej teplote.
Temperature (Teplota)	Zvolená teplota sklíčka, ak je iná ako okolité teplota (iba protokoly predbežného farbenia).
Inc. (min)	Minimálna doba, po ktorú zostane reagencia na sklíčku.

Metóda farbenia

Protokoly farbenia obsahujú časť „metóda farbenia“. Protokoly jednoduchého a sekvenčného multiplexového farbenia obsahujú nasledujúce možnosti:

- **Single** (Jednoduché) – protokol je určený pre jednoduché farbenia
- **Preliminary** (Predbežné) – prvý protokol sekvenčného multiplexového farbenia
- **Final** (Posledné) – posledný protokol sekvenčného multiplexového farbenia

Protokoly paralelného multiplexového farbenia majú iba jednu možnosť metódy farbenia: **Parallel Multiplex** (Paralelné multiplexové).

Pozrite si časť **7.1.1 Režimy farbenia** pre viac informácií o metódach farbenia.

Preferovaný stav

V dialógovom okne **Add Reagent** (Pridať reagensiu) a **Add slide** (Pridať sklíčko) sú k dispozícii na výber iba preferované protokoly, preto by sa mali uprednostňovať protokoly, ktoré chcete použiť. Na vykonanie tejto činnosti zvolíte začiarkávacie políčko **Preferred** (Preferované). Zrušte výber, ak nechcete nastaviť ako preferované.

7.3 Vytvorenie nových protokolov

Nové protokoly môžete vytvoriť kopírovaním existujúceho používateľa alebo protokolov Leica Biosystems. Keď kopírujete protokol, typ protokolu zostáva nezmenený a neskôr ho už nie je možné zmeniť. Ak teda chcete vytvoriť nový protokol IHC, musíte skopírovať existujúci protokol IHC. Pre protokol HIER skopírujte existujúci protokol HIER atď.

Ak chcete skopírovať protokol, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) a kliknite na tlačidlo **Copy** (Kopírovať). Kópia zvoleného protokolu sa teraz objaví v dialógovom okne **New protocol properties** (Vlastnosti nového protokolu) pripravená na úpravu.

Nový protokol bude vyžadovať jedinečný názov a skrátený názov, ktorý musí spĺňať všetky pravidlá uvedené v časti **7.4.3 Pravidlá protokolu**. Okrem zmeny názvu protokolu a skráteného názvu nemusíte meniť žiadnu inú časť vášho nového protokolu. Môžete samozrejme zmeniť ľubovoľný aspekt protokolu, ako je to opísané v časti **7.4 Úpravy používateľských protokolov**.

Po úprave systému BOND-III alebo BOND-MAX kliknite na položku **Save** (Uložiť). Ak protokol vyhovuje pravidlám, zobrazí sa výzva na potvrdenie toho, že protokol vytvárate na svoje vlastné riziko. Táto správa pripomína, spoločnosť Leica Biosystems nemôže predpovedať kvalitu výsledkov žiadneho protokolu vytvoreného alebo upraveného používateľom. Po potvrdení, že chcete pokračovať, sa zmeny protokolu uložia.

Informácie o systéme BOND-PRIME nájdete v časti **Špecifické pravidlá protokolu BOND-PRIME**.



Všetky protokoly musí pred použitím overiť vaše laboratórium.

7.4 Úpravy používateľských protokolov

Používateľské protokoly môžete meniť (ale nie protokoly spoločnosti Leica Biosystems) v dialógovom okne **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu). Ak chcete upraviť protokol, označte ho v zozname v okne **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) a kliknite na položku **Open** (Otvoriť) (alebo dvakrát kliknite na protokol). Prípadne nakonfigurujte nový protokol skopírovaním existujúceho protokolu rovnakého typu a jeho úpravou (pozrite si časť [7.3 Vytvorenie nových protokolov](#)).

V protokoloch farbenia je možné pridať a odstrániť kroky reagensí a nastaviť nové reagensie a časy inkubácie. Je možné pridať alebo odstrániť ďalšie kroky premývania.

V prípade protokolov *zahrievania a odvoskovania môžete zmeniť iba čas a teplotu kroku zahrievania. Pre iné protokoly predfarbenia (HIER (teplom indukované získavanie epitopov), enzým) je možné pre niektoré kroky zmeniť teploty a časy inkubácie. Pozrite si časť [7.4.3 Pravidlá protokolu](#), kde je uvedený zoznam povolených úprav.

Keďže po dávkovaní novej reagensie musia nasledovať kroky premývania, vloženie nového kroku reagensie do protokolu farbenia automaticky pridá „segment“ protokolu, ktorý pozostáva z kroku reagensie a nasledujúcich troch krokov premývania (BOND-III a BOND-MAX) alebo dvoch krokov premývania (BOND-PRIME).

Keď upravujete protokol, zmenené alebo nové kroky, ktoré obsahujú všetky požadované informácie, majú na ľavej strane zelený pruh. Kroky, ktoré vyžadujú ďalšie informácie, majú červený pruh.

Počas úprav môžete zobrazíť všetky kroky protokolu alebo skryť kroky premývania pomocou tlačidla voľby **Show wash steps** (Zobraziť kroky premývania) pod tabuľkou.



Možnosť vytvoriť a uložiť protokol neznamena, že je vhodný pre zamýšľanú úlohu. Zodpovednosť za testovanie a overenie všetkých protokolov, ktoré vytvoríte alebo upravíte, preberáte vy.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

- [7.4.1 Úpravy krokov protokolu](#)
- [7.4.2 Pridanie a odstránenie krokov protokolu](#)
- [7.4.3 Pravidlá protokolu](#)
- [7.4.4 Viaceré typy modulov spracovania a verzie protokolov](#)
- [7.4.5 Odstraňovanie protokolov](#)

7.4.1 Úpravy krokov protokolu

Postupujte podľa pokynov nižšie a nakonfigurujte nový protokol v dialógovom okne **New protocol properties** (Vlastnosti nového protokolu) alebo upravte existujúci protokol v dialógovom okne **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu). Pozrite si časť [7.4.3 Pravidlá protokolu](#), aby ste zabezpečili vytvorenie platného protokolu.

Pri každom uložení protokolu sa kópia uloží do systému. Pri vytváraní správy protokolu (pozrite si časť [7.5 Správa protokolu](#)) musíte zvoliť dátum, kedy bol protokol aktívny. Na to, aby ste sa vyhli viacerým, redundantným verziám protokolov, protokoly ukladajte až po dokončení konfigurácie.

- 1 Pre nové protokoly zadajte názov protokolu a skrátенý názov.
- 2 Voliteľne zadajte popis protokolu.
- 3 Nastavte metódu farbenia v protokoloch farbenia (pozrite si časť [7.1.1 Režimy farbenia](#)).
- 4 Nastavte stav protokolu **Preferred** (Preferované) (pozrite si časť [Preferovaný stav](#)).
- 5 Pre protokoly farbenia vyberte detekčný systém na použitie s protokolom z rozbaľovacieho zoznamu **Preferred detection system** (Preferovaný detekčný systém).
- 6 Pridajte alebo odstráňte kroky protokolu (pozrite si časť [7.4.2 Pridanie a odstránenie krokov protokolu](#)), kým nemáte požadovaný počet krokov pre protokol.
- 7 Len v prípade systémov BOND-MAX a BOND-III zmeňte upraviteľné parametre v nových a existujúcich krokoch protokolu tak, že dvakrát kliknete na parameter, ktorý chcete zmeniť:
 - a V prípade systémov BOND-MAX a BOND-III v rozbaľovacom zozname zvolte reagentiu.
 - b V prípade systému BOND-PRIME si pozrite pravidlá v časti [7.4.2.1 Segmenty reagentií](#).
 - c **Poznámka:** Vyberte položku *MARKER (Značkovač) na označenie kroku, v ktorom sa primárna protilátka používa v protokoloch IHC. Na premývacie kroky sa môže použiť premývací roztok *BOND Wash Solution alebo deionizovaná voda *Deionized Water.
 - d Nastavte čas inkubácie v minútach a sekundách (mm:ss). Toto je minimálny čas, počas ktorého sklíčko čaká pred nasledujúcim krokom. Pozrite krok v časti [7.4.3 Pravidlá protokolu](#) pre limity času inkubácie.
 - e Vo všeobecnosti:
 - V prípade krokov aplikácie reagentie so systémami BOND-MAX a BOND-III spoločnosť Leica Biosystems neodporúča časy inkubácie dlhšie ako 30 minút. Ak je potrebné dlhšie trvanie, vytvorte duplicitné kroky na dávkovanie tej istej reagentie (pozrite si časť [7.4.2.2 Duplikované kroky reagentií](#)). Toto nastavenie sa nevzťahuje na protokoly BOND-PRIME.
 - v prípade krokov aplikácie reagentie so systémami BOND-PRIME spoločnosť Leica Biosystems neodporúča časy inkubácie dlhšie ako 20 minút pre kroky predprípravy so zahrievaním. Minimálne časy inkubácie nájdete v časti [Špecifické pravidlá protokolu BOND-PRIME](#).
 - f Vo všeobecnosti platí, že v prípade krokov aplikácie reagentie spoločnosť Leica Biosystems neodporúča časy inkubácie dlhšie ako 30 minút. Ak je potrebné dlhšie trvanie, vytvorte duplicitné kroky na dávkovanie tej istej reagentie (pozrite si časť [7.4.2.2 Duplikované kroky reagentií](#)).
 - g Vo všeobecnosti platí, že v prípade krokov aplikácie reagentie spoločnosť Leica Biosystems neodporúča časy inkubácie dlhšie ako 30 minút.

h Nastavte teplotu (pre niektoré kroky v protokoloch predbežného farbenia):

Ak chcete nastaviť teplotu, ktorá nie je okolitá, najskôr zrušte začiarknutie parametra **Ambient** (Okolité teplota). Potom vyberte prázdny parameter **Temperature** (Teplota) a zadajte teplotu v stupňoch Celzia ako celé číslo.

Ak chcete zmeniť teplotu na okolitú teplotu, vyberte a potom začiarknite parameter **Ambient** (Okolité teplota).

Pozrite si krok v časti **7.4.3 Pravidlá protokolu** pre prípustné teplotné rozsahy.

i Kliknutím na akýkoľvek ďalší krok potvrdíte zmenené parametre.

7.4.2 Pridanie a odstránenie krokov protokolu

Kroky môžete pridať a odstrániť v používateľských protokoloch IHC a ISH, ale nie v protokoloch predbežného farbenia. Kroky pridáte alebo odstránite pomocou tlačidiel pod tabuľkou krokov protokolu. Tlačidlá sa prispôbujú aktuálnemu kontextu a ich dostupnosť a funkcie sa líšia v závislosti od zvoleného kroku.

Podrobné pokyny nájdete v nasledujúcich častiach:

- [7.4.2.1 Segmenty reagensí](#)
- [7.4.2.2 Duplikované kroky reagensí](#)
- [7.4.2.3 Kroky premývania](#)

7.4.2.1 Segmenty reagensí

Pridanie nového segmentu reagensie (krok reagensie a tri povinné kroky premývania (BOND-III a BOND-MAX) alebo dva povinné kroky premývania (BOND-PRIME)):

- 1 Vyberte reagensiu a kliknite na položku **Insert segment** (Vložiť segment). Nový segment sa vloží nad túto reagensiu.



Ak vyberiete poslednú reagensiu, môžete zvoliť vloženie nového segmentu pod reagensiu.

New protocol properties

Name: IHC Protocol H - 1
 Abbreviated name: IHC H1
 Description: Bond Oracle IHC System protocol

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

BOND-MAX BOND-III [Import protocol](#) Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*Peroxide Block	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		5.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
5		*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		30.00
6	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
8	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
9		*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		30.00

Show wash steps [Insert segment](#) [Duplicate](#) [Delete segment](#)

[Save](#) [Cancel](#)

V zozname sa objaví nový segment (s krokmi reagentie a premývania). Kroky premývania majú zelené pruhy, ktoré označujú zmenu oproti uloženému protokolu. Krok reagentie má červený pruh, ktorý označuje, že pre krok musíte vybrať reagentiu.

New protocol properties

Name: IHC Protocol H - 1
 Abbreviated name: IHC H1
 Description: Bond Oracle IHC System protocol

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

BOND-MAX BOND-III [Import protocol](#) Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: Bond Oracle HER2 IHC System

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
3	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
5		*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		10.00
6	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
8	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
9		*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		30.00
10	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
11	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00

Show wash steps [Insert segment](#) [Duplicate](#) [Delete segment](#)


[Save](#) [Cancel](#)

- Kliknite na prázdny parameter **Reagent** (Reagentia) a vyberte požadovanú reagentiu z rozbaľovacieho zoznamu.

Podľa potreby upravte ďalšie parametre novej reagentie a kroky premývania.

3 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).

Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.

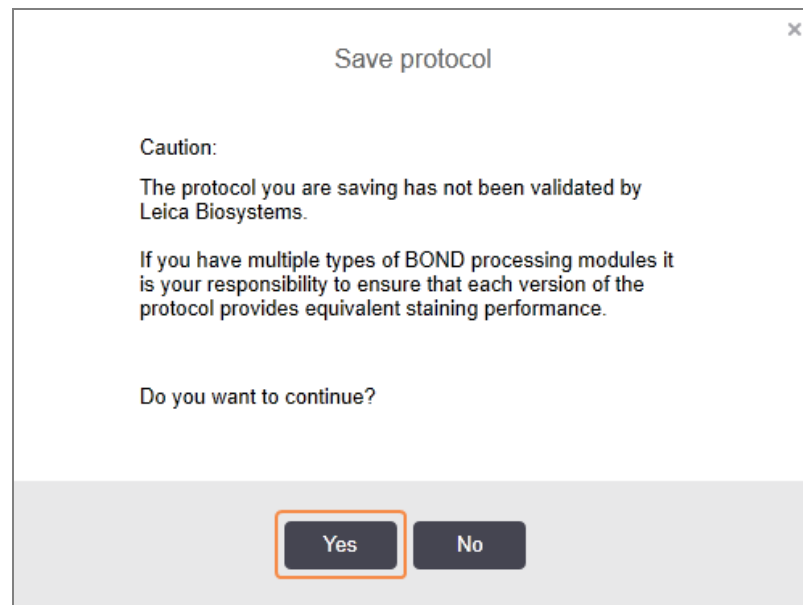

4 Kliknite na možnosť **Yes** (Áno).

Ak chcete odstrániť segment, vyberte reagenčiu a kliknite na položku **Delete segment** (Odstrániť segment). Ak chcete odstrániť segment s duplikovanou reageniou, najskôr odstráňte duplikáciu.

Pre najlepšie výsledky farbenia v systéme BOND-PRIME:

- NEVYMAZÁVAJTE chromogénový segment
- NEPREMENUJTE segment reagenzie
- NESEKVENUJTE peroxidový blok za polymérom.

7.4.2.2 Duplikované kroky reagensí

Duplikovaný krok je taký, v ktorom dve alebo viac identických reagensí nasledujú po sebe bez toho, aby medzi nimi boli premývacie kroky.

- 1 V zozname krokov vyberte krok reagensie, ktorý chcete duplikovať.

Kliknite na položku **Duplicate** (Duplikovať).

Edit protocol properties

Name:

Abbreviated name:

Description:

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

[Import protocol](#) **Protocol type: IHC staining**

Preferred detection system:

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*Peroxide Block	Leica Microsystems	✓		5:00
2	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
3	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
4	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
5		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10:00
6	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
7	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
8	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
9		*MARKER	Leica Microsystems	✓		20:00

Show wash steps [Insert segment](#) | [Duplicate](#) | [Delete segment](#)

- 2 Nad aktuálny krok sa pridá nový krok s rovnakými parametrami ako v aktuálnom kroku.

Nový krok má zelený pruh, ktorý označuje zmenu oproti uloženému protokolu.

Edit protocol properties


Name:

Abbreviated name:

Description:

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

[Import protocol](#) Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: 

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*Peroxide Block	Leica Microsystems	✓		5:00
2	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
3	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
4	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
5		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10:00
6		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10:00
7	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
8	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00
9	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0:00

Show wash steps [Insert segment](#) | [Duplicate](#) | [Delete duplicate](#)


- 3 Ak je to potrebné, upravte čas inkubácie pre nový krok.



Ak zmeníte typ reagentie duplikovaného kroku, zmenia sa aj všetky ďalšie kroky reagentie v sekvencii, pretože duplikované kroky musia používať rovnakú reagentiu.

4 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).

Zobrazí sa okno s potvrdením.

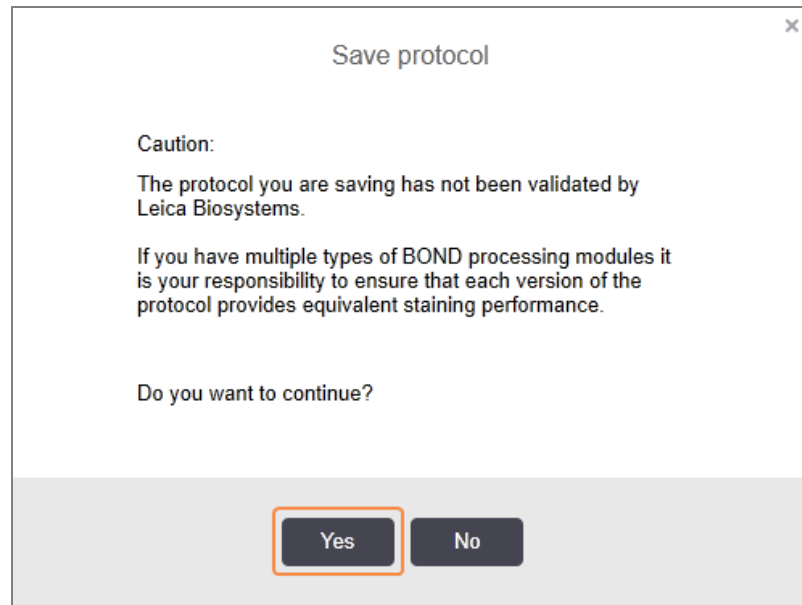

5 Kliknite na možnosť **Yes** (Áno).

Ak chcete duplikovaný krok odstrániť, vyberte ho a kliknite na tlačidlo **Delete duplicate** (Odstrániť duplikáciu).

7.4.2.3 Kroky premývania

Pridanie krokov premývania môže zmeniť vlastnosti fluidík na sklíčkach a viesť k zlému farbeniu. Pred diagnostickým použitím vždy overte nové alebo upravené protokoly.

Odporúča sa, aby sa pred krokom s chromogénom alebo hematoxylínom a po ňom nachádzal krok premývania deionizovanou vodou.



Ak nevidíte kroky premývania, zvolte tlačidlo voľby **Show wash steps** (Zobraziť kroky premývania) pod časťou so zoznamom krokov.

Vloženie ďalšieho kroku premývania:

- 1 Zo zoznamu krokov vyberte existujúci krok premývania (protokoly ISH a IHC).
- 2 Kliknite na položku **Insert wash** (Vložiť premývanie).

Dialog box "Edit protocol properties" showing protocol details and a table of wash steps. The "Wash" column in the table has a green bar next to step 9, and the "Insert wash" button is highlighted with an orange box.

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
3	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
4	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
5		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10.00
6		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10.00
7	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
8	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
9	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
10		*MARKER	Leica Microsystems	✓		30.00
11	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00

Pre protokoly ISH aj IHC sa na konci aktuálnej premývacej sekvencie pridá nový krok premývania. Nový krok premývania má zelený pruh, ktorý označuje zmenu oproti uloženému protokolu.

Dialog box "Edit protocol properties" showing protocol details and a table of wash steps. The "Wash" column in the table has a green bar next to step 10, and the "Insert wash" button is highlighted with an orange box.

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
4	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
5		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10.00
6		*MARKER	Leica Microsystems	✓		10.00
7	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
8	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
9	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
10	✓	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	✓		0.00
11		*MARKER	Leica Microsystems	✓		30.00

- 3 Podľa potreby upravte parametre kroku premývania v zozname krokov.

- 4 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).
- 5 V okne s potvrdením kliknite na možnosť **Yes** (Áno).

Ak chcete odstrániť krok premývania, vyberte ho a kliknite na položku **Delete wash** (Odstrániť premývanie). Pre protokoly ISH aj IHC môžete odstrániť iba kroky premývania, ktoré nasledujú po povinných krokoch v sekvencii premývania.

New protocol properties

Name:

Abbreviated name:

Description:

Staining method: Single Preliminary Final Preferred

Protocol type: IHC staining

Preferred detection system:

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
4	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
5	<input checked="" type="checkbox"/>	*MARKER	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		30:00
6	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
7	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
8	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
9	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		0:00
10	<input checked="" type="checkbox"/>	*Post Primary	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		10:00
11	<input checked="" type="checkbox"/>	*Bond Wash Solution	Leica Microsystems	<input checked="" type="checkbox"/>		2:00

Show wash steps

7.4.3 Pravidlá protokolu

Každý protokol, ktorý vytvoríte alebo upravíte, musí byť pred uložením v súlade s niektorými základnými pravidlami. Upozorňujeme, že tieto pravidlá nezaručujú, že protokol poskytne pri použití prijateľné výsledky.

- 1 Názov protokolu musí:
 - a byť jedinečný,
 - b začínať znakom iným ako medzera alebo hviezdička.
- 2 Skrátený názov protokolu musí:
 - a byť jedinečný,
 - b začínať znakom iným ako medzera alebo hviezdička,
 - c obsahovať maximálne 8 znakov.
- 3 Všetky protokoly IHC musia obsahovať najmenej jeden krok pre značkovač.
- 4 Všetky protokoly farbenia musia obsahovať aspoň jednu reagensiu z detekčného systému Leica Biosystems.

- 5 Po krokoch reagencie musia nasledovať buď tri kroky premývania (najmenej) /pre systém BOND-III a BOND-MAX alebo dva kroky premývania (najmenej) pre systém BOND-PRIME) alebo rovnaká reagencia.
- 6 V prípade protokolov farbenia musia byť posledné tri kroky premývacie.
- 7 V prípade protokolov farbenia IHC musia mať všetky kroky teplotu okolitého prostredia.
- 8 V prípade protokolov predbežného farbenia musia byť teploty v kroku zahrievania v rozmedzí podľa nasledujúcej tabuľky:

Krok protokolu	Teplotný rozsah (°C)
Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania	35 – 72
Predpríprava zahrievaním (BOND-III a BOND-MAX)	35 – 100
Predpríprava zahrievaním (BOND-PRIME)	35 – 104
Predpríprava enzýmu	35 – 100
Denaturácia	70 – 100
Hybridizácia	37 – 65

- 9 Inkubačné doby v krokoch, ktoré musia byť stanovené v minútach a sekundách (mm:ss), by mali byť v rozmedzí podľa nasledujúcej tabuľky. Rozmedzia nie sú vynútiteľné:

Krok protokolu	Inkubačný rozsah (minúty)
Zahrievanie a odvoskovanie, krok zahrievania	0 – 60
Predpríprava zahrievaním (kroky v okolitej teplote)	0 – 15
Predpríprava zahrievaním (kroky so zahrievaním BOND-III a BOND-MAX)	5 – 60
Predpríprava zahrievaním (kroky so zahrievaním BOND-PRIME)	2 – 20
Predpríprava enzýmu (krok 1)	0
Predpríprava enzýmu (kroky pre enzým)	0 – 15
Denaturácia	5 – 20
Hybridizácia	20 – 950
Protokoly farbenia, kroky pre reagencie	0 – 60
Protokoly farbenia, kroky premývania	0 – 55

- 10 Každý krok musí byť úplne definovaný reagentiou, časom inkubácie a (v prípade potreby) teplotou.

- 11 Protokoly s jednoduchým a sekvenčným multiplexovým farbením môžu mať iba jednu zmiešanú reagensiu (napr. zmiešané DAB) na protokol, použitú v protokole maximálne v dvoch krokoch. Postup sekvenčného multiplexového farbenia môže mať dve zmiešané reagensie, jednu v každom protokole, a až štyri aplikačné kroky, dva v každom protokole.

Protokoly paralelného multiplexového farbenia môžu obsahovať dve zmiešané reagensie a každá zmiešaná reagensia môže byť v protokole použitá až dvakrát.

- 12 Všetky zložky potrebné na vytvorenie zmiešanej reagensie (reagencií) protokolu farbenia musia pochádzať z preferovaného systému detekcie protokolu.

Špecifické pravidlá protokolu BOND-PRIME

Získavanie tepla

Krok v rámci používateľom upraveného protokolu BOND-PRIME HIER nemôže prekročiť čas inkubácie 20 minút. Ak chcete vytvoriť dlhší protokol, použite existujúci protokol HIER, napr. *HIER 40 min s ER2, alebo upravte dlhší protokol, aby ste ho skrátili na požadovaný čas inkubácie. Ak chcete napríklad vytvoriť 25-minútový protokol ER2 HIER:

- 1 Skopírujte *HIER 30 min. s ER2.

New protocol properties

Name:

Abbreviated name:

Description:

Preferred

BOND-III BOND-PRIME [Import protocol](#) Protocol type: Heat pretreatment

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems	✓		0:00
2		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems		104	20:00
3		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems		104	10:00

Show wash steps

- 2 Upravte druhý krok zahrievania z 10 minút na 5 minút a potom kliknite na položku **Save** (Uložiť).

New protocol properties

Name:

Abbreviated name:

Description:

Preferred

BOND-III **BOND-PRIME** Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)
1		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems	✓		0:00
2		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems		104	20:00
3		*Bond ER Solution 2	Leica Microsystems		104	5:00

Show wash steps

Farbenie

Každý krok reagencie má minimálny čas inkubácie, počas ktorého by bol protokol prijatý na module spracovania. V nasledujúcej tabuľke je uvedený minimálny čas inkubácie pre prijateľný protokol na BOND-PRIME.

Tabuľka 7-1: Minimálny čas inkubácie prijatý na systéme BOND-PRIME pre protokoly *IHC F a *IHC J

*Protokol IHC F		*Protokol IHC J	
Krok	Minimálny čas inkubácie (min.)	Krok	Minimálny čas inkubácie (min.)
Marker (Značkovač)	9:00	Marker (Značkovač)	9:00
Po primárnej	5:00	Po primárnej AP	11:00
Peroxidový blok	–	Polymér AP	16:00
Polymér	5:00	Zmiešané RED-PRIME	2:00
Zmiešané DAB-PRIME	2:00	Zmiešané RED-PRIME	2:00
Zmiešané DAB-PRIME	2:00	BOND-PRIME Hematoxylín	–
BOND-PRIME Hematoxylín	3:00		

Ak nastavíte krok protokolu BOND-PRIME na čas kratší, ako je čas uvedený vyššie, riadiace zariadenie BOND vám umožní protokol uložiť. Keď sa však sklíčko vloží do zásuvky na predbežné vloženie v module spracovania, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

„Unable to process slide. Invalid protocol definition. Remove the slide from the Preload Drawer then check the protocol. If the problem persists, contact Customer Support (29012)“ (Sklíčko nie je možné spracovať. Neplatná definícia protokolu. Vyberte sklíčko zo zásuvky na predbežné vloženie a potom skontrolujte protokol. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory (29012)).

Ak sa sklíčka momentálne spracúvajú v moduloch ARC, pred reštartovaním modulu spracovania ich nechajte dokončiť.

7.4.4 Viaceré typy modulov spracovania a verzie protokolov

Pre systémy BOND s modulmi spracovania BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME môže mať každý protokol samostatné verzie pre tri typy modulov spracovania.

Protokoly Leica Biosystems boli testované a optimalizované na použitie v systémoch BOND. Tieto protokoly boli dôkladne testované a validované spoločnosťou Leica Biosystems.

Rôzne verzie „rovnakého“ protokolu zodpovedajú rozdielom v hardvéri, ako napríklad:

- rýchlejšie chladenie na moduloch spracovania BOND-III (kroky protokolu, pri ktorých sa sklíčka ochladia, sú zvyčajne kratšie vo verziách protokolu BOND-III ako zodpovedajúce kroky vo verziách BOND-MAX)
- nová základná technológia modulov aktívnej kontroly reagencií (ARC) v prípade systému BOND-PRIME.

Niektoré rozdiely vo verzii protokolu nie je možné vidieť v zozname krokov zobrazenom v softvéri, napr. protokolové verzie BOND-III obsahujú skryté pokyny pre roboty na nebalenú tekutinu, ktoré sú neprítomné na moduloch spracovania BOND-MAX.

Všetky systémy BOND majú verzie BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME všetkých preddefinovaných protokolov.

Ak sa však do systému pridá nový typ modulu spracovania, musíte pre tento nový typ modulu spracovania vytvoriť novú verziu existujúcich protokolov definovaných používateľom. Urobte to importovaním preddefinovaných protokolov Leica Biosystems a potom skopírujte alebo upravte kroky podľa potreby (pozrite si časť [7.4.4.1 Import verzie protokolu](#)).



Ak v prípade systému BOND-PRIME vaše laboratórium vyžaduje ďalšiu úpravu preddefinovaných protokolov Leica Biosystems (napr. *IHC F alebo *IHC J), **musíte**:


- importovať/skopírovať preddefinovaný protokol do aktuálneho protokolu laboratória. Pozrite si časť [7.4.4.1 Import verzie protokolu](#).
- Dodržiavajte minimálne časy inkubácie uvedené v časti [Tabuľka 7-1 Minimálny čas inkubácie prijatý na systéme BOND-PRIME pre protokoly *IHC F a *IHC J](#).
- Postupujte podľa postupnosti farbenia BOND-PRIME, pretože bola optimalizovaná na použitie v systéme BOND-PRIME. Pozrite si časť [7.1.2 Sekvencie protokolu](#).

7.4.4.1 Import verzie protokolu

Ak chcete vytvoriť verziu protokolu pre nový typ modulu spracovania, postupujte podľa pokynov nižšie. Túto metódu možno tiež použiť na prepísanie existujúcich verzií protokolu, toto však zvyčajne nie je potrebné po počiatkovej konfigurácii.

Protokoly je možné preniesť iba do rovnakých typov modulov spracovania, napríklad z BOND-III do BOND-III a z BOND-PRIME do BOND-PRIME.

- 1 V okne **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) vyberte používateľský protokol, pre ktorý chcete vytvoriť novú verziu.
- 2 Kliknite na položku **Open** (Otvoriť).
Otvorí sa dialógové okno **Edit protocol properties** (Upraviť vlastnosti protokolu).
- 3 Kliknite na položku **Import protocol** (Importovať protokol).

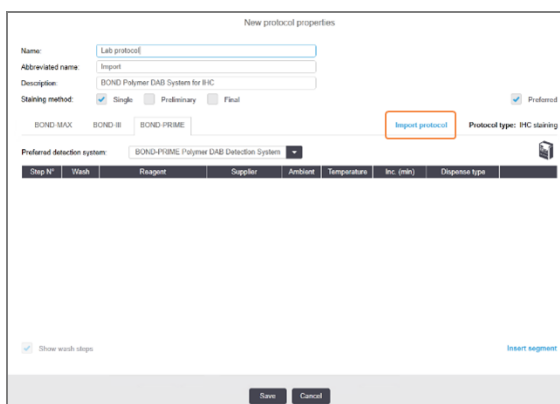


- 4 Otvorí sa dialógové okno **Import protocol** (Import protokolu).
- 5 V rozbaľovacom zozname **Processing modules** (Moduly spracovania) vyberte nový typ modulu spracovania.



Zoznam protokolov zobrazených v dialógovom okne sa aktualizuje tak, aby zobrazoval iba protokoly s verziami pre vybraný typ modulu spracovania.

- 6 Vyberte alebo zrušte výber **Preferred** (Preferované), aby sa zobrazovali iba preferované, prípadne všetky protokoly.

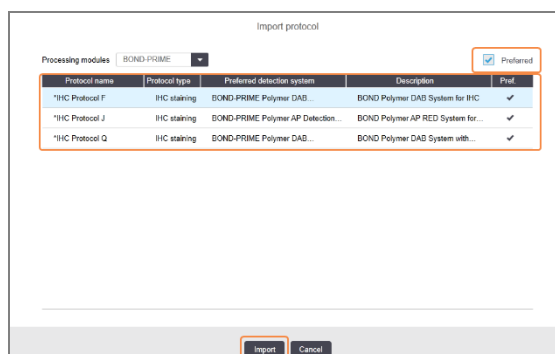

- 7 V zozname vyberte protokol na importovanie.



Osvedčené postupy pre protokoly:

- Ak je protokol pre systém BOND Polymer DAB pre imunohistochemický rozbor, vyberte *IHC F.
- Ak je protokol pre systém BOND Polymer AP Red pre imunohistochemický rozbor, vyberte *IHC J.
- Vyberte predvolený protokol pre požadovanú detekčnú súpravu

Na uľahčenie neskorších konfigurácií vyberte protokol, ktorý je čo najviac podobný protokolu, pre ktorý vytvárate novú verziu. Napríklad vyberte protokol, ktorý používa rovnaký detekčný systém a ak je to možné, má rovnaký počet krokov.

- 8 Kliknite na položku **Import** (Importovať).

Dialógové okno **Import protocol** (Import protokolu) sa zatvorí. Záložka v dialógovom okne **Edit protocol properties** (Upravenie vlastností protokolu) pre nový typ modulu spracovania je teraz doplnená importovanou verziou protokolu.

Step N°	Wash	Reagent	Supplier	Ambient	Temperature	Inc. (min)	Dispense type
1		*MARKER	Leica Microsystems	✓		15:00	Chamber Dispense
4		*Post Primary	Leica Microsystems	✓		8:00	Chamber Dispense
7		*Peroxide Block	Leica Microsystems	✓		3:00	Chamber Dispense
10		*Polymer	Leica Microsystems	✓		8:00	Chamber Dispense
14		*Mixed DAB - PRIME	Leica Microsystems	✓		5:00	Chamber Dispense
15		*Mixed DAB - PRIME	Leica Microsystems	✓		5:00	Chamber Dispense
18		*BOND-PRIME Hematoxylin	Leica Microsystems	✓		4:00	Chamber Dispense



Aktualizuje sa iba záložka pre vybraný typ modulu spracovania.

- 9 Upravte novú verziu protokolu podľa potreby (pozrite si časť **7.4.1 Úpravy krokov protokolu**). Medzi kartami modulov spracovania môžete prechádzať kliknutím bez straty údajov.
- 10 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).



Používateľ je zodpovedný za overenie, či protokoly poskytujú rovnocenné farbenie pre oba typy modulov spracovania.

7.4.5 Odstraňovanie protokolov

Ak chcete odstrániť protokol používateľa, vyberte ho zo zoznamu na obrazovke **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) a kliknite na tlačidlo **Delete** (Odstrániť).

Preddefinované protokoly Leica Biosystems (začínajúce hviezdíčkou) nie je možné odstrániť. Môžete ich však skryť – otvorte protokoly a zrušte výber **Preferred** (Preferované), potom nastavte filter **Preferred status** (Preferovaný stav) na obrazovke **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) na Preferred (Preferované).

7.5 Správy protokolu

Správy protokolov zobrazujú podrobnosti o krokoch pre vybrané protokoly. Ak chcete vygenerovať správu, vyberte protokol zo zoznamu v okne **Protocol setup** (Nastavenie protokolu) a kliknite na položku **Report** (Správa). Ak máte v systéme viac typov modulov spracovania vyberte typ modulu spracovania pre požadovanú verziu protokolu. Môžete si tiež zvoliť dátum, od ktorého sa má správa vygenerovať. Po dokončení kliknite na položku **Generate report** (Generovať správu).

Správa sa zobrazí v novom okne. V pravom hornom rohu správy sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
Full name (Úplný názov)	Celý názov protokolu.
ID (Identifikátor)	Jedinečné identifikačné číslo protokolu.
Type (Typ)	Typ protokolu (pozrite si časť 7.1 Typy protokolov).
Created by (Vytvoril)	Používateľské meno osoby, ktorá vytvorila zobrazenú verziu.
Creation time (Čas vytvorenia)	V prípade preddefinovaných protokolov dátum a čas importovania protokolu v aktualizácii BOND definície údajov (BDD). V prípade protokolov definovaných používateľom dátum a čas vytvorenia.
Facility (Zariadenie)	Názov zariadenia, ako je uvedené na obrazovke klienta správy Laboratory Settings (Laboratórne nastavenia) (pozrite si časť 10.5.1 Laboratórne nastavenia).
Staining status (Stav farbenia)	Úlohy, na ktoré je protokol vhodný, pokiaľ ide o multiplexové alebo jednoduché farbenie (pozrite si časť Metóda farbenia).

V texte správy sa pre každý krok zobrazujú nasledujúce položky:

- reagentia a dodávateľ,
- typ kroku (reagentia alebo premývanie),
- čas inkubácie,
- Temperature (Teplota)
- typ dávkovania (opisuje pozíciu krycieho sklíčka Covertile a objem dávkovania – môže si vyžadovať váš zástupca servisu spoločnosti).

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

7.6 Preddefinované protokoly

Nasledujúce časti popisujú preddefinované protokoly, ktoré sa dodávajú ako súčasť softvéru BOND.

Uvedené protokoly sa môžu zmeniť, ak sa aktualizujú pred ďalším vydaním softvéru. Zoznam uvedený nižšie je aktuálny v čase uverejnenia. Upozorňujeme tiež, že niektoré protokoly ešte nemusia byť k dispozícii na použitie v module spracovania BOND-PRIME.

- [7.6.1 Protokol farbenia](#)
- [7.6.2 Protokoly predbežného farbenia](#)

7.6.1 Protokol farbenia

Každý protokol farbenia je navrhnutý tak, aby používal konkrétny detekčný systém BOND.

Podrobné informácie o každom detekčnom systéme nájdete v sprievodnej dokumentácii ku každému produktu alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Leica Biosystems: www.leicabiosystems.com.

Tieto protokoly môžete použiť ako základné stavebné kamene pre svoje vlastné protokoly podľa vašich potrieb vďaka funkciám na úpravu protokolov (pozrite si časti [7.3 Vytvorenie nových protokolov](#) a [7.4 Úpravy používateľských protokolov](#)).

Niektoré z nižšie uvedených protokolov sú určené na použitie s detekčnými systémami, ktoré nemusia byť schválené regulačnými orgánmi vo vašom regióne. Tieto protokoly sa vo vašom softvéri nezobrazia.

7.6.1.1 IHC

Názov	Preferovaný detekčný systém	Poznámky k detekčnému systému
*IHC Protocol F	Bond Polymer Refine Detection	Detekčný systém s vysokou amplifikáciou bez biotínu optimalizovaný na použitie v systéme BOND. Poskytuje ostrú definíciu cieľových antigénov s vysokou intenzitou farbenia.
*IHC Protocol H	Bond™ Oracle™ HER2 IHC System POZNÁMKA: Dostupnosť podlieha schváleniu regulačnými orgánmi.	Kompletný detekčný systém HER2 pozostáva z primárnejprotilátky HER2 a negatívnej kontrolnej vzorky HER2 v spojení s vysoko citlivým detekčným systémom založeným na kompaktnom polyméri Compact Polymer. Systém obsahuje sklíčka s kontrolnými vzorkami špecifické pre profil HER2, ktoré umožňujú plne automatizovaný, konzistentný imunohistochemický profil HER2 až po kontrastné farbenie.
*IHC Protocol J	BOND Polymer Refine Red Detection	Na použitie in vitro, vysoko citlivý systém Compact Polymer, ktorý zaisťuje jasne červené imunofarbenie prostredníctvom alkalickéj fosfatázy, ako aj hematoxylínovú kontrastnú farbu (vrátane modrania).

Názov	Preferovaný detekčný systém	Poznámky k detekčnému systému
*IHC Protocol K	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (100 test)	Na použitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazaných myších a králičích IgG primárnych protilátok. Je určený na farbenie sekcií tkaniva fixovaného vo formalíne, zaliateho v parafíne v systéme BOND.
*IHC Protocol K – 50 Test	ChromoPlex™ 1 Dual Detection (50 test)	Na použitie in vitro, na detekciu tkanivovo viazaných myších a králičích IgG primárnych protilátok. Je určený na farbenie sekcií tkaniva fixovaného vo formalíne, zaliateho v parafíne v systéme BOND.
*IHC Protocol Q	Bond Polymer Refine Detection	Detekčný systém s vysokou amplifikáciou bez biotínu optimalizovaný na použitie v systéme BOND. Poskytuje ostrý obraz cieľových antigénov s protokolom farbenia s vysokou intenzitou špecifickým pre antigény citlivé na peroxid.

7.6.1.2 ISH

Názov	Preferovaný detekčný systém	Poznámky k detekčnému systému
*FISH Protocol A	Leica HER2 FISH System – 30 Test POZNÁMKA: Dostupnosť podlieha schváleniu regulačnými orgánmi.	Systém LSI HER2/CEP17 FISH s kompletnou duálnou sondou pozostávajúci z duálnej sondy RTU LSI HER2/CEP17 a premývacieho roztoku 2 po hybridizácii. Deteguje amplifikáciu génu HER2 pomocou FISH vo FFPE vzorkách tkanív rakoviny z ľudského prsníka. Na diagnostické použitie in vitro. POZNÁMKA: LSI a CEP sú ochranné známky spoločnosti Abbott Molecular Inc. Všetky práva vyhradené. Používa sa na základe licencie.
*ISH Protocol A	BOND Polymer Refine Detection	Detekčný systém s vysokou amplifikáciou bez biotínu optimalizovaný na použitie v systéme BOND. Deteguje RNA pomocou anti-FITC linkera.
*ISH Protocol B	BOND Polymer Refine Detection	Detekčný systém s vysokou amplifikáciou bez biotínu optimalizovaný na použitie v systéme BOND. Deteguje DNA pomocou anti-biotínového linkera.

7.6.2 Protokoly predbežného farbenia

Typ protokolu	Názov protokolu	Poznámky
Preparation (Príprava)	*Dewax	Protokoly prípravy používajú roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution na odstránenie parafínového vosku, ktorý sa používa na zabudovanie tkaniva a rehydratáciu vzorky.
	*Zahrievanie a odvoskovanie	Pred odvoskovaním sa tkanivo zahreje, aby sa zlepšila jeho adhézia na podložné sklíčko. Pre ďalšie podrobnosti si pozrite časť 14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie
Predbežná úprava teplom	*HIER s ER1 alebo ER2	Tepelne indukované získavanie epitopov vystavuje rezané tkanivo zahrievanému pufrovému roztoku, ktorý pomáha meniť konformáciu štruktúry tkaniva a zlepšuje farbenie. K dispozícii je množstvo preddefinovaných protokolov tepelnej predúpravy, ktoré sa líšia dĺžkou a použitými teplotami.
Predpríprava enzýmu	*Enzým 1 *Enzým 2 *Enzým 3 *Enzým 5	K dispozícii je osem protokolov predprípravy enzýmom. Tieto protokoly sa líšia použitým enzýmom a časmi inkubácie.
ISH Denaturácia	*Denaturácia (10 min)	Existuje jeden (10-minútový) preddefinovaný protokol denaturácie ISH.
ISH Hybridizácia	*Hybridizácia ISH (2 h) *Hybridizácia ISH (12 h)	Existujú dva preddefinované protokoly hybridizácie ISH (2 hodiny a 12 hodín).

8

Správa reagensíí (na riadiacom zariadení BOND)

Systém BOND uchováva záznamy o všetkých balených reagensiach použitých v systéme a sleduje každú nádobu na reagentie a jej obsah. Umožňuje tiež nastaviť panely sklíčok so zadanými značkovačmi, aby sa urýchlilo vytváranie prípadov.


Táto kapitola má nasledujúce časti:

- [8.1 Prehľad správy reagensíí](#)
- [8.2 Obrazovka nastavenia reagentie](#)
- [8.3 Obrazovka zásob reagensíí](#)
- [8.4 Obrazovka panela reagensíí](#)

8.1 Prehľad správy reagensí

Správa reagensí v systéme BOND zahŕňa nastavenie a údržbu jednotlivých detailov reagensí, správu zásob pre všetky balenia reagensí (s výnimkou nebalených reagensí) a vytváranie súprav značkovačov známych ako „panely“ na použitie pri vytváraní sklíčok.

Ak chcete otvoriť obrazovky správy reagensí, na ktorých sa vykonávajú tieto operácie, kliknite na ikonu **Reagent setup** (Nastavenie reagentie) na paneli funkcií.



(Požadovanú obrazovku otvoríte kliknutím na karty v ľavom hornom rohu obrazovky **Setup** (Nastavenie), **Inventory** (Zásoby) alebo **Panels**(Panely)).

Obrázok 8-1: Obrazovka nastavenia reagentie

Name	Abb. name	Type	Supplier	Pref.
*CD10 (56C6)	*CD10	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD15 (Carb-1)	*CD15	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD20 (MJ1)	*CD20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD25 (4C9)	*CD25	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD30 (1G12)	*CD30	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD5 (4C7)	*CD5	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD56 (CD564)	*CD56	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*CD7 (LP15) *NEW*	*CD7	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 20 (Ks20.8)	*CK20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 20 (PW31)	*CK20	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Cytokeratin 7 (RN7)	*CK7	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Estrogen Receptor (6F11)	*ER	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)	*GFAP	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin A (N1CLA)	*IgA	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin D (DRN1C)	*IgD	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Immunoglobulin G (Polyclonal)	*IgG	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Melan A (A103)	*MelA	Primary antibody	Leica Microsystems	✓
*Negative	*Neg	Primary antibody	Laboratory Specified	✓

Na obrazovke **Reagent setup** (Nastavenie reagentie) sa môže zobraziť kompletný zoznam všetkých reagensí známych pre systém BOND. Zoznam neobsahuje žiadne vopred balené systémy reagensí, napr. detekčné systémy BOND, ale zobrazuje základné reagentie v systémoch. Obsahuje tiež zmiešané reagentie, ktoré sa miešajú v module spracovania z komponentov v detekčných systémoch. Táto obrazovka sa používa na zobrazenie vlastností reagensí, vytvorenie nových reagensí v systéme a nastavenie možností reagensí.

Na obrazovke **Reagent inventory** (Zásoby reagensí) sa zas zobrazuje zoznam systémov reagensí a jednotlivo balených reagensí. V zozname pre všetky typy reagensí alebo systémov je uvedený celkový objem zásob spolu s informáciami o jednotlivých baleniach.

Obrazovka **Reagent panels** (Panely reagensí) umožňuje vytváranie súprav značkovačov, ktoré sa zvyčajne používajú pre konkrétne diagnózy. Počas vytvárania sklíčka v softvéri BOND sa výberom panela vytvorí sklíčko pre každý značkovač na paneli, čo výrazne urýchľuje tento proces.

8.1.1 Všeobecné informácie

- [8.1.1.1 Kategórie reagencií](#)
- [8.1.1.2 Pracovný tok reagencie](#)
- [8.1.1.3 Identifikácia reagencie](#)
- [8.1.1.4 Náhrada reagencie](#)
- [8.1.1.5 Systém HER2 IHC BOND™ Oracle™](#)

8.1.1.1 Kategórie reagencií



Systémy reagencií BOND sú určené len na použitie na moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX. Systémy reagencií BOND-PRIME sú určené len na použitie na moduloch spracovania BOND-PRIME.

Okrem nebalených tekutín sa v systéme BOND môžu používať štyri rôzne typy balenia tekutín:

- Detekčné systémy BOND: vopred zabalené podnosy detekčných reagencií na použitie v spojení so značkami vybranými používateľmi počas nastavovania sklíčok
- Systém HER2 IHC Bond Oracle: vopred zabalený podnos so značkovačom, pomocnými a detekčnými reagentami. Systém obsahuje kontrolné sklíčka.
- Čistiace systémy BOND pre moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX: vopred zabalené podnosy čistiacich roztokov na použitie pri čistení modulu spracovania (pozrite si [12.6.1 Čistenie nasávacej sondy](#)). Podrobnosti o používaní čistiacich systémov BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke pre BOND-PRIME.
- Nádoby na reagenty: jednotlivé nádoby na reagenty obsahujúce značkovače (primárne alebo sondové) alebo pomocné reagenty – v pripravených alebo otvorených nádobách (pozrite si časť [2.6.3 Systémy a nádoby na reagenty](#))

Detekčné systémy BOND vrátane systému HER2 IHC Bond Oracle a čistiace systémy sa súhrnne označujú ako „systémy reagencií“.

„Značkovač“ označuje primárnu protilátku v IHC alebo sondu v ISH (pozrite nižšie).

Reagenty sa delia na tieto „typy reagencií“:

- Primárne: značkovacia reagentia používaná v IHC
- Sonda: značkovacia reagentia používaná v ISH
- Pomocné reagenty: všetky neznačkovacie reagenty, ktoré sa používajú na spracovanie tkaniva pred zafarbením alebo po zafarbení značkovačom
- Zmiešané: pomocné reagenty vytvorené počas vykonávania protokolu zo zložiek v systéme reagencií alebo zo zložiek v jednotlivých nádobách. Zmiešané reagenty nikdy nemôžu byť v zásobách, musia však byť k dispozícii v systéme na zahrnutie do krokov protokolu.

Zoznamy reagencií a systémov reagencií na obrazovkách **Reagent Setup** (Nastavenie reagencie) a **Reagent Inventory** (Zásoby reagencie) je možné filtrovať podľa týchto klasifikácií.

8.1.1.2 Pracovný tok reagensie

Predtým, ako bude môcť systém BOND použiť akúkoľvek reagensiu, musí ju rozpoznať v trojkrokovom procese:

- 1 Typ reagensie musí byť zahrnutý do zoznamu reagensí na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagensí) – všetky hotové reagensie Leica Biosystems a mnoho pomocných reagensí Leica Biosystems (vrátane reagensí v detekčných a čistiacich systémoch BOND) je vopred definovaných, ale ďalšie reagensie musia do zoznamu pridať používateľia.
- 2 Po prijatí novej zásoby sa jednotlivé nádoby na reagensie a systémy reagensí naskenujú do systému BOND alebo „zaregistrujú“, aby ste ich mohli pridať do zásob.
- 3 Keď ste pripravení na použitie reagensie alebo systému, vloží sa do podnosu na reagensie, kde ju systém BOND identifikuje a aktualizuje zásoby, keď sa reagensia použije.

Softvér BOND vedie záznamy o obsahu každej jednotlivej nádoby a systému, ako aj o celkových hodnotách pre každý typ reagensie. Pre reagensie Leica Biosystems môžete nastaviť limit na doobjednanie, ktorý vás upozorní, keď sú zásoby nízke. Pozrite si časť **Údaje o reagensii alebo systéme reagensí** v časti **8.3.2 Údaje o reagensii alebo systéme reagensí**.

8.1.1.3 Identifikácia reagensie

Jednotlivé nádoby na reagensie majú na identifikáciu dve čiarové kódy. Dlhšie čiarové kódy na predných stranách nádob sa používajú na registráciu nádob a ich identifikáciu po registrácii (pozrite si časť **8.3.3 Registrácia reagensí a systémov reagensí**). Kratšie čiarové kódy na vrchných stranách nádob (pod vekom) kódujú jedinečné identifikátory balenia (UPI), ktoré používa systém BOND na identifikáciu nádob, keď sú vložené do modulov spracovania. Použite UPI na manuálnu identifikáciu vlozenej nádoby na reagensie, ktorá nebola úspešne naskenovaná (pozrite si časť **5.1.3.5 Oprava nezistených reagensí**).

Systémy reagensí BOND na použitie s modulmi spracovania iBOND-III a BOND-MAX sú označené dvomi čiarovými kódmi na stranách podnosov. Na registráciu systémov a ich identifikáciu po registrácii použite oba čiarové kódy.

Systémy reagensí BOND-PRIME majú na bočnej strane podnosu jeden 2D čiarový kód, ktorý sa používa na identifikáciu systému reagensí po registrácii.

Jednotlivé nádoby v systémoch reagensí majú na hornej a prednej strane čiarové kódy UPI. Softvér BOND ich používa na identifikáciu systémov, keď sú vložené do modulov spracovania. Ak automatická identifikácia zlyhá, keď je systém reagensí vložený do systému BOND-MAX alebo BOND-III, tieto čísla UPI je možné zadať na manuálnu identifikáciu nádob. Toto nie je možné vykonať v prípade modulu spracovania BOND-PRIME.

Informácie o akejkoľvek reagensii alebo systéme reagensí, ktoré boli zaregistrované, môžete kedykoľvek zobrazíť opätovným naskenovaním dlhého čiarového kódu na strane jednotlivých nádob alebo dvoch čiarových kódov (alebo jedného 2D čiarového kódu) na stranách systémov reagensí.

Ak sa balík nedá naskenovať, otvorte dialógové okno **Manual ID entry** (Manuálne zadanie ID) kliknutím na ikonu **Search**

(Vyhľadávanie)  na paneli funkcií alebo tlačidlo **Enter ID** (Zadať ID) na obrazovke **Reagent Inventory** (Zásoby reagensí).

Uveďte čísla priradené dlhým čiarovým kódom na prednej strane jednotlivých nádob/systémov reagensí alebo čísla priradené 2D čiarovému kódu a potom kliknite na položku **Validate** (Overiť) (pre systémy reagensí kliknite na položku **Validate** (Overiť) po zadaní každého čiarového kódu).

8.1.1.4 Náhrada reagensie

BOND-PRIME

V systéme BOND-PRIME nie je náhrada reagensie.

Ak systém BOND-PRIME sa zistí, že má nedostatočné množstvo reagensie, vykoná jeden z nasledujúcich krokov:

- označí príslušné sklíčko (sklíčka), ak už začal spracovávať sklíčko v module ARC,
- odmietne sklíčko, ak je sklíčko stále v zásuvke na predbežné vloženie.

BOND-III a BOND-MAX

Pred spustením spracovania musí byť do modulu spracovania vložený dostatočný objem všetkých požadovaných reagensí. Niekedy však reagensia, ktorá bola pôvodne prítomná, nemusí byť v čase potreby k dispozícii. Dôvodom môže byť skutočnosť, že operátor odstránil podnos na reagensie alebo nádoba na reagensie mohla mať v skutočnosti menej reagensie, ako bolo pôvodne stanovené. Ak k tomu dôjde, systém BOND sa pokúsi nahradiť chýbajúcu reagensiu reagensiou rovnakého typu z inej nádoby. Pri nahradení nedostupnej reagensie systém BOND používa nasledujúce pravidlá:

- Systém sa spočiatku pokúša nahradiť chýbajúcu reagensiu reagensiou rovnakého typu z rovnakého systému reagensí.

Ak bude úspešný, cyklus bude pokračovať bez oznámenia.

- Systém sa potom pokúsi nahradiť chýbajúcu reagensiu alternatívnym zdrojom s rovnakým typom a rovnakým číslom šarže.

Ak bude úspešný, cyklus bude pokračovať bez oznámenia.

- Systém sa potom pokúsi nahradiť chýbajúcu reagensiu alternatívnym zdrojom, ktorý má rovnaký typ reagensie, ale akékoľvek číslo šarže.

V prípade, že sa to úspešne podarí, cyklus bude pokračovať, ale ovplyvnené sklíčka budú mať oznámenie o udalosti.

- Ak substitúcia reagensie nie je možná, reagensia sa nahradí nebalenou reagensiou pre všetky dávkovania na ovplyvnených sklíčkach až do konca cyklu.

Cyklus bude pokračovať, ale ovplyvnené sklíčka budú mať oznámenie o udalosti.

- Ak sú ovplyvnené všetky sklíčka a je potrebné ich nahradiť nebalenou reagensiou, cyklus bude prerušený.

8.1.1.5 Systém HER2 IHC BOND™ Oracle™



Tieto možnosti nie sú k dispozícii na použitie na moduloch spracovania BOND-PRIME.

Systém HER2 IHC BOND™ Oracle™ pozostáva zo systémov reagencií a môže obsahovať kontrolné sklíčka. Vyžadujú sa tiež štandardné nebalené reagenty a pre niektoré systémy pomocné reagenty.

Vždy dodržiavajte pokyny, ktoré sa dodávajú s produktom, a pamätajte na nasledujúce:

- kontrolné sklíčka dodávané so systémom Bond™ Oracle™ HER2 IHC sa nazývajú kontrolné sklíčka Oracle a líšia sa od interných sklíčok kontrolných vzoriek používaných pri spustení systému Oracle:
 - Vlastné sklíčka s kontrolnými vzorkami sa v softvéri vytvárajú pomocou štandardných nastavení **Tissue type** (Typ tkaniva) a **Marker** (Značkovač) v dialógovom okne **Add slide** (Pridanie sklíčka), ale *nie* možnosti **Oracle control** (Kontrola Oracle).
 - Sklíčka Oracle s kontrolnými vzorkami sa musia nastaviť pomocou možnosti **Oracle control** (Kontrola Oracle) okrem príslušnej možnosti **Tissue type** (Typ tkaniva).
- Sklíčka Oracle s kontrolnými vzorkami je možné používať iba so špecifickým systémom, z ktorého pochádzajú.
- Štítky sklíčok Oracle používajú špeciálne šablóny štítkov Oracle definované na obrazovka **Labels** (Štítky) klienta správy (pozrite si časť **10.3 Labels (Štítky)**).

8.2 Obrazovka nastavenia reagensie

Na obrazovke **Reagent setup** (Nastavenie reagensie) sa zobrazuje zoznam všetkých reagensí, ktoré sú známe pre softvér BOND, vrátane reagensí v systémoch reagensí a reagensí miešaných v module spracovania z komponentov reagensí. Všetky hotové primárne reagensie BOND sú v zozname preddefinované (a nemôžu byť odstránené), rovnako ako aj hotové sondy ISH BOND a množstvo bežných pomocných reagensí Leica Biosystems.

Filtre pod tabuľkou umožňujú nastaviť typ reagensie, ktorá sa má zobraziť. Nemôžete filtrovať na základe typov balenia, ale môžete filtrovať na základe typov reagensí (primárne, sondy, pomocné reagensie, zmiešané reagensie, reagensie Oracle a paralelné primárne a sondy s multiplexovým farbením) a na základe dodávateľa a preferovaného stavu.

Tlačidlá nad tabuľkou umožňujú: pridať nové reagensie do zoznamu; otvoriť reagensiu, ktorá je vybraná v tabuľke, na zobrazenie alebo úpravu jej detailov alebo odstránenie reagensie, ktorá je zvolená v tabuľke (môžete odstrániť iba reagensie, ktoré nie sú od spoločnosti Leica Biosystems).



Nemôžete zaregistrovať reagensie, ktoré tu nie sú uvedené, ani reagensie definované používateľom, ktoré nemajú preferovaný stav.

Tabuľka obsahuje nasledujúce podrobnosti pre každú reagensiu:

Názov	Úplný názov reagensie. Počiatočný znak „*“ označuje preddefinovanú reagensiu Leica Biosystems.
Abb. name (Skrátený názov)	Skrátený názov reagensie, ktorý sa používa na štítkoch sklíčok a na stavovej obrazovke.
Type (Typ)	Typ reagensie, napríklad primárna.
Supplier (Dodávateľ)	Meno dodávateľa reagensie.
Pref.	Zaškrtnuté (preferované) značkovače sú zahrnuté v zoznamoch konfigurácií sklíčok inde v softvéri BOND.

Upraviteľné vlastnosti reagensie

Okrem názvu a podrobností o dodávateľovi sú editovateľné možnosti reagensí:

- 1 Pre značkovače:
 - a protokoly vybrané v predvolenom nastavení, keď sa značkovač vyberie počas vytvárania sklíčka (pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)). Pre aplikácie s jedným značkovačom a pre predbežné a konečné aplikácie pri multiplexovom farbení je možné nastaviť odlišné protokoly;
 - b preferovaný stav – v rozbaľovacom zozname **Marker** (Značkovač) sa počas vytvárania zobrazujú iba preferované značkovače (pozrite si časť [6.5.2 Vytvorenie sklíčka](#)) a zoznam **Available markers** (Dostupné značkovače) v dialógovom okne **Reagent panels properties** (Vlastnosti panelov reagensí) pri vytváraní panela (pozrite si časť [8.4.1 Vytvorenie panela](#)). Podľa tejto vlastnosti je možné filtrovať aj zoznamy na obrazovke reagensí;
 - c nebezpečný stav – značkovače označené ako nebezpečné sa vymývajú do nebezpečného odpadu. Toto nastavenie nie je možné zmeniť pre preddefinované reagensie.
- 2 Pre pomocné reagensie
 - a nebalené reagensie, ktoré sú kompatibilné s reagensiou – systém BOND automaticky zabraňuje kontaktu nekompatibilných pomocných a objemových reagensí;
 - b preferovaný stav – na základe tejto vlastnosti je možné filtrovať zoznamy reagensí;
 - c nebezpečný stav – reagensie označené ako nebezpečné sa vymyjú do nebezpečného odpadu. Toto nastavenie nie je možné zmeniť pre preddefinované reagensie.

Pozrite si sekcie:

- [8.2.1 Pridanie alebo úprava reagensie](#)
- [8.2.2 Odstránenie reagensie](#)

8.2.1 Pridanie alebo úprava reagensie

Ak chcete do zoznamu pridať reagensie, kliknite na položku **Add** (Pridať) na obrazovke **Reagent setup** (Nastavenie reagensie). Softvér BOND zobrazí dialógové okno **Add reagent** (Pridať reagensiu). Pozrite si časť **Obrázok 8-2** nižšie.

Obrázok 8-2: Dialógové okno pridania reagensie

Add reagent ✕

Name: The name must start with a letter or number

Abbreviated name:

Type: ▼

Supplier:

Staining method: ▼

Single
 Preliminary
 Final

Default staining protocol: ▼

Default HIER protocol: ▼

Default enzyme protocol: ▼

Compatible bulks:

Preferred
 Hazardous

Ak chcete zmeniť údaje o existujúcej reagensii, vyberte ju a kliknite na položku **Open** (Otvoriť) alebo dvakrát na ňu kliknite. Otvorí sa dialógové okno **Edit reagent properties** (Upravenie vlastností reagensie). Je rovnaké ako dialógové okno **Add reagent** (Pridanie reagensie) s údajmi o vybranej reagensii.

Na pridanie alebo úpravu reagensí postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Ak pridávate novú reagensiu, do poľa **Name** (Názov) zadajte popisný názov.

Nové reagensie nemôžu začínať znakom *, ktorý je vyhradený pre reagensie Leica Biosystems.



Pri vytváraní protokolov alebo sklíčok buďte opatrní, aby ste nepoužili názov, ktorý by mohol spôsobiť zámenu tejto reagensie za inú.

- 2 Pri nových reagensiach zadajte do poľa **Abbreviated Name** (Skrátený názov) krátky názov. Skrátené názvy sú obmedzené na osem znakov.

Tento názov sa zobrazuje na ikonách sklíčok v okne **Status** (Stav) a je vytlačený na štítkoch sklíčok.

- 3 Ak je systém BOND pripojený k systému LIS, zadajte názov reagensie použitej v LIS do poľa **Public name** (Verejný názov) (nevzťahuje sa na pomocné reagensie).
- 4 Ak vytvárate novú reagensiu, vyberte typ reagensie z rozbaľovacieho zoznamu **Type** (Typ). Dialógové okno sa zmení v závislosti od typu, ktorý vyberiete.
- 5 Zadajte názov dodávateľa reagensie do poľa **Supplier** (Dodávateľ).
- 6 Ak je reagensiou značkovač (primárna protilátka alebo RNA alebo DNA sonda), vyberte predvolené protokoly, ktoré sa majú použiť v rôznych typoch cyklu farbenia, ktoré používajú značkovač.
- 7 V poli **Staining method** (Metóda farbenia) vyberte možnosť **Single/Sequential multiplex** (Jednoduché/sekvenčné multiplexové) na nastavenie predvolených protokolov pre značkovače v cykloch jednoduchého farbenia, na karte **Single** (Jednoduché). Pre značkovače v cykloch sekvenčného multiplexového farbenia nastavte predvolené protokoly pre prvú aplikáciu na karte **Preliminary** (Predbežné) a nastavte predvolený protokol pre poslednú aplikáciu na karte **Final** (Konečné).
- 8 Vyberte položku **Parallel multiplex** (Paralelné multiplexové) na nastavenie predvolených protokolov pre značkovače v cykloch paralelného multiplexového farbenia.



Ak je reagensiou RNA alebo DNA sonda, na všetkých vyššie uvedených záložkách sa objavia ďalšie protokoly (denaturácia a hybridizácia).

- 9 Pre preddefinované značkovače BOND stlačte položku **Restore factory default protocols** (Obnoviť predvolené výrobné protokoly), ak chcete protokoly vrátiť na predvolené hodnoty od výroby, ktoré sú odporúčané pre daný značkovač (na obnovenie predvolených nastavení od výroby musíte byť prihlásení pomocou úlohy používateľa – dohliadajúci).

- 10 Ak je reagentia používateľom vytvorená pomocná reagentia, skontrolujte kompatibilitu roztoku nebaleného materiálu a v prípade potreby ju upravte.

Väčšina systémov predvolene zobrazí roztok BOND Wash Solution (*BWash) a deionizovanú vodu (*DI) v zozname **Compatible bulks** (Kompatibilné nebalené materiály). To znamená, že jeden z týchto roztokov sa použije v systéme fluidík na nasávanie a odsávanie reagentie. Aj keď roztoky nebaleného materiálu by nemali prísť do priameho styku s pomocnou reagentiou, v nasávacej sonde môže dôjsť k miernemu kontaktu. Ak sa chcete tejto možnosti úplne vyhnúť, vyberte roztok nebaleného materiálu, ktorý by nemal prísť do styku s reagentiou, a kliknite na tlačidlo <<, aby ste ho presunuli do zoznamu **Available bulks** (Dostupné nebalené materiály).

Musí byť nastavený aspoň jeden roztok nebaleného materiálu, ktorý je kompatibilný.



POZOR: Ak sa povolí, aby sa vzájomne nekompatibilné roztoky dostali navzájom do styku, môžu sa vyskytnúť neuspokojivé výsledky farbenia a potenciálne poškodenie modulu spracovania. Obráťte sa na spoločnosť Leica Biosystems, aby určila, či sú roztoky kompatibilné.

- 11 V prípade značkovačov kliknite na položku **Preferred** (Preferované) na zobrazenie primárnej látky alebo sondy v dialógových oknách nastavenia sklíčka.
- V prípade pomocných reagencií sa preferovaný stav používa iba vo filtroch zoznamu v oknách **Reagent Setup** (Nastavenie reagentie) a **Inventory** (Zásoby).
- 12 Ak chcete, aby sa reagentia prepláchla do nádoby na nebezpečný odpad, kliknite na položku **Hazardous** (Nebezpečný).
- 13 Kliknite na položku **Save** (Uložiť) a do systému BOND pridáte údaje o reagentii.

Kliknite na položku **Cancel** (Zrušiť) kedykoľvek počas procesu, aby ste vyšli bez vykonania akýchkoľvek zmien.

8.2.2 Odstránenie reagentie

Ak chcete reagentiu odstrániť, vyberte ju zo zoznamu na obrazovke **Reagent Setup** (Nastavenie reagentie) a kliknite na položku **Delete** (Odstrániť). Preddefinované reagentie Leica Biosystems (začínajúce hviezdikou) nie je možné odstrániť.



Keď vymažete údaje o reagentii, odstránite tiež údaje o zásobách pre balenia tejto reagentie. Nie je možné obnoviť odstránené údaje o reagentii ani údaje o zásobách.

Ak už nepotrebujete reagentiu, ktorú ste predtým použili, môžete ju radšej označiť ako nepreferovanú, než ju odstrániť. Týmto bude odstránená z väčšiny obrazoviek softvéru, ale ponechá sa v systéme.

8.3 Obrazovka zásob reagensí

Na obrazovke **Reagent Inventory** (Zásoby reagensí) je uvedený zoznam všetkých reagensí a systémov reagensí, ktoré boli zaregistrované v systéme BOND (a neboli vymazané), a aktuálny stav ich zásob. Pomocou obrazovky môžete zobraziť a spravovať zásoby.

Obrázok 8-3: Obrazovka Reagent Inventory (Zásoby reagensí)

Name	Supplier	Type	Catalog N°	Vol. (mL)	Min. (mL)
*Kappa Probe	Leica Microsystems	Probe RNA	PE0545	27.50	11.00
*CD15 (Carb-1)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0039	44.85	7.00
GFAP (ER2, Enzyme1)	AAA Antibodies	Primary antibody	Open container	0.00	0.00
*Anti-Fluorescein Antibody	Leica Microsystems	Ancillary	AR0222	30.00	15.00
*CD30 (IG12)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0153	0.00	1.00
*Melan A (A103)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0233	7.00	0.00
*CD7 (LP15) *NEW*	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0017	0.00	14.00
*Lambda Probe	Leica Microsystems	Probe RNA	PE0569	16.50	5.50
*Estrogen Receptor (ER11)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0151	14.00	7.00
*CD5 (4C7)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0168	6.55	0.00
*Cytokeratin 20 (PW31)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0918	0.00	7.00
*Estrogen Receptor (ER11)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0009	0.00	10.00
*Immunoglobulin D...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0051	7.00	2.00
*Glial Fibrillary Acidic...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0026	0.00	5.00
*CD25 (4C9)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0305	47.50	14.00
*CD10 (56C6)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0131	0.00	0.00
*Immunoglobulin G...	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0904	7.00	3.00
*CD20 (MJ1)	Leica Microsystems	Primary antibody	PA0906	47.55	14.00

Package type: Reagent containers | Reagent type: All | Inventory status: All | Supplier: All | Preferred status: Preferred

Reagencie Leica Biosystems s menším než minimálnym objemom zásob sú zvýraznené červenou zvislou čiarou na ľavej strane obrazovky.

Filtre pod tabuľkou umožňujú nastaviť typ reagensie alebo systému, ktorý sa má zobraziť.

Na detekciu BOND systémy Oracle a systémy čistenia – vybrané vo filtri **Package type** (Typ balenia) – môžete filtrovať len jednu položku **Inventory status** (Stav zásob). To vám umožní zobraziť všetky zaregistrované systémy, len tie, ktoré sú na sklade, alebo tie, ktoré sú pod úrovňou doobjednania.

V prípade jednotlivých nádob na reagensie môžete tiež filtrovať pomocou možnosti **Supplier** (Dodávateľ), **Preferred status** (Preferovaný stav) a **Reagent type** (Typ reagensie) (t. j. zobraziť „Primárne“, „Sondy“, „Primárne na paralelné koktailové farbenie“, „Sondy na paralelné koktailové farbenie“, „Pomocné reagensie“ alebo „Všetky“ reagensie).

V závislosti od typu reagentie sa môžu zobraziť niektoré alebo všetky nasledujúce detaily.

Názov	Úplný názov reagentie.
Supplier (Dodávateľ)	Meno dodávateľa reagentie. Nezobrazuje sa pre systémy reagentií.
Type (Typ)	Typ reagentie, napríklad primárna. Nezobrazuje sa pre systémy reagentií.
Catalog No. (Katalógové č.)	Katalógové číslo reagentie, ktoré sa má uviesť pri doobjednaní. Tento údaj sa nezobrazuje pre systémy reagentií (stĺpec je prítomný, ale všetky hodnoty sú prázdne).
Objem (ml)	Celkové množstvo dostupnej reagentie. Patria sem všetky registrované balíky reagentií, či už sú aktuálne vložené do modulu spracovania alebo nie (pozrite si časť 8.3.1 Stanovenie objemu reagentie).
Runs rem. (Zostávajúce cykly)	V prípade systémov Oracle je to počet zostávajúcich cyklov v systéme.
Cleans remaining (Zostávajúce čistenia)	Počet zostávajúcich čistení v čistiacich systémoch.
Min. (ml)	Len pre reagentie Leica Biosystems, je to objem zásob, pri ktorom sa zobrazí výzva na doobjednanie (pozrite si časť 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby).
Min. (cykly)	V prípade systémov Oracle je to počet zostávajúcich cyklov, pri ktorých sa zobrazí výzva na doobjednanie (pozrite si časť 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby).
Min. (čistenia)	V prípade systémov čistenia je to počet zostávajúcich čistení, pri ktorých sa zobrazí výzva na doobjednanie (pozrite si časť 8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby).

Ovládacie tlačidlá nad tabuľkou reagentií vám umožňujú spravovať zásoby reagentií.

- Kliknutím na tlačidlo **Details** (Podrobnosti) zobrazíte informácie o jednotlivých baleniach reagentií vybraného typu reagentií a nastavíte pre ne možnosti.

Pozrite si časť [8.3.2 Údaje o reagentii alebo systéme reagentií](#) pre viac informácií.

- Kliknutím na tlačidlo **Enter ID** (Zadať identifikátor) pridáte zoznam reagentií do systému v dialógovom okne **Manual ID entry** (Manuálne zadanie identifikátora), ak ručný skener nedokáže automaticky rozpoznať identifikátor (len BOND-III a BOND-MAX).

Ďalšie informácie si pozrite v časti [8.3.3 Registrácia reagentií a systémov reagentií](#).

- Kliknutím na tlačidlo **Details report** (Podrobná správa) vygenerujete správy o reagentiách alebo systémoch reagentií, ktoré sú v súčasnosti uvedené v tabuľke.

Pozrite si časť [8.3.4 Správa s údajmi o zásobách](#).

- Kliknutím na tlačidlo **Reagent usage** (Použitie reagentie) vygenerujete správy o použití reagentie v stanovenom časovom období.

Pozrite si časť [8.3.5 Správa o použití reagentií](#).

Pozrite si tiež časť [8.3.1 Stanovenie objemu reagentie](#), kde nájdete všeobecný opis toho, ako systém BOND sleduje inventár reagentií.

8.3.1 Stanovenie objemu reagensie

Systém BOND používa dve metódy na stanovenie objemu reagensie v nádobách na podnose na reagensie: vypočíta objem na základe počítačného objemu a následného použitia a meria ho priamo pomocou systému snímania hladiny kvapaliny (LLS) pre BOND-III a BOND-MAX alebo ultrazvukového systému snímania hladiny kvapaliny (uLLS) pre BOND-PRIME.

Výpočet objemu závisí od pôvodného objemu reagensie, odčítania reagensie pri jej dávkovaní a pričítania pri doplňovaní (otvorené nádoby). Ak dôjde k strate reagensie odparením alebo rozliatím, môžu sa vyskytnúť nezrovnalosti.

V prípade BOND-MAX a BOND-III systém LLS je integrovaný do nasávacej sondy. Stanovuje objemy reagensie zistením výšky reagensie, keď sa nasávacia sonda ponorí do nádob. V predvolenom nastavení sa meranie objemu LLS (často označované ako testovanie namočením) automaticky vykonáva za rôznych podmienok, napríklad ak sa nádoba nemerala dlhšie ako 30 dní. Reagensia sa mohla odpariť alebo nádoba sa mohla použiť v inom systéme. Tieto predvolené testovania namočením sú naplánované v čase, keď nebudú zdržiavať spracovanie, takže je možné, že reagensia, ktorá sa pôvodne považovala za dostupnú, nemusí neskôr mať dostatočný objem pre plánované cykly. Ak k tomu dôjde, aktivuje sa upozornenie a operátor musí buď doplniť nádobu (iba otvorené nádoby) alebo zabezpečiť, aby bola k dispozícii vhodná alternatívna reagensia (pozrite si časť [8.1.1.4 Náhrada reagensie](#)).

V prípade BOND-PRIME je systém uLLS integrovaný do sondy ARC. Ak dôjde k nezrovnalosti, systém uLLS vykoná testovanie namočením rovnakým spôsobom, ako sa vykonáva v prípade BOND-MAX a BOND-III.

Prípadne môžete nastaviť systém BOND na testovanie namočením nádob pred každým spracovaním. Toto je nastavené nezávisle pre otvorené nádoby, nádoby pripravené na použitie a systémy reagensí. Toto nastavenie zaisťuje, že spustené cykly majú dostatok reagensie na dokončenie, avšak predlžuje spracovanie kvôli vykonávaniu testovaní namočením. Tieto možnosti nastavíte na table klienta správy **Settings > Laboratory settings** (Nastavenia > Laboratórne nastavenia) (pozrite si časť [10.5.1 Laboratórne nastavenia](#)).



Nádoby na reagensie neprepĺňajte. Pri testovaní namočením sa prepĺnená nádoba na reagensie bude hlásiť ako prázdna.

8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekčné systémy

Aby objemy vykazované pre detekčné systémy BOND boli porovnateľné so systémami uvádzanými pre jednotlivé nádoby (umožňujúce odhad počtu sklíčok, pre ktoré sa môže použiť detekčný systém), objemy systému sa vykazujú v mililitroch, pokiaľ ide o jednu nádobu. Keďže však detekčné systémy pozostávajú z nádob s rôznymi objemami, musí sa uplatniť pravidlo vykazovania objemu opísané v tejto časti.

Upozorňujeme, že toto pravidlo sa nevzťahuje na systémy Oracle alebo čistiace systémy, ktoré nahlasujú zostávajúci počet cyklov alebo čistení.

V prípade detekčných systémov sa objem udáva relatívne k najväčšej jednotlivkej nádobe v systéme. Ak sa napríklad do najväčšej nádoby zmestí 30 ml, objem systému sa uvádza v pomere k 30 ml. Softvér BOND predpokladá, že všetky nádoby v nových systémoch sú plné, takže systém s najväčšou nádobou 30ml sa uvádza tak, že má objem 30ml po prvej registrácii.

Keď sa reagent používa, udáva sa hodnota objemu nádoby s najnižším relatívnym objemom. Ak objem tejto nádoby nie je rovnaký ako objem najväčšej nádoby v systéme, hodnota sa normalizuje na objem najväčšej nádoby. Napríklad v systéme s niekoľkými nádobami po 30 ml a dvomi nádobami po 2.4 ml je možné, že jedna z ml nádob má vzhľadom na počiatočné objemy najmenší objem reagentu. Ak v nej zostáva 1.2 ml (polovica pôvodného objemu), potom sa objem systému ako celku uvádza ako polovica z 30 ml (15 ml).

8.3.1.2 Nahlasovanie zostávajúcich testov pre výskumné systémy reagensí

Každý výskumný systém reagensí môže spustiť pevný počet testov (napr. 200 testov, ak je predvolený dávkovací objem 150 µl).

Pri každom farbení sklička pomocou tohto výskumného systému reagensí sa zníži počet zostávajúcich testov.

Keď počet zostávajúcich testov dosiahne nulu, systém sa označí ako **Empty** (Prázdny).

8.3.2 Údaje o reagenti alebo systéme reagensí

Ak chcete zobraziť podrobnosti o jednotlivých baleniach reagentu alebo systému reagensí, dvakrát kliknite na typ reagentu v tabuľke zásob reagensí alebo ho vyberte a kliknite na tlačidlo **Details** (Detaily).

Obrázok 8-4: Dialógové okno **Reagent inventory details** (Podrobnosti o zásobách reagensí)

Reagent inventory details

*Kappa Probe
 Package name: Kappa Probe, 5.5 mL
 Catalog N°: P00645 Minimum stock: 11.00
 Set minimum stock level

Show Available Empty Expired

UPI	Lot N°	Expiration date	Registered	First used	Marked empty	Initial vol. (mL)	Wt. (mL)
00676410		20-May-21	16-Apr-13			5.50	5.50
00676421	04224	25-Feb-21	16-Apr-13			5.50	5.50
00676420	04224	25-Feb-21	16-Apr-13			5.50	5.50
00676457		20-May-21	16-Apr-13			5.50	5.50
00604913	05933	05-Feb-23	23-Aug-13			5.50	5.50

Mark as empty

Details report Close

Dialógové okno s podrobnosťami o zásobách zobrazuje každé jednotlivé balenie vybranej reagentu alebo systému. Polia a možnosti dialógových okien sa líšia v závislosti od typu balenia reagentu a dodávateľa. Pri predvolenom nastavení sú zobrazené iba balenia s dostupnými, neexpirovanými reagentami. Môžete tiež zobraziť prázdne balenia (ktoré nedosiahli dátum expirácie) alebo všetky balenia, ktoré expirovali v poslednom mesiaci – v dialógovom okne podľa potreby vyberte možnosť **Available** (Dostupné), **Empty** (Prázdne) alebo **Expired** (Expirované).

Položka **Package name** (Názov balíka) pre reagentu je zobrazená pre všetky typy balenia reagentu. Okrem toho sa pre reagentu BOND zobrazuje položka **Catalog N°** (Katalógové č) – na účely doobjednania a – reagentu BOND (ale nie systémy) tiež majú pole **Package name** (Názov balíka), ktoré obsahuje veľkosť balenia.

Reagentu a systémy BOND majú aj pole **Minimum stock** (Minimálna zásoba), ktoré uvádza úroveň zásob, pri ktorej sa zobrazí výzva na doobjednanie reagentu (pozrite si časť **8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby**).

Pomocou ručnej čítačky môžete naskenovať čiarové kódy alebo 2D čiarový kód na boku zaregistrovanej nádoby na reagentie alebo systému reagensí a spustiť dialógové okno s detailmi o zásobách. Naskenovaná položka zásob sa zvýrazní v tabuľke s podrobnosťami a filtre **Show** (Zobraziť) (Available (Dostupné), Empty (Prázdne) alebo Expired (Exspirované)) sa automaticky nastaví podľa potreby.

Tabuľka v dialógovom okne obsahuje nasledujúce informácie o každom balení reagensí:

UPI (jedinečný identifikátor balenia)	Jedinečný identifikátor balenia (pozrite si časť 8.1.1.3 Identifikácia reagensie).
Lot No. (Č. šarže)	Číslo šarže balenia.
Expiration date (Dátum expirácie)	Dátum expirácie balenia. Balenia by sa po tomto dátume nemali používať.
Registered (Zaregistrované)	Dátum, kedy bolo balenie prvýkrát zaregistrované v systéme BOND.
First used (Prvé použitie)	Dátum, kedy bolo balenie prvýkrát použité v systéme BOND.
Marked empty (Označené ako prázdne)	Dátum, kedy bolo balenie označené ako prázdne. Táto položka môže byť nastavená automaticky pomocou softvéru alebo manuálne (pozrite si časť 8.3.2.3 Označenie balenia ako prázdne alebo nie prázdne).
Počiatkový objem (ml)	Objem reagensie, ktorý bol v novom plnom balení. Nezobrazuje sa pre systémy reagensí.
Objem (ml)	Aktuálny objem reagensie v nádobe. Pre detekčné systémy si pozrite časť 8.3.1.1 Nahlasovanie objemu pre detekčné systémy .
Refill (mL) (Náplň (ml))	V prípade otvorených nádob je to zvyšný objem reagensie, ktorý sa môže použiť na naplnenie nádoby.
Cleans remaining (Zostávajúce čistenia)	V prípade čistiacich systémov je to počet čistení, ktoré je možné vykonať so zvyšnou reagensiou.
Runs remaining (Počet zostávajúcich cyklov)	V prípade systémov Oracle je to počet čistení, ktoré je možné vykonať so zvyšnou reagensiou.

Tlačidlá v dialógových oknách s podrobnosťami o zásobách umožňujú konfiguráciu rozsahu údajov o zásobách (vhodné pre typ balenia) a vytvorenie správy s údajmi pre konkrétnu reagentiu alebo systém. V nasledujúcich častiach sú opísané možnosti konfigurácie a správ.

8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby

Preddefinované reagentie a systémy reagensí Leica Biosystems môžu mať nastavenú minimálnu úroveň zásob. Ak celková zásoba reagensie klesne pod nastavenú úroveň, reagentia bude zvýraznená v okne **Reagent Inventory** (Zásoby reagensie) načerveno, aby tak vyzvala používateľa k zmene poradia reagensí alebo systému.

Ak chcete zmeniť nastavenie minimálnej zásoby, kliknite na položku **Set minimum stock level** (Nastaviť minimálnu úroveň zásob). V rozbaľovacom dialógovom okne zadajte požadovanú minimálnu úroveň zásob do poľa **Minimum stock** (Minimálne zásoby). V závislosti od typu balenia používajte mililitre, cykly alebo čistenia. Kliknite na tlačidlo **OK**.

8.3.2.2 Správa o reagensii

Kliknite na možnosť **Details report** (Podrobná správa) na vygenerovanie správy iba pre vybranú reagensiu alebo systém reagensí. Kliknite na možnosť **8.3.4 Správa s údajmi o zásobách** (Prehľad podrobností o inventári) a pozrite si ďalšie údaje.

8.3.2.3 Označenie balenia ako prázdne alebo nie prázdne

Balenie reagensí môžete označiť ako prázdne, napríklad keď sa vyradí pred úplným použitím. Vyberte balenie v tabuľke a kliknite na položku **Mark as empty** (Označiť ako prázdne). Softvér vloží aktuálny dátum do poľa **Marked empty** (Označené ako prázdne).

Ak chcete obnoviť balenie reagensie označené ako prázdne, označte ho v tabuľke a kliknite na položku **Mark not empty** (Označiť ako nie prázdne). Toto je možné vykonať iba vtedy, keď balenie nie je načítané do modulu spracovania. Balenie uvádza objem reagensie, ktorý malo pred tým, ako bolo označené ako prázdne.

Vyberte prepínač **Empty** (Prázdny) nad tabuľkou, aby ste zobrazili položky, ktoré sú označené ako prázdne.

8.3.2.4 Dopĺňanie otvorenej nádoby na reagensie

Otvorené nádoby na reagensie BOND môžete použiť znova a dávkovať až 40ml konkrétnej reagensie. Počet naplnení nádob nie je nijako obmedzený, ak ich naplníte menším množstvom, ako je objem podnosu.

Na naplnenie otvorenej nádoby použite nasledujúce pokyny.

- 1 Naplňte nádobu požadovaným objemom reagensie.
- 2 Naskenujte nádobu (podľa opisu v časti **8.3.3 Registrácia reagensí a systémov reagensí**), potom kliknite na tlačidlo **Refill** (Náplň).

Tlačidlo doplňovania nebude k dispozícii, ak prídanie väčšieho množstva reagensie do nádoby prekročí limitnú hodnotu 40 ml.

- 3 Nastavte dátum expirácie pre novú reagensiu.



Upozorňujeme, že keď sa otvorená nádoba naplní (buď prvýkrát alebo doplnenie), softvér predpokladá, že nádoba sa naplní na maximum, ktoré je k dispozícii pre danú nádobu, t. j. objem (ml) špecifikovaný používateľom, keď sa reagensia po prvýkrát zaregistruje, alebo aktuálny objem plus zvyšok povoleného objemu doplňovania. Hlásený objem sa v prípade potreby opraví, keď sa vykonáva testovanie namočením. K tomuto nemusí dôjsť, kým sa nádoba nepoužije.




Každá otvorená nádoba je pri prvej registrácii pevne pripojená k určitej reagensii. Každá otvorená nádoba musí používať rovnakú reagensiu pri každom doplnení.

8.3.3 Registrácia reagencií a systémov reagencií

Registrácia balenia reagencií pridá dané balenie do zásob. Reagencia musí byť pred registráciou balenia uvedená v zozname **Reagent Setup** (Nastavenie reagencie).

Pred použitím v rámci modulov spracovania BOND je potrebné zaregistrovať balenia reagencií.

Ak do modulu spracovania vložíte neregistrovanú nádobu na reagencie, softvér ju nerozpozna a zobrazí informačnú ikonu  v príslušnej polohe reagencie na obrazovke **System status** (Stav systému).

Informácie o stave nádob na reagencie vložených do modulu spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.



Softvér BOND bude sledovať použitie reagencie a upozorní vás, keď bude potrebné reagenciu vymeniť.

Nepokúšajte sa naplniť nádobu na hotové reagencie BOND, pretože softvér BOND rozpozná, že ide o použitú nádobu, a odmietne ju použiť.

Ak systém BOND nerozpozna nové balenie reagencie, ktoré naskenujete na zaregistrovanie, pravdepodobne nemáte nainštalovaný najnovší súbor BOND Data Definitions (BDD). Skontrolujte na webových stránkach najnovší súbor BDD, potom ho stiahnite a nainštalujte (prostredníctvom obrazovky **BDD update** (Aktualizácia BDD) klienta správy), ak je jeho „verzia údajov“ vyššia ako verzia uvedená v dialógovom okne **About BOND** (Informácie o BOND). Po nainštalovaní najnovšieho súboru BDD reštartujte klinického klienta a skúste znova zaregistrovať nový podnos na reagencie alebo systém reagencií.

Metódy registrácie rôznych typov balení reagencií sú opísané v nasledujúcich častiach:

- [8.3.3.1 Registrácia systémov reagencií](#)
- [8.3.3.2 Registrácia hotových reagencií BOND](#)
- [8.3.3.3 Registrácia reagencií, ktoré nie sú hotové](#)
- [8.3.3.4 Manuálne zadanie identifikátora](#)

8.3.3.1 Registrácia systémov reagencií

Detekčný alebo čistiaci systém BOND zaregistrujte naskenovaním dvoch čiarových kódov na boku podnosu na reagencie.




Niektoré systémy reagencií majú na podnose na reagencie iba jeden čiarový kód, napríklad systémy s iba jednou alebo dvomi nádobami.

Systémy reagencií BOND-PRIME majú na bočnej strane podnosu jeden 2D čiarový kód.

Softvér zobrazí dialógové okno **Add reagent system** (Pridanie systému reagencií).

Nebezpečenstvo laserového žiarenia. Možnosť vážneho poškodenia očí. Vyvarujte sa priameho kontaktu očí s laserovými lúčmi.

Obrázok 8-5: Registrácia detekčného systému BOND

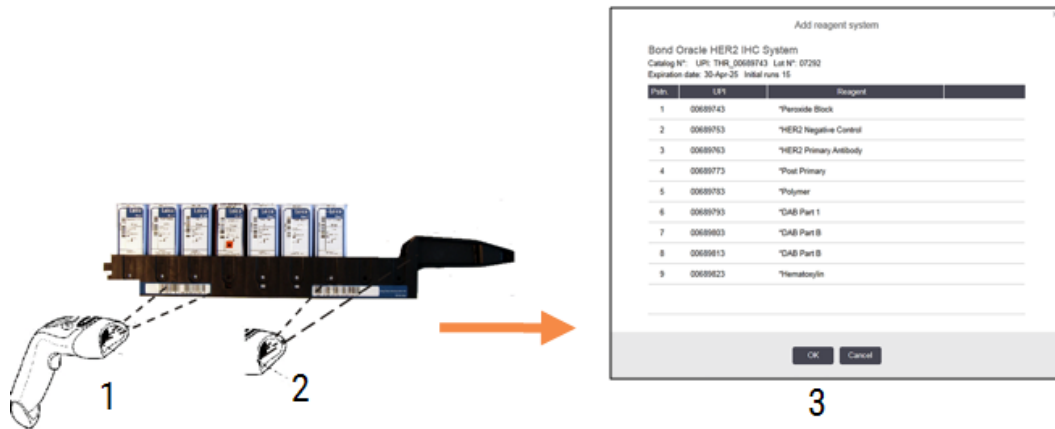

Skontrolujte, či údaje v dialógovom okne zodpovedajú údajom o balení, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.



Nepokúšajte sa zaregistrovať jednotlivé nádoby na reagentie, ktoré sú súčasťou systému reagentií.

8.3.3.2 Registrácia hotových reagentií BOND

Balenie hotových reagentií BOND zaregistrujete naskenovaním čiarového kódu na prednej strane nádoby. Softvér zobrazí dialógové okno **Add reagent package** (Pridanie balenia reagentií).

Obrázok 8-6: Registrácia balení reagentií BOND



Skontrolujte, či údaje v dialógovom okne zodpovedajú údajom o balení, a potom kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).

8.3.3.3 Registrácia reagensí, ktoré nie sú hotové

Reagencie nedodávané v baleniach hotových reagensí BOND sa dajú použiť v systéme BOND v otvorených alebo titračných nádobách BOND. Po príprave reagensie, ktorá nie je hotová, na použitie a po jej naplnení do 7ml alebo 30ml otvorenej nádoby alebo 6ml titračnej nádoby, sa zaregistruje takmer rovnakým spôsobom ako reagensie BOND:

- 1 Uistite sa, že reagensia bola vytvorená v systéme a je preferovaná. Na registráciu zásob musí preferovanú reagensiu definovať používateľ (pozrite si časť [8.2.1 Pridanie alebo úprava reagensie](#)).
Upozorňujeme, že enzýmy vytvorené s pomocou súpravy na predprípravu enzýmu BOND sú v systéme preddefinované a nevyžadujú manuálne vytvorenie.
- 2 Naskenujte čiarový kód na prednej strane otvorenej alebo titračnej nádoby a otvorte dialógové okno **Add open container** (Pridanie otvorenej nádoby).
- 3 Vyberte názov reagensie z rozbaľovacieho zoznamu **Reagent name** (Názov reagensie). (Názov dodávateľa je uvedený v zátvorkách vedľa názvu reagensie.)
Zoznam obsahuje všetky preferované pomocné reagensie a značkovače, ktoré nie sú od spoločnosti BOND, vytvorené v systéme, ako aj štyri preddefinované enzýmy, ktoré sa dajú pripraviť zo súpravy na predprípravu enzýmu BOND. Ak ste nevytvorili reagensiu v systéme, zrušte dialógové okno **Add open container** (Pridať otvorenú nádobu) a urobte to najprv (pozrite si krok 1 vyššie).
- 4 Zadajte číslo šarže reagensie z dokumentácie dodávateľa reagensie.
- 5 Kliknutím na ikonu **Expiration date** (Dátum expirácie) zadajte dátum expirácie pomocou ovládacích prvkov kalendára (alebo môžete dátum zadať).



Môžete zadať čiastkové dátumy, napríklad D/M, DD/MM alebo DD/MMM. Predpokladá sa aktuálny rok. Ak zadáte napríklad MM/RRRR alebo MMM/RRRR, predpokladá sa prvý deň daného mesiaca.

Ak zadáte neplatný dátum, okolo poľa **Expiration date** (Dátum expirácie) sa zobrazí červené ohraničenie a zobrazí sa chybová správa o overení.

Keď kliknete mimo poľa **Expiration date** (Dátum expirácie), platný záznam dátumu sa automaticky preformátuje tak, aby zodpovedal formátu systémového dátumu. Ak ste zadali aspoň jeden platný dátum pred zadaním neplatného dátumu, pole sa po kliknutí na toto tlačidlo obnoví na posledný zadaný platný dátum.

- 6 Kliknutím na tlačidlo **OK** zaregistrujte reagensiu.

8.3.3.4 Manuálne zadanie identifikátora

Ak sa systému BOND nepodarí prečítať čiarový kód reagensie, postupujte nasledovne: obrazovka **Reagent Inventory** (Zásoby reagensí):

- 1 Kliknite na položku **Enter ID** (Zadať identifikátor).
Softvér BOND zobrazí dialógové okno **Manual ID entry** (Manuálne zadanie identifikátora).

- 2 Do horného riadku dialógového okna napíšte čísla priradené dlhým čiarovým kódom na prednej strane nádoby alebo čísla priradené 2D čiarovému kódu.
- 3 Kliknite na položku **Validate** (Overiť).
Ak existuje viac ako jeden čiarový kód, ako v prípade detekčných systémov, kliknite na položku **Validate** (Overiť) po uvedení príslušných čísel pre každý čiarový kód.
- 4 Po overení oprávnenosti čiarového kódu softvér zobrazí príslušné dialógové okno **Add reagent package** (Pridať balenie reagensie).
- 5 Overte údaje o balení alebo ich pridávajte podľa potreby v dialógovom okne **Add reagent package** (Pridať balenie reagensie) a kliknite na položku **OK** (V poriadku), aby ste zaregistrovali balenie.

8.3.4 Správa s údajmi o zásobách

Môžete vygenerovať správu s údajmi o zásobách reagensí alebo systémov reagensí zobrazených v tabuľke v okne **Reagent Inventory** (Zásoby reagensí). Vygenerovaná správa uvádza údaje o každej z viditeľných reagensí alebo každom systéme vrátane zostávajúcich zásob. Ak je celkový stav zásob nižší ako minimálna úroveň zásob (pozrite si časť [8.3.2.1 Zmena nastavenia minimálnej zásoby](#)), potom je v správe označený ako Low (Nízky).

Filtre nastavíte v dolnej časti obrazovky tak, aby zobrazovali reagensie alebo systémy reagensí, ktoré vás zaujímajú, a potom kliknite na položku **Details report** (Správa s detailmi). Správa sa vygeneruje a zobrazí v novom okne.

V pravom hornom rohu správy s údajmi o zásobách reagensí sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
Facility (Zariadenie)	Názov zariadenia, ako je uvedený v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta správy Settings > Laboratory settings (Nastavenia > Laboratórne nastavenia), pozrite si časť 10.5.1 Laboratórne nastavenia
Subjekt	Nastavenia filtra použité na výber reagensí alebo systémov reagensí v správe.

V texte správy budú pre každú reagensiu uvedenú v tabuľke uvedené nasledujúce údaje:

- názov,
- celkový stav zásob (zvýraznený, ak je nižší ako minimálna úroveň zásob),
- katalógové číslo (pre hotové nádoby BOND) alebo „open“ (otvorené) (pre otvorené nádoby),
- typ (primárny, sonda, pomocný alebo typ systému reagensí),
- dodávateľ.

Pre každé jednotlivé balenie reagensí sa v správe uvádzajú nasledujúce údaje:

- UPI (jedinečný identifikátor balenia)
- číslo šarže,
- dátum expirácie,
- dátum registrácie,
- dátum prvého použitia,
- dátum posledného použitia,
- zostávajúce množstvo,

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

8.3.5 Správa o použití reagensí

V správe o použití reagensí sa uvádza množstvo použitej reagensie a počet testov vykonaných s touto reagensiou v stanovenom období. Informácie sú rozčlenené na jednotlivé nádoby a zobrazujú celkové hodnoty reagensí.

Správa sa vzťahuje na všetky reagensie použité v definovanom období bez ohľadu na reagensie, ktoré sú aktuálne zobrazené na obrazovke **Reagent Inventory** (Zásoby reagensí). Použitie systému reagensí nie je zahrnuté.



Použitie nebalených reagensí BOND-PRIME sa sleduje a zobrazuje v správe.

Kliknutím na možnosť **Reagent usage** (Použitie reagensie) otvorte dialógové okno na výber dátumu, kde je potrebné nastaviť obdobie, za ktoré sa má správa zahrnúť. Nastavte dátumy a časy **From** (Od) a **To** (Do) (pozrite si časť [Použitie výberov dátumu a času \(Sekcia na strane 225\)](#)) a potom kliknite na tlačidlo **Generate** (Generovať). Správa sa vygeneruje a zobrazí v novom okne.

V pravom hornom rohu správy o použití reagensí sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
Facility (Zariadenie)	Názov zariadenia, ako je uvedený v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta správy Settings > Laboratory settings (Nastavenia > Laboratórne nastavenia), pozrite si časť 10.5.1 Laboratórne nastavenia
Časový úsek	Dátumy „od“ a „do“ za obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje

Pre každú použitú reagensiu v období správa uvádza nasledujúce údaje:

- názov (skrátенý názov reagensie);
- UPI každej použitej nádoby;
- číslo šarže každej použitej nádoby;
- dátum expirácie každej použitej nádoby;

- počet spracovaných sklíčok na nádobu a celkový obsah reagensie;
- objem reagensie použitej v danom období, v jednom obale, ako aj v celkovom množstve reagensie.

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlačie.

8.4 Obrazovka panela reagensí

Panel je používateľom definovaná súprava značkovačov. Pomocou panelov môžete do systému rýchlo pridať niekoľko sklíčok.

Panely sa môžu používať iba pre bežné sklíčka s jedným farbením a paralelné multiplexové sklíčka; nemôžu sa použiť na nastavenie sklíčok na sekvenčné farbenie. Na vytváranie panelov musíte mať úlohu používateľa – dohliadajúci.

Ak chcete zobraziť obrazovku **Reagent Panels** (Panely reagensí), kliknite na ikonu **Reagent setup** (Nastavenie reagensie) na paneli funkcií a potom kliknite na kartu **Panels** (Panely).

Viac informácií nájdete nasledujúcich častiach:

- [8.4.1 Vytvorenie panela](#)
- [8.4.2 Zobrazenie alebo úprava detailov panela](#)
- [8.4.3 Odstránenie panela](#)


8.4.1 Vytvorenie panela

Ak chcete vytvoriť panel, postupujte nasledovne (musíte mať úlohu používateľa – dohliadajúci):






- 1 Kliknite na položku **Add panel** (Pridať panel).

Softvér zobrazí dialógové okno **Reagent panel properties** (Vlastnosti panelu reagensí).

Obrázok 8-7: Dialógové okno **Reagent panel properties** (Vlastnosti panelu reagensí)

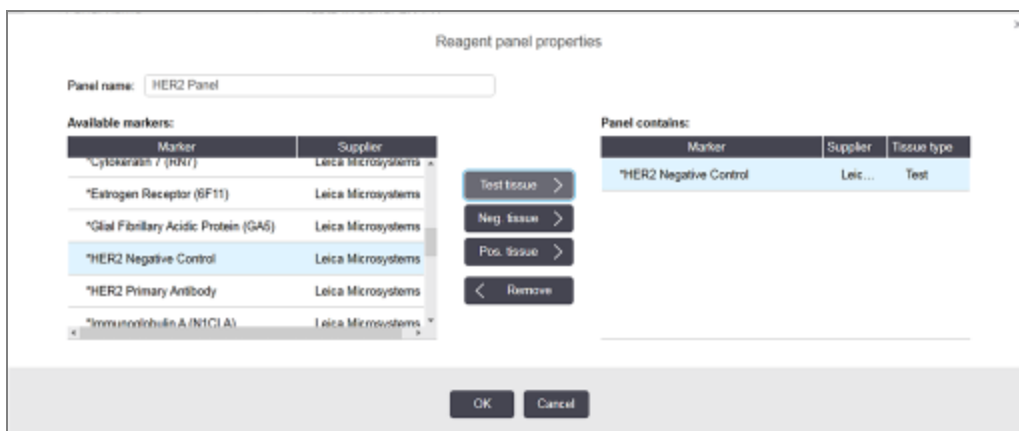

Tabuľka napravo od dialógového okna **Reagent panel properties** (Vlastnosti panelu reagensí) zobrazuje obsah panela a tabuľka vľavo uvádza všetky dostupné značkovače.

- 2 Do poľa **Panel name** (Názov panela) v hornej časti dialógového okna zadajte názov panela.
Panel nemôžete uložiť bez názvu.
 - 3 Ak chcete pridať značkovač do panela, vyberte položku v zozname dostupných protilátok alebo sond v tabuľke vľavo a potom kliknite na položku .
Ak chcete pridať pozitívnu kontrolnú vzorku tkaniva, kliknite na značkovač a potom na položku .
Ak chcete pridať negatívnu kontrolnú vzorku tkaniva, kliknite na značkovač a potom na položku .
 - 4 Ak chcete položku z panela odstrániť, označte ju v tabuľke vpravo a kliknite na položku .
-  Panely musia mať testovacie tkanivo. Nemôžete uložiť panel, ktorý nemá testovacie tkanivo.
- 5 Keď je panel správny, kliknite na položku **OK** (V poriadku), vďaka čomu uložíte údaje.
Ak nechcete panel uložiť, kliknite na položku **Cancel** (Zrušiť).

8.4.2 Zobrazenie alebo úprava detailov panela

Ak chcete zobraziť podrobnosti o paneli, vyberte ho v tabuľke na ľavej strane obrazovky **Reagent Panels** (Panely reagencií). Značkovače na paneli sa zobrazia v tabuľke na pravej strane obrazovky. Ak chcete panel upraviť, kliknite na ikonu **Panel properties** (Vlastnosti panela) a upravte ho podľa opisu v časti [8.4.1 Vytvorenie panela](#) (Vytvorenie panela).

8.4.3 Odstránenie panela

Ak chcete odstrániť panel zo systému, vyberte ho v tabuľke na obrazovke **Reagent Panels** (Panely reagencií) a potom kliknite na možnosť **Remove panel** (Odstrániť panel). Zobrazí sa výzva na potvrdenie odstránenia.



Panely odstraňujte opatrne. Údaje z odstránených panelov nemôžete obnoviť.

9

História sklíčok (na riadiacom zariadení BOND)

Obrazovka **Slide history** (História sklíčok) zobrazuje podrobnosti o sklíčkach, ktoré sú naplánované, aktuálne spustené alebo už boli spustené na systéme BOND.

Cykly, ktoré boli naplánované, ale boli zastavené pred spustením spracovania (odmoknutím podnosu), majú svoje jednotlivé záznamy sklíčok odstránené zo zoznamu histórie a nahradené jedným riadkom pre celý podnos, zobrazujúci stav „Rejected“ (Odmietnuté). Pre tieto cykly je možné vygenerovať udalosti cyklu a správy s údajmi o cykle.

Táto kapitola má nasledujúce časti:

- [9.1 Obrazovka histórie sklíčok](#)
- [9.2 Výber sklíčok](#)
- [9.3 Vlastnosti sklíčka a opätovné spustenie sklíčka](#)
- [9.4 Správa o udalostiach cyklu](#)
- [9.5 Správa s údajmi o cykle](#)
- [9.6 Správa o prípade](#)
- [9.7 Správa protokolu](#)
- [9.8 Súhrn sklíčok](#)
- [9.9 Export údajov](#)
- [9.10 Stručná história sklíčok](#)

9.1 Obrazovka histórie sklíčok

Ak chcete zobrazit' podrobnosti histórie sklíčok alebo generovať udalosti cyklu, podrobnosti cyklu alebo správy o prípadoch, vyberte ikonu **Slide history** (História sklíčok) na paneli funkcií.



Obrázok 9-1: Obrazovka Slide history (História sklíčok)

Slide history

Slide filters: Date range: From: 01-Jan-13 9:46 AM To: 05-Apr-17 9:46 AM [Lihat seven days](#) [Apply](#)

Process date	Run ID	Slide ID	Marker	Patient name	Case ID	Type	Status
27-Aug-13	84	0000288	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000289	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000241	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000291	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000292	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000290	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000293	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000294	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000295	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
27-Aug-13	84	0000296	*Neg	Chirs P. Bacon	CS205 - 255790	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000399	*CD5	Cherry Dale	CS3225 - 527991	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000398	*Tyros	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000396	*CD20	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000395	*CD5	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000394	*Tyros	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000391	*CD5	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000400	*CD20	Cherry Dale	CS3225 - 527991	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000397	*MeIA	Jacob Dean	CS3225 - 527990	Test	In progress
26-Aug-13	90	0000393	*MeIA	Amanda Francis	CS3224 - 527909	Test	In progress

Run ID numbers may not increment sequentially

[Slides summary](#)
[Export data](#)
[Brief slide history](#)
[Slide properties](#)
[Run events](#)
[Run details](#)
[Case report](#)
[Protocol report](#)

Zoznam histórie sklíčok zobrazuje sklíčka spustené v období definovanom vo filtri **Date range** (Rozsah dátumov) nad zoznamom alebo konkrétne sklíčko nájdené pomocou filtra **Slide ID** (Identifikátor sklíčka) (pozrite si časť **9.2 Výber sklíčok**).

Upozorňujeme, že číselný identifikátor cyklu zobrazený na obrazovke sa nemusí zvyšovať po jednom čísle. V prípade modulov spracovania BOND-III a BOND-MAX sa identifikačné čísla cyklov pridelujú, keď sú podnosy na sklíčka uzamknuté, takže ak je podnos uzamknutý, odomknutý a potom znovu uzamknutý (pred spustením cyklu), prírastky čísel identifikátora sa zvýšia a číslo pridelené po prvom uzamknutí sa preskočí.

V prípade modulu spracovania BOND-PRIME je každému sklíčku pridelené identifikačné číslo cyklu.

Farebné značenie sklíčok zodpovedá farbe použitej na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) (pozrite si časť **6.5.1 Opis polí sklíčka a kontrol**):

- Biela: sklíčko vytvorené v dialógovom okne **Add slide** (Pridanie sklíčka)
- Žltá: sklíčka vytvorené v dialógovom okne **Slide identification** (Identifikácia sklíčka) (pozrite si časť **6.8 Improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu**)
- Svetlosivá: Sklíčka LIS
- Červené: prioritné sklíčka LIS (pozrite si časť **11.2.5 Prioritné sklíčka**)

Každé sklíčko má v zozname uvedené nasledujúce hodnoty:

- Dátum spracovania (začatie spracovania sklíčka)
- Identifikátor cyklu
- Slide ID (ID sklíčka)
- Značkovač (názov primárnej protilátky alebo sondy)
- Meno pacienta
- Case ID (Identifikátor prípadu)
- Typ (testovacie tkanivo alebo pozitívna alebo negatívna kontrolné tkanivo)
- Stav (prebieha alebo dokončené, či boli zaznamenané nejaké neočakávané udalosti; prípadne stav „Rejected“ (Odmietnuté) pre cykly, ktoré boli zastavené pred začiatkom spracovania)



Ak je stav **Done (notification)** (Hotovo (oznámenie)), prezrite si správu správa o udalostiach cyklu a zistite, či neočakávané udalosti mohli ovplyvniť farbenie. Neočakávané udalosti sú zobrazené tučným písmom.


Ak chcete zobraziť informácie o sklíčku, vyberte ju v zozname a potom kliknite na jedno z tlačidiel pod zoznamom.

9.2 Výber sklíčok

Filtrujte sklíčka do zoznamu na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) zobrazením všetkých sklíčok spracovaných v definovanom období alebo zobrazte konkrétne sklíčko zadaním ID daného sklíčka. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte filter sklíčok, ktorý chcete použiť.

Posuvný rozsahu dátumov

Obrázok 9-2: Posuvný rozsahu dátumov

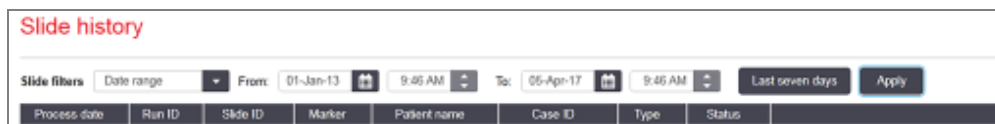

Použite posuvný filter **Date range** (Rozsah dátumov) na špecifikáciu obdobia prehľadu obrazovky. Zobrazia sa iba sklíčka spracované v danom období. Nastavte dátumy „From“ (Od) a „To“ (Do) a v prípade potreby časy na definovanie časového obdobia, ktoré sa má zobraziť. Potom kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť) na zobrazenie sklíčok.

Ak bolo v definovanom období spracovaných viac ako 1 000 sklíčok, zobrazí sa iba prvých 1 000 sklíčok. Ak chcete zobraziť podrobnosti o kompletom súbore, musíte exportovať údaje sklíčka – pozrite si časť [9.9 Export údajov](#).

Pole **To** (Do) je pôvodne nastavené na aktuálny dátum a pole **From** (Od) presne na jeden týždeň v minulosti. Ak zmeníte nastavenia, môžete sa vrátiť na túto konfiguráciu kliknutím na tlačidlo **Last seven days** (Posledných sedem dní).

Použitie výberov dátumu a času

Ak chcete nastaviť deň, mesiac a rok, kliknite na ikonu kalendára a vyberte dátum. Prechádzajte mesiacmi klikaním na šípky v záhlaví kalendára. Alebo kliknite do stredu lišty s nadpisom a vyberte iný mesiac alebo prechádzajte rokmi. Prípadne môžete zadať dátum priamo do poľa.

Ak chcete nastaviť čas, kliknite do poľa času a použite tlačidlá nahor a nadol (alebo klávesy so šípkami nahor a nadol). V závislosti od umiestnenia kurzora sa čas zmení o jednu hodinu, desať minút alebo jednu minútu. Prípadne môžete zadať dátum priamo do poľa.

Filter identifikátorov sklíčok

Použite filter sklíčok **Slide ID** (Identifikátor sklíčka) na vyhľadanie informácií o konkrétnom sklíčku. Zadajte identifikátor sklíčka do poľa **Slide ID** (Identifikátor sklíčka) a kliknite na položku **Apply** (Použiť).

9.3 Vlastnosti sklíčka a opätovné spustenie sklíčka

Ak chcete zobrazíť vlastnosti sklíčka v zozname **Slide history** (História sklíčok), vyberte sklíčko a kliknite na možnosť **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka) (alebo dvakrát kliknite). Toto je rovnaké otvorené dialógové okno ako na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka) (6.5.4 Úpravy sklíčka).

V dialógovom okne **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka) nemôžete upravovať žiadne údaje o pacientovi ani údaje o teste, keď je otvorené z obrazovky **Slide history** (História sklíčok) (keďže sklíčko bolo spracované alebo je spracovávané), ale môžete pridať komentáre do poľa **Comments** (Komentáre) alebo opakovane spustiť sklíčka – pozrite si časť 9.3.1 Opätovné spustenie sklíčok.

9.3.1 Opätovné spustenie sklíčok

Ak sklíčko nespĺňa požiadavky, môže byť označené ako určenie na opakovanie. Použite nasledujúci postup na začatie opätovného spustenia sklíčka z dialógového okna **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka):

- 1 Kliknite na položku **Copy slide** (Kopírovať sklíčko).
Dialógové okno **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka) sa zmení na dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka) s editovateľnými poľami.
- 2 Vykonajte všetky požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo **Add slide** (Pridať sklíčko).
- 3 Potvrďte prípad, pacienta a lekára, aby skopírované sklíčko pridalo sklíčko na obrazovku **Slide setup** (Nastavenie sklíčka).
Dialógové okno **Add slide** (Pridanie sklíčka) zostane otvorené, aby ste v prípade potreby mohli pridať ďalšie sklíčka.
- 4 Kliknite na možnosť **Close** (Zavrieť) a vráťte sa na obrazovku **Slide history** (História sklíčok).
- 5 Novo vytvorené sklíčka spustíte bežným spôsobom.

9.4 Správa o udalostiach cyklu

Táto správa vygenerovaná na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) zobrazuje všetky udalosti pre všetky sklíčka na podnose, s ktorými bolo vybrané sklíčko spustené. Kliknite na možnosť **Run events** (Udalosti cyklu) na vygenerovanie správy.

V prípade modulu spracovania BOND-PRIME sa v správe zobrazujú udalosti pre jednotlivé sklíčka.

V prípade systémov BOND-III alebo BOND-MAX sa správy o udalostiach cyklu môžu generovať aj počas spracovania sklíčok. Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný cyklus alebo zoznam na obrazovke **System status** (Stav systému) alebo **Protocol status** (Stav protokolu) a z ponuky vyberte možnosť **Run events** (Udalosti cyklu). Udalosti, ktoré spustili oznámenie o sklíčku, sú zobrazené tučným písmom, aby ich bolo možné ľahko nájsť.

V pravom hornom rohu správy o udalostiach cyklu sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
PM Serial No. (Sériové číslo PM)	Sériové číslo modulu spracovania použitého pre cyklus
Modul spracovania	Názov modulu spracovania použitého pre cyklus
Slide tray (Podnos na sklíčka)	Číslo zostavy na farbenie sklíčok (v rámci systému BOND-III alebo BOND-MAX) použitej pre cyklus
Modul ARC	Číslo modulu ARC BOND-PRIME použitého pre cyklus (len BOND-PRIME)
Dispense volume (Dávkovací objem)	Objem dávkovanej reagensie (pozrite si časť 6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach)
Start time (Čas spustenia)	Dátum a čas spustenia cyklu
Run progress (Priebeh cyklu)	Informácia o tom, či je beh dokončený, alebo sa stále spracováva
Staining mode (Režim farbenia)	Použitý režim farbenia, napríklad Single routine (Jeden postup)

Obrázky štítkov sklíčok pre všetky sklíčka v cykle sa zobrazujú v hornej časti správy. Telo správy zobrazuje čas, číslo udalosti a popis udalosti pre cyklus. Číslo udalosti používa spoločnosť Leica Biosystems na sledovanie chýb v prípade potreby.

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlačí.

9.5 Správa s údajmi o cykle

Táto správa generovaná na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) zobrazuje detaily každého sklíčka na rovnakom podnose ako aktuálne vybrané sklíčko. Podnos musí mať dokončené spracovanie a musí byť odomknutý. Kliknite na možnosť **Run details** (Spustiť podrobnosti) na vygenerovanie správy. V pravom hornom rohu správy sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
PM Serial No. (Sériové číslo PM)	Sériové číslo modulu spracovania použitého pre cyklus
PM name (Názov PM)	Názov modulu spracovania použitého pre cyklus
Slide tray (Podnos na sklíčka)	Číslo zostavy na farbenie sklíčok (v rámci systému BOND-III alebo BOND-MAX) použitej pre cyklus
Staining location (Miesto farbenia)	Číslo modulu ARC BOND-PRIME použitého pre cyklus (len BOND-PRIME)
Start time (Čas spustenia)	Dátum a čas spustenia cyklu
Run started by (Cyklus spustil)	Používateľské meno osoby, ktorá spustila cyklus
Slide loaded by (Sklíčko vložil/-a)	Používateľské meno osoby, ktorá vložila sklíčko (len BOND-PRIME)
Slide unloaded by (Sklíčko vyložil/-a)	Používateľské meno osoby, ktorá vyložila sklíčko (len BOND-PRIME)

Pre každé sklíčko v cykle telo správy zobrazuje snímku štítku sklíčka a nasledujúce informácie.

Pole	Opis
Slide ID (ID sklíčka)	Systém BOND priradí ku každému sklíčku jedinečný identifikátor.
Slide created by (Sklíčko vytvoril)	Používateľské meno osoby, ktorá vytvorila sklíčko, prípadne „LIS“
Case No. (Prípad č.)	Jedinečný identifikátor prípadu vygenerovaný softvérom BOND
Tissue type (Typ tkaniva)	Testovacie tkanivo, tkanivo pozitívnej kontroly alebo tkanivo negatívnej kontroly
Dispense volume (Dávkovací objem)	Objem dávkovanej reagentie (pozrite si časť 6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach)
Meno pacienta	Identifikácia pacienta
Case ID (Identifikátor prípadu)	Identifikácia prípadu zadaná počas nastavenia sklíčka

Pole	Opis
Staining protocol (Protokol farbenia)	Použitý protokol farbenia
Preparation (Príprava)	Použitý protokol prípravy (ak existuje)
HIER protocol (Protokol HIER)	Použitý protokol HIER (ak existuje)
Enzyme protocol (Protokol enzýmu)	Použitý protokol získavania enzýmom (ak existuje)
Denaturácia	Iba pre ISH, použitý denaturačný protokol (ak existuje)
Hybridizácia	Iba pre ISH, použitý hybridizačný protokol (ak existuje)
Referencia LIS [2 – 7]	Dodatočné referenčné informácie o systéme LIS pre systémy s nainštalovaným balíkom LIS-ip (pozrite si časť 11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS)
Farbenie	Použitý režim farbenia, napríklad Single routine (Jeden postup)
Completion status (Stav dokončenia)	Označuje, či sa sklíčko spracováva, dokončuje alebo už bolo vyhodnotené. Tiež to, či boli hlásené nejaké oznámenia udalosti.
Komentáre	Komentáre môžete kedykoľvek zadať do vlastností sklíčka
Sign off: (Schválenie:)	Schválenie je vyhradené miesto v tlačenej papierovej správe, kde môže dohliadajúci schváliť každé sklíčko.
Použité reagenty (alebo preferovaná súprava obsahujúca zložky zmiešanej reagenty)	
UPI (jedinečný identifikátor balenia)	Jedinečný identifikátor balenia každej reagenty alebo preferovanej súpravy použitej pre toto sklíčko
Názov	Názov každej reagenty alebo preferovanej súpravy použitej pre toto sklíčko
Public name (Verejný názov)	Verejný názov pre systémy s nainštalovaným LIS-ip
Lot No. (Č. šarže)	Číslo šarže každej reagenty alebo preferovanej súpravy použitej pre toto sklíčko Čísla šarží nebalených reagentí sú zahrnuté pre systém BOND-PRIME
Expiration Date (Dátum expirácie)	Dátum expirácie každej reagenty alebo pomocnej súpravy použitej pre toto sklíčko

Pozrite si časť **3.7 Správa** pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

9.6 Správa o prípade

Táto správa zobrazuje detaily každého sklíčka v rovnakom prípade ako aktuálne vybrané sklíčko. Správa môže byť vygenerovaná z obrazovky **Slide setup** (Nastavenie sklíčka), **Slide history** (História sklíčok) a dialógového okna **Slide identification** (Identifikácia sklíčka). V pravom hornom rohu správy o prípade sú uvedené informácie v nasledujúcej tabuľke:

Pole	Opis
Case ID (Identifikátor prípadu)	Identifikácia prípadu zadaná počas nastavenia sklíčka
Meno pacienta	Meno pacienta
Case comments (Komentáre k prípadu)	Ďalšie informácie o prípade
Doctor (Lekár)	Meno lekára alebo odporúčajúceho patológa zodpovedného za pacienta.
Doctor comments (Komentáre lekára)	Ďalšie informácie lekára
Created (Vytvorené)	Dátum a čas, kedy bol prípad vytvorený
Case No. (Prípad č.)	Jedinečný identifikátor prípadu vygenerovaný systémom BOND

V pravom hornom rohu správy sú uvedené informácie pre každé sklíčko v prípade:

Pole	Opis
Slide ID (ID sklíčka)	Systém BOND priradí ku každému sklíčku jedinečný identifikátor.
Slide created by (Sklíčko vytvoril)	Používateľské meno osoby, ktorá vytvorila sklíčko, prípadne „LIS“.
Run (Cyklus)	Číslo cyklu, v ktorom bolo sklíčko spracované
Run started by (Cyklus spustil)	Používateľské meno osoby, ktorá spustila cyklus
Tissue type (Typ tkaniva)	Testovacie tkanivo, tkanivo pozitívnej kontroly alebo tkanivo negatívnej kontroly
Dispense volume (Dávkovací objem)	Objem dávkovanej reagentie (pozrite si časť 6.5.8 Objemy dávkovania a pozícia tkanív na sklíčkach)
Staining protocol (Protokol farbenia)	Použitý protokol farbenia
Preparation (Príprava)	Použitý protokol prípravy (ak existuje)
HIER protocol (Protokol HIER)	Použitý protokol HIER (ak existuje)

Pole	Opis
Enzyme protocol (Protokol enzýmu)	Použitý protokol získavania enzýmom (ak existuje)
Denaturácia	Iba pre ISH, použitý denaturačný protokol (ak existuje)
Hybridizácia	Iba pre ISH, použitý hybridizačný protokol (ak existuje)
LIS reference (Referencia LIS) (2 – 7)	Dodatočné referenčné informácie o systéme LIS pre systémy s nainštalovaným balíkom LIS-ip (pozrite si časť 11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS)
Farbenie	Použitý režim farbenia, napríklad Single routine (Jeden postup)
PM Serial No (Sériové číslo PM)	Sériové číslo modulu spracovania použitého pre sklíčko (len BOND-PRIME)
Staining Location (Miesto farbenia)	Poloha, v ktorej bolo sklíčko spracované (len BOND-PRIME)
Completion status (Stav dokončenia)	Označuje, či sa sklíčko spracováva, dokončuje alebo už bolo vyhodnotené. Tiež to, či boli hlásené nejaké oznámenia udalosti.
Komentáre	Komentáre môžete kedykoľvek zadať do vlastností sklíčka
Sign off: (Schválenie:)	Schválenie je vyhradené miesto v tlačenej papierovej správe, kde môže dohliadajúci schváliť hodnotenie a komentáre
Reagents Used (Použité reagentie)	
UPI (jedinečný identifikátor balenia)	Jedinečný identifikátor balenia každej reagentie použitej pre toto sklíčko
Názov	Názov každej reagentie použitej pre toto sklíčko
Public name (Verejný názov)	Verejný názov pre systémy s nainštalovaným LIS-ip
Lot No. (Č. šarže)	Číslo šarže každej reagentie použitého pre toto sklíčko Čísla šarží nebalených reagentií sú zahrnuté pre systém BOND-PRIME
Expiration Date (Dátum expirácie)	Dátum expirácie každej reagentie použitej pre toto sklíčko

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

9.7 Správa protokolu

Ak chcete vygenerovať správy o protokoloch použitých pre vybrané sklíčka, vyberte sklíčko a kliknite na tlačidlo **Protocol report** (Správa protokolu). Vyberte požadovaný protokol z tých, ktoré chcete spustiť na sklíčku, a potom kliknite na tlačidlo **Report** (Správa) na vytvorenie správy. Opis správy si pozrite v časti [7.5 Správa protokolu](#).

9.8 Súhrn sklíčok

Zhrnutie spracovania sklíčka zobrazuje počet sklíčok spustených v stanovenom období. Informácie sa zobrazujú v tabuľkovom aj grafickom formáte ako počet spracovaných sklíčok za jednotku času v stanovenom období.

Ak chcete nahlásiť počet spracovaných sklíčok, kliknite na tlačidlo **Slides summary** (Súhrn sklíčok) na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) a otvorte dialógové okno **Slides summary** (Súhrn sklíčok).

Vyberte buď konkrétny modul spracovania podľa názvu alebo možnosť **All** (Všetky) (všetky moduly spracovania alebo v systéme BOND-ADVANCE všetky moduly spracovania, ku ktorému je klient aktuálne pripojený) z rozbaľovacieho zoznamu **Processing module** (Modul spracovania).

V poli **Resolution** (Rozlíšenie) vyberte časovú jednotku, ktorá sa má použiť na nahlásenie počtu spustených sklíčok. Napríklad možnosť „Day“ (Deň) vygeneruje správu, ktorá zobrazuje počet sklíčok spustených každý deň v stanovenom časovom období, zatiaľ čo možnosť „Month“ (Mesiac) predstavuje počet sklíčok spustených každý mesiac v rámci daného obdobia.

Nastavte dátumy **To** (Do) a **From** (Od). Jednotka času nastavená v poli **Resolution** (Rozlíšenie) začína od dátumu **From** (Od) a pokračuje v celých jednotkách až do dátumu **To** (Do), kde sa na dokončenie obdobia môže vyžadovať čiastočná jednotka.

Kliknutím na možnosť **Generate** (Generovať) zobrazíte ukážku správy.

Pozrite si časť [3.7 Správa](#) pre ďalšie informácie o okne správy a možnostiach tlače.

9.9 Export údajov

Na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) kliknite na tlačidlo **Export data** (Export údajov) na vytvorenie súboru obsahujúceho podrobnosti o všetkých sklíčkach, ktoré dokončili spracovanie vo vybranom časovom období. Exportovaný súbor je v štandardnom formáte súboru „hodnoty oddelené čiarkami“ (comma separated values, csv) a súbor je možné ľahko importovať do tabuľkových aplikácií tretej strany, ako je Microsoft Excel. Po importovaní do tabuľky sa údaje zobrazia vo formáte, ktorý umožňuje (v závislosti od funkčnosti tabuľky) triedenie, vyhľadávanie a vytváranie prispôbených zostáv a grafov.

Pre každé sklíčko vo vybratom rozsahu dátumov sa do exportovaného súboru zahrnú nasledujúce informácie:

- Dátum spracovania
- Sériové číslo PM
- Slide ID (ID sklíčka)
- Run started by (Cyklus spustil)
- UPI značkovača
- UPI 2 značkovača
- Meno pacienta
- Typ tkaniva (test alebo pozitívna alebo negatívna kontrolná vzorka)
- Stav
- Komentáre
- Názov protokolu prípravy
- Názov protokolu HIER
- Názov protokolu HIER 2
- Názov protokolu enzýmu
- Názov protokolu enzýmu 2
- Názov denaturačného protokolu
- Názov denaturačného protokolu 2
- Názov protokolu hybridizácie
- Názov protokolu hybridizácie 2
- Názov protokolu farbenia
- Názov protokolu farbenia 2
- Názov detekčného systému
- Názov detekčného systému 2
- Názov modulu spracovania
- Identifikátor cyklu
- Slide created by (Sklíčko vytvoril)
- Farbenie
- Názov značkovača
- Názov značkovača 2
- Case ID (Identifikátor prípadu)
- Doctor (Lekár)
- Dispense volume (Dávkovací objem)
- Verzia protokolu prípravy
- Verzia protokolu HIER
- Verzia protokolu HIER 2
- Verzia protokolu enzýmu
- Verzia protokolu enzýmu 2
- Verzia denaturačného protokolu
- Verzia denaturačného protokolu 2
- Verzia protokolu hybridizácie
- Verzia protokolu hybridizácie 2
- Verzia protokolu farbenia
- Verzia protokolu farbenia 2
- Sériové číslo detekčného systému
- Sériové číslo detekčného systému 2

Stĺpce s číslom 2 v názve sú relevantné iba pre sekvenčné multiplexové farbenie sklíčka; definujú informácie týkajúce sa druhého farbenia pre toto sklíčko.

Na export podrobností o sklíčku použijete nasledujúci postup:

- 1 Vyberte požadovaný rozsah dátumov (pozrite si časť **9.2 Výber sklíčok**).
- 2 Kliknite na možnosť **Export data** (Export údajov).
- 3 Po výzve vyberte možnosť uloženia súboru.


Súbor sa uloží do priečinka na sťahovanie (alebo vyberte možnosť **Save as** (Uložiť ako) na uloženie do iného priečinka.

Uložený súbor je možné otvoriť v štandardnom tabuľkovom procesore, ako je Microsoft Excel, a manipulovať s ním podľa funkcií dostupných v aplikácii. Pri otváraní súboru bude možno potrebné zadať niektoré parametre súboru.

Súbor je vo formáte „csv“, parametre sú nasledujúce:

- Typ súboru je **Delimited** (S oddelenými údajmi)
- Možnosti **Delimiter** (Oddeľovač) alebo **Separator** (Oddeľovač) sú **Comma** (Čiarka).
- Použite formát stĺpcov **General** (Všeobecný).



Čas spustenia spracovania v exportovaných detailoch sklíčka sa nebude presne zhodovať s časom spustenia v rámci histórie sklíčka na obrazovke. Čas spustenia zobrazený na obrazovke s históriou sklíčok je čas, kedy bolo stlačené tlačidlo spustenia cyklu . Čas nahlásený v exportovaných údajoch je však čas, kedy sa proces skutočne začal spracovávať na module spracovania.

9.10 Stručná história sklíčok

Stručná správa o histórii sklíčok zobrazuje informácie o všetkých sklíčkach v súbore, ktoré boli spracované (alebo sa stále spracúvajú) v časovom rámci použitom na výber sklíčok na obrazovke **Slide history** (História sklíčok). Správa obsahuje oblasť na odhlásenie a môže sa použiť ako záznam spracovaných sklíčok.

Ak chcete vytvoriť krátku správu histórie sklíčok, otvorte obrazovku **Slide history** (História sklíčok) a nastavte dátumy a časy **From** (Od) a **To** (Do), na vyplnenie obrazovky so všetkými sklíčkami v súbore, ktoré boli spracované v tom čase (pozrite si časť **9.2 Výber sklíčok** (Výber sklíčok)). Kliknite na možnosť **Brief slide history** (Stručná história sklíčok) na vygenerovanie správy.



V laboratóriách s vysokými obratmi môže predvolený časový rozsah na obrazovke **Slide history** (História sklíčok) (jeden týždeň) obsahovať tisíce sklíčok. Vytvorenie prehľadu pre tento počet sklíčok bude trvať niekoľko minút – namiesto akceptovania predvoleného nastavenia zvážte definovanie kratších časových rozsahov.

Správa obsahuje nasledujúce podrobnosti pre každé sklíčko:

- Case ID (Identifikátor prípadu)
- Tissue type (Typ tkaniva)
- Meno pacienta
- Dispense volume (Dávkovací objem)
- Slide ID (ID sklíčka)
- Stav
- Marker (Značkovač)
- Schválenie
- Miesto farbenia (len BOND-PRIME)

10 Klient správy (na riadiacom zariadení BOND)

Všetky všeobecné konfigurácie systému BOND (okrem protokolov a reagensí) sa vykonávajú v samostatnej softvérovej aplikácii „klient správy“. Klienta správy môžu spúšťať iba používatelia s úlohou správcu, ak majú k dispozícii všetky funkcie.

Klient správy má nasledujúce obrazovky otvorené pomocou ikon na paneli funkcií v hornej časti klienta:



- [10.1 Users \(Používatelia\)](#)
- [10.2 LIS \(Laboratórny informačný systém\)](#)
- [10.3 Labels \(Štítky\)](#)
- [10.4 BDD](#)
- [10.5 Nastavenia](#)
- [10.6 Hardvér](#)


10.1 Users (Používatelia)

Používatelia systému BOND sa spravujú v klientovi správy na obrazovke **User management** (Správa používateľov). Môžete vytvárať, upravovať a deaktivovať používateľov. Nemôžete vymazať používateľov – zostanú navždy v systéme. Používateľov však môžete zakázať a zakázať im prístup k jednému z klientov.



Povolení používatelia majú úlohy, ktoré im poskytujú rôzne práva v rámci softvéru. Klienta správy môžu otvoriť iba používatelia s úlohou správcu (kde môžu vykonávať všetky funkcie). Používatelia s úlohou operátora môžu registrovať reagentie, nastavovať a spracovávať sklíčka a generovať správy, ale nemôžu upravovať podrobnosti o reagentiách, panely reagentií ani protokoly. Používatelia s úlohou dohliadajúceho majú všetky práva operátora, ale môžu tiež upravovať podrobnosti o reagentii, panely a protokoly. Používatelia môžu mať viac ako jednu úlohu.

Obrázok 10-1: Obrazovka **User management** (Správa užívateľov)

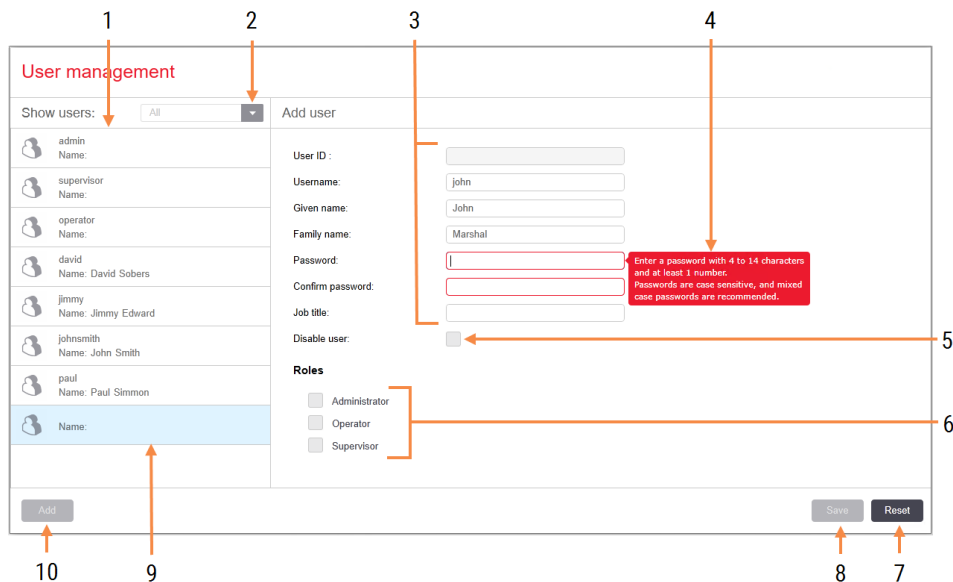

Legenda

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Zoznam všetkých používateľov systému BOND | 7 | Reset (Obnoviť)
Vrátenie neuložených zmien |
| 2 | Pomocou filtrovania môžete zobrazíť všetkých používateľov alebo iba povolených alebo zakázaných používateľov | 8 | Save (Uložiť)
Uloženie zmien pre aktuálneho používateľa |
| 3 | Detaily o vybranom používateľovi | 9 | Aktuálne vybraný používateľ – jeho detaily sú zobrazené v pravej časti obrazovky. |
| 4 | Správa s požiadavkami na heslo | 10 | Add (Pridať)
Kliknutím zrušíte začiarknutie políček na pravej strane obrazovky a pridajte podrobnosti o novom používateľovi |
| 5 | Disable user (Zakázať používateľa)
Zakáže (alebo znova povolí) aktuálne vybraného používateľa | | |
| 6 | Roles (Úlohy)
Výber úloh používateľa | | |

Každý nový používateľ vyžaduje používateľské meno a heslo. Obidve sa vyžadujú na prihlásenie sa ku klinickému klientovi a klientovi správy. Po vytvorení používateľa už nie je možné zmeniť meno používateľa, ale heslo možno zmeniť. Používatelia si môžu kedykoľvek zmeniť svoje vlastné heslá v prihlasovacích dialógových oknách BOND a správcovia ich tiež môžu zmeniť na obrazovke **User management** (Správa používateľov). Heslá musia mať 4 až 14 znakov a musia obsahovať aspoň jedno číslo.



Heslá rozlišujú malé a veľké písmená a odporúčajú sa heslá s veľkými aj malými písmenami. Softvér BOND overuje heslá pri ich zmene. Heslo nemôžete uložiť, kým nespĺňa minimálne požiadavky. Heslá neposkytujte ostatným zamestnancom. Vždy, keď ste mimo modulu spracovania, odhláste sa z účtu.

Ostatné údaje o používateľovi (krstné meno a priezvisko a názov úlohy) sú voliteľné. Tieto údaje sa objavujú v protokoloch a správach. ID používateľa sa priradí automaticky a zobrazí sa v denníkoch a správach.

10.2 LIS (Laboratórny informačný systém)

Väčšinu konfigurácie systému LIS vykonáva servisný personál, keď je systém BOND LIS-ip nainštalovaný, používatelia však majú k dispozícii malý počet možností konfigurácie na obrazovke **LIS configuration** (Konfigurácia LIS). Na obrazovke sa nachádza aj protokol chybových správ.



Obrázok 10-2: Obrazovka LIS configuration (Konfigurácia LIS)

Legenda

- | | |
|--|--|
| <p>1 License (Licencia)
Zobrazuje licenčné heslo systému LIS-ip.</p> <p>2 Duplicate case ID (Duplicitný identifikátor prípadu)
Nastavte akciu pre prípady s rovnakým identifikátorom prípadu ako existujúce prípady.</p> <p>3 Force LIS printing in BOND (Vynútená tlač LIS v systéme)
Zabezpečte, aby boli všetky sklíčka LIS vytlačené systémom BOND. Pozrite si časť 11.7 Značkovače sklíčok.</p> <p>4 Enable LIS to update LIS slides (Povoliť systém LIS na aktualizáciu sklíčok LIS)
Prepíšete (aktualizovať) nespracované sklíčka, ak systém LIS odosiela sklíčka s rovnakým identifikátorom čiarového kódu. Ak je toto nastavenie zakázané, systém BOND zamietne akýkoľvek pokus systému LIS o opätovné použitie rovnakého identifikátora čiarového kódu.</p> | <p>5 Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs) (Povoliť nespracovanú životnosť sklíčka LIS (v hodinách))
Vymažte sklíčka prijaté zo systému LIS, ktoré sa nespracovávajú do zadaného počtu hodín.</p> <p>6 Log Messages (Správy denníka)
Po kliknutí na možnosť View log (Zobraziť denník) sa zobrazia ako zoznam (pozrite si časť vpravo).</p> <p>7 Edit LIS data fields (Upraviť dátové polia systému LIS)
Nakonfigurujte zobrazenie údajov sklíčok v systéme BOND.</p> <p>8 View log (Zobraziť denník)
Zobraziť zoznam chýb, ktoré sú výsledkom správ LIS odoslaných do systému BOND, alebo odpovede zo systému BOND na správy LIS. Opätovným kliknutím aktualizujete zoznam o nedávne chyby.</p> |
|--|--|

Licencia

Potrebujete licenciu pre systém BOND LIS-ip, ktorá sa aktivuje pomocou hesla poskytnutého spoločnosťou Leica Biosystems. Heslo zvyčajne zadáva servisný personál, ktorý nastavil pripojenie systému LIS-ip. Ak nie, na obrazovke sa zobrazí pole **License** (Licencia). Ak chcete zapnúť funkciu LIS-ip a zobraziť možnosti konfigurácie a prihlásenia zobrazené na [Obrázok 10-2](#), zadajte heslo.

Duplicitný identifikátor prípadu

Použite nastavenie **Duplicate case ID** (Duplicitný identifikátor prípadu) na nastavenie spôsobu vybavovania prípadov prijatých zo systému LIS s rovnakým identifikátorom prípadu ako expirovaný alebo vymazaný prípad LIS, ktorý sa už nachádza v systéme BOND. (Ak má prípad LIS rovnaký identifikátor prípadu ako existujúci prípad BOND, t. j. prípad vytvorený v systéme BOND, je automaticky odmietnutý.) Existujú dve možnosti:

- **Resurrect existing case** (Obnovenie existujúceho prípadu): po prijatí nového prípadu sa za predpokladu, že má rovnaké meno pacienta ako existujúci prípad, obnoví pôvodný prípad (t. j. opätovne sa použije). Ak nový prípad obsahuje rovnaký identifikátor prípadu, ale iné meno pacienta, potom sa zamietne.

Ak sa meno lekára zmenilo, použije sa nové meno.

- **Reject message** (Odmietnuť správu): nový prípad LIS sa neprevedie do systému BOND. Správa oznamujúca túto skutočnosť sa zaznamená do systému LIS. V systéme LIS musíte zmeniť identifikátor prípadu a prípad znova odoslať.

Diskusiu o spracovaní duplicitných identifikátorov prípadov v prípadoch, ktoré nie sú prípady LIS, nájdete v časti [6.3.4 Duplikácia, obnovenie a expirácia prípadu](#). Všeobecné informácie o prípadoch LIS nájdete v časti [11.2.2 Prípady LIS](#).

Dátové polia sklíčka v LIS

Inštaláciu systému BOND LIS-ip možno nakonfigurovať tak, aby systém LIS odosielať systému BOND až sedem parametrov pre každé sklíčko. Tieto parametre sú určené len na prezeranie a sú zobrazené na karte **LIS** v dialógovom okne **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka). Aj keď základnú konfiguráciu týchto parametrov vykonáva servisný technik, môžete si zvoliť skrytie ktoréhokoľvek z polí parametrov a nastaviť názvy polí.

Začiarknite políčka, ktoré chcete zobraziť, a zadajte názvy polí.

10.3 Labels (Štítky)

Použite obrazovku **Label templates** (Šablóny štítkov) na vytváranie a úpravu šablón štítkov sklíčok a výber šablón, ktoré sa majú použiť.



Existuje osem typov 2D šablón pre použitie s ôsmimi typmi sklíčok v systéme BOND:

- Jedno farbenie BOND,
- BOND Oracle,
- BOND sekvenčné multiplexové farbenie
- BOND paralelné multiplexové farbenie
- Jednoduché farbenie LIS,
- LIS Oracle,
- LIS sekvenčné multiplexové farbenie
- LIS paralelné multiplexové farbenie

Šablóny „BOND“ sú pre sklíčka vytvorené v systéme BOND a šablóny „LIS“ pre sklíčka vytvorené v systéme LIS, ale vytlačené v systéme BOND.

Tieto preddefinované šablóny nie je možné upravovať ani mazať.

Systém BOND dokáže čítať čiarové kódy 1D, 2D a OCR, ale vytvára iba 2D čiarové kódy.

Ak bol systém BONDinovaný z verzie 5.1 alebo staršej, nemôžete naďalej používať existujúci snímač čiarových kódov, pretože tento starší model nepodporuje 2D čiarové kódy.


Ak chcete použiť inú šablónu pre typ sklíčka, skopírujte predvolenú šablónu a upravte výslednú „používateľskú šablónu“. Potom ju „aktivujte“, aby sa stala šablónou, ktorú systém BOND použije pre sklíčka tohto typu. Pre každý typ sklíčka môžete vytvoriť ľubovoľný počet šablón, ale súčasne je možné aktivovať iba jednu.



VÝSTRAHA: Na štítky vždy uvádzajte dostatočné informácie, aby sa zabezpečilo, že v prípade zlyhania automatickej identifikácie štítkov je možné štítky identifikovať ručne. Spoločnosť Leica Biosystems odporúča, aby všetky sklíčka obsahovali nasledujúce polia:

- identifikátor prípadu alebo meno pacienta,
- Slide ID (ID sklíčka)
- typ tkaniva – na identifikáciu kontrolných tkanív; a
- značkovač – primárna prtilátka alebo sonda, ktorá sa má použiť.


Obrázok 10-3: Obrazovka Label templates (Šablóny štítkov)

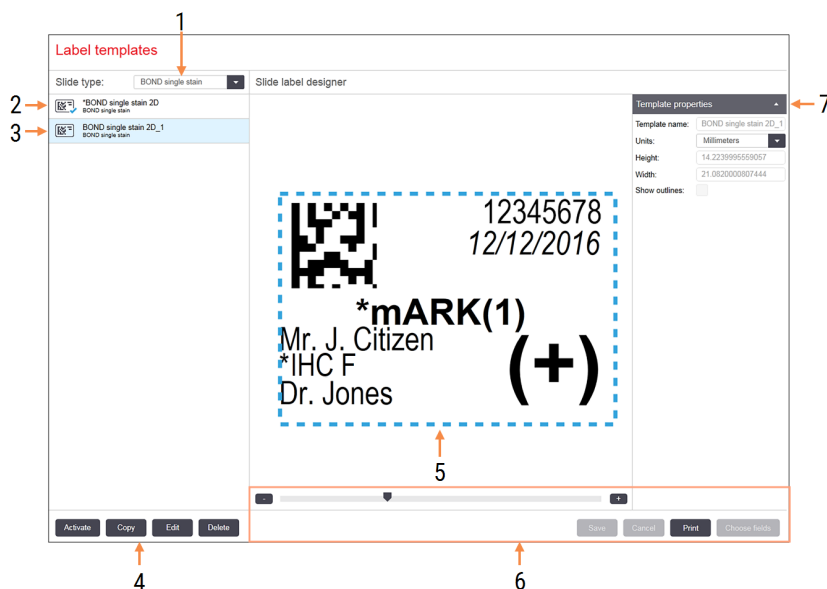

Legenda

- | | |
|--|---|
| <p>1 Slide type (Typ sklíčka)
Vyberte typ sklíčka – všetky šablóny pre daný typ sú zobrazené v podokne nižšie</p> <p>2 Aktívna šablóna (s modrou značkou začiarknutia)</p> <p>3 Vybraná šablóna, ktorá sa zobrazí na table úprav vpravo</p> <p>4 Príkazy správy šablón – pozrite si Obrázok 10-4 Príkazy na správu šablón štítkov</p> | <p>5 Tabla úprav s rozložením šablóny vybratej vľavo</p> <p>6 Príkazy na úpravu šablón – pozrite si Obrázok 10-5 Príkazy na úpravu šablóny štítkov</p> <p>7 Template properties (Vlastnosti šablóny)
Vlastnosti aktuálne vybraného rozloženia šablón ako celku (iba na zobrazenie, kým nekliknete na tlačidlo Edit (Upraviť) v ľavom paneli)</p> |
|--|---|


Obrázok 10-4: Príkazy na správu šablón štítkov

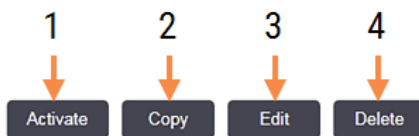

Legenda

- | | |
|--|---|
| <p>1 Nastavte aktuálne vybranú šablónu, ktorá sa použije pre všetky štítky sklíčok pre aktuálne vybraný typ sklíčka.</p> <p>2 Skopírujte aktuálne vybranú šablónu a vytvorte novú „používateľskú“ šablónu.</p> | <p>3 Upravte aktuálne vybranú šablónu pomocou tably úprav a príkazov na pravej strane obrazovky. Predvolené šablóny nie je možné upravovať.</p> <p>4 Odstráňte aktuálne vybranú šablónu. Predvolené šablóny nie je možné vymazať.</p> |
|--|---|

Obrázok 10-5: Príkazy na úpravu šablóny štítkov

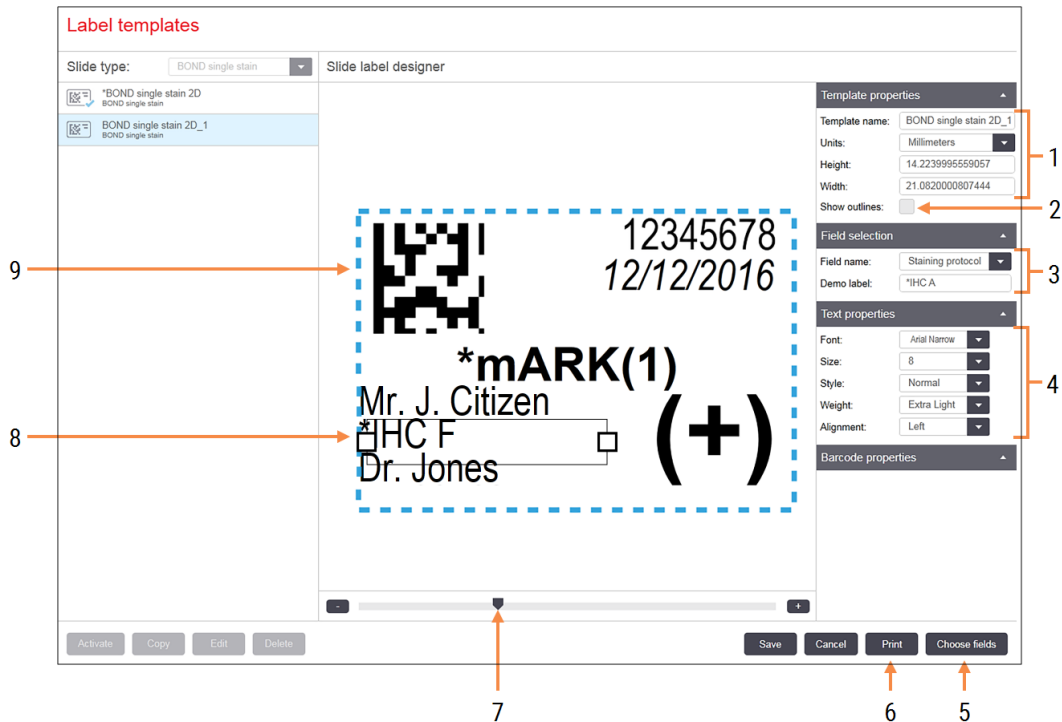

Legenda

- | | |
|---|--|
| <p>1 Template properties (Vlastnosti šablóny)
Zadajte názov a veľkosť šablóny</p> <p>2 Show outlines (Zobraziť obrisy)
Zobrazte obrisy polí na table úprav</p> <p>3 Field selection (Výber poľa)
Vyberte typ poľa na zvýraznenie poľa na table úprav. Do poľa zadajte ukázkový text.</p> <p>4 Text properties (Vlastnosti textu)
Nakonfigurujte vlastnosti textu pre vybrané pole</p> | <p>5 Choose fields (Vybrať polia)
Ak chcete pridať alebo odstrániť polia z rozloženia, otvorte dialógové okno Choose fields (Vybrať polia).</p> <p>6 Print (Vytlačiť)
Vytlačte aktuálne rozloženie na vybranej tlačiarne</p> <p>7 Posuvným ovládaním môžete zväčšiť alebo zmenšiť ukážku ukážky</p> <p>8 Aktuálne vybrané pole – nakonfigurujte na table Text Properties (Vlastnosti textu) napravo. Potiahnutím políčok na jednom konci zmeníte šírku alebo celé pole premiestnite.</p> <p>9 Identifikátor štítkov alebo čiarový kód – nesmie sa zmeniť veľkosť</p> |
|---|--|

Pozrite si tiež:

- [10.3.1 Vytváranie, úprava a aktivácia šablón štítkov](#)
- [10.3.2 Typy informácií](#)

10.3.1 Vytváranie, úprava a aktivácia šablón štítkov

Vytvorte nové šablóny skopírovaním existujúcich a ich úpravou, prípadne môžete upraviť existujúce používateľské šablóny (ale nie predvolené šablóny). Aktivujte šablónu, aby sa stala šablónou používanou pre štítky vytlačené zo systému BOND.

- [10.3.1.1 Vytvorenie novej šablóny](#)
- [10.3.1.2 Úprava šablóny](#)
- [10.3.1.3 Aktivácia šablóny](#)

10.3.1.1 Vytvorenie novej šablóny

- 1 Vyberte typ sklíčka, pre ktoré je nová šablóna určená.
Zobrazia sa všetky existujúce šablóny pre typ sklíčka.
- 2 Vyberte šablónu, ktorú chcete skopírovať (vyberte šablónu, ktorá sa najviac podobá šablóne, ktorú chcete vytvoriť).
- 3 Kliknite na možnosť **Copy** (Kopírovať).



Kopírovaním šablóny s čiarovým kódom 2D sa vytvorí nová „používateľská šablóna“ s čiarovým kódom 2D.

10.3.1.2 Úprava šablóny

- 1 Vyberte šablónu na ľavej table a kliknite na tlačidlo **Edit** (Upraviť).
Tabla úprav, tlačidlá a zoznamy vlastností na pravej strane obrazovky vám umožňujú upravovať rozloženie šablón, ktoré sa zobrazujú na paneli úprav.
- 2 Voliteľne vyberte možnosť **Show outlines** (Zobraziť obrisy) (v časti **Template properties** (Vlastnosti šablóny) (horná časť vpravo hore)), ak chcete zobraziť hranice poľa na table úprav.
- 3 Zadať názov šablóny v časti **Template properties** (Vlastnosti šablóny).



Pre názvy šablón štítkov existuje 64-znakový limit. Všetky názvy používané v rovnakej kategórii typov sklíčok musia byť jedinečné.

4 Upravenie rozloženia:

- a Pridajte alebo odstráňte polia – kliknite na položku **Choose fields** (Vyberať polia) a vyberte vlastnosti sklíčka, ktoré sa majú zobraziť (zoznam všetkých dostupných vlastností si pozrite časti **10.3.2 Typy informácií**).

Upozorňujeme, že nemôžete odstrániť pole **Label ID** (Identifikátor štítka), ktoré sa používa na automatickú identifikáciu.

- b Umiestnite polia – vyberte a presuňte polia na table úprav.
- c Zmeňte šírku polí – presuňte políčka na oboch koncoch polí. (Výška polí sa nastavuje podľa veľkosti písma textu.)

Ak šírka poľa, ktorú nastavíte, nie je pri použití šablóny dostatočne dlhá na hodnotu na konkrétnom štítku, text sa skrúti pripoja sa tri bodky, ktoré signalizujú, že došlo k skráteniu.



Nesmiete zmeniť veľkosť poľa **Label ID** (Identifikátor štítka) – musí zostať v predvolenom nastavení, aby ho bolo možné prečítať pomocou snímača modulu spracovania.

- d Nastavte vlastnosti textu – vyberte pole a nastavte jeho písmo a veľkosť písma, štýl a typ v časti **Text properties** (Vlastnosti textu). V tomto poli tiež nastavte zarovnanie textu.

5 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).



Uistite sa, že okolo poľa **Label ID** (Identifikátor štítka) je voľný priestor. Ak do tejto oblasti zasahuje text z akýchkoľvek iných polí, môže to ovplyvniť automatickú identifikáciu.

10.3.1.3 Aktivácia šablóny

- 1 Vyberte šablónu na ľavej table a kliknite na tlačidlo **Activate** (Aktivovať).

Šablóna je označená modrou značkou, čo znamená, že je teraz aktívna.

10.3.2 Typy informácií

Šablóny štítkov možno nakonfigurovať tak, aby zobrazovali ľubovoľnú z nasledujúcich informácií o štítkoch vybraných z dialógového okna **Choose fields** (Vybrať polia) na obrazovke **Labels** (Štítky).

Pole **Label ID** (Identifikátor štítku), ktoré sa používa na automatickú identifikáciu, nemožno odstrániť zo žiadnej šablóny. Zobrazuje sa ako 2D čiarový kód.

Pole	Opis
Case ID (Identifikátor prípadu)	Identifikátor prípadu pre sklíčko (pozn. nie číslo prípadu – pozrite si časť 6.3.2 Identifikácia prípadu).
Slide created by (Sklíčko vytvoril)	Používateľské meno osoby, ktorá bola prihlásená do klienta pri vytváraní sklíčka, alebo „LIS“.
Denaturation protocol (Denaturačný protokol)	Skrátený názov denaturačného protokolu.
Denaturation protocol 2 (Denaturačný protokol 2)	Skrátený názov druhého denaturačného protokolu (môže sa požadovať pre protokoly s multiplexovým farbením).
Dispense volume (Dávkovací objem)	Dávkovací objem 100µl alebo 150µl.
Doctor comment (Komentár lekára)	Komentár zaznamenaný v systéme BOND pre odporúčajúceho lekára (pozrite si časť 6.4 Správa lekárov).
Doctor (Lekár)	Meno odporúčajúceho lekára.
EIER protocol (Protokol EIER)	Skrátený názov protokolu enzýmov.
EIER protocol 2 (Protokol EIER 2)	Skrátený názov druhého protokolu enzýmov (môže sa požadovať pre protokoly s multiplexovým farbením).
Facility (Zariadenie)	Názov prevádzky, ako je uvedené v poli Facility (Zariadenie) na obrazovke klienta správy Laboratory settings (Laboratórne nastavenia), pozrite si časť 10.5.1 Laboratórne nastavenia .
HIER protocol (Protokol HIER)	Skrátený názov protokolu HIER
HIER protocol 2 (Protokol HIER 2)	Skrátený názov druhého protokolu HIER (môže sa požadovať pre protokoly s multiplexovým farbením).
Hybridization protocol (Protokol hybridizácie)	Skrátený názov protokolu hybridizácie ISH.
Hybridization protocol 2 (Protokol hybridizácie 2)	Skrátený názov druhého protokolu hybridizácie ISH (môže sa požadovať pre protokoly s multiplexovým farbením).
LIS doctor comment (Komentár lekára v LIS)	V prípade systémov LIS-ip je to komentár lekára v systéme LIS.


Pole	Opis
LIS doctor (Lekár v LIS)	V prípade systémov LIS-ip je to meno lekára.
LIS reference [2–8] (Referencia LIS [2–8])	Vlastnosti sklíčka v LIS importované do systému BOND. Pozrite si časť 11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS .
Marker (Značkovač)	Skrátený názov primárnej protilátky alebo sondy pre jednoduché farbenie, paralelné multiplexové farbenie alebo prvé farbenie pre sekvenčné multiplexové farbenie.
Marker 2 (Značkovač 2)	Skrátený názov primárnej protilátky alebo sondy pre druhé farbenie multiplexového farbenia.
Patient comment (Poznámka o pacientovi)	Komentár k prípadu (pozrite si časť 6.3.3 Pridanie prípadu).
Patient (Pacient)	Meno pacienta.
Preparation protocol (Protokol prípravy)	Skrátený názov protokolu prípravy.
Public name (Verejný názov)	Pre systémy LIS-ip, verejný názov primárnej protilátky alebo sondy (pozrite si časť 11.2.4 Názvy verejných značkovačov) pre jednoduché farbenie alebo prvé farbenie multiplexového farbenia.
Public name 2 (Verejný názov 2)	Pre systémy LIS-ip, verejný názov primárnej protilátky alebo sondy (pozrite si časť 11.2.4 Názvy verejných značkovačov) pre druhé farbenie multiplexového farbenia.
Slide comment (Komentár k sklíčku)	Komentár k sklíčku (pozrite si časť 6.5.2 Vytvorenie sklíčka).
Slide date (Dátum sklíčka)	Dátum, kedy bol štítok vytlačený (skrátenej formát, ako je nastavený v časti Miestne a jazykové nastavenia systému Windows (Ovládací panel)).
Slide ID (ID sklíčka)	8-miestny číselný identifikátor sklíčka jedinečný pre sklíčko v rámci systému BOND.
Slide priority (Priorita sklíčka)	V prípade systémov LIS-ip je to prioritné hodnotenie sklíčka.
Staining mode (Režim farbenia)	Jednoduché farbenie, multiplexové farbenie alebo sklíčko Oracle.
Staining protocol (Protokol farbenia)	Skrátený názov protokolu farbenia pre jednoduché farbenie alebo pre prvé farbenie multiplexového farbenia.
Staining protocol 2 (Protokol farbenia 2)	Skrátený názov protokolu farbenia pre druhé farbenie multiplexového farbenia.
Tissue type (Typ tkaniva)	Testovacie tkanivo alebo pozitívna alebo negatívna kontrolná vzorka tkaniva. Systém BOND vytlačí „(-)“ na negatívne kontrolnú vzorku, „(+“ na pozitívnu kontrolnú vzorku a nevytlačí nič na testovacie tkanivo.

10.4 BDD

Pomocou obrazovky **BDD update** (Aktualizácia BDD) aktualizujte Definície údajov systému BOND a generovanie súborov záznamu z auditu.



Obrázok 10-6: Obrazovka BDD update (Aktualizácia BDD)

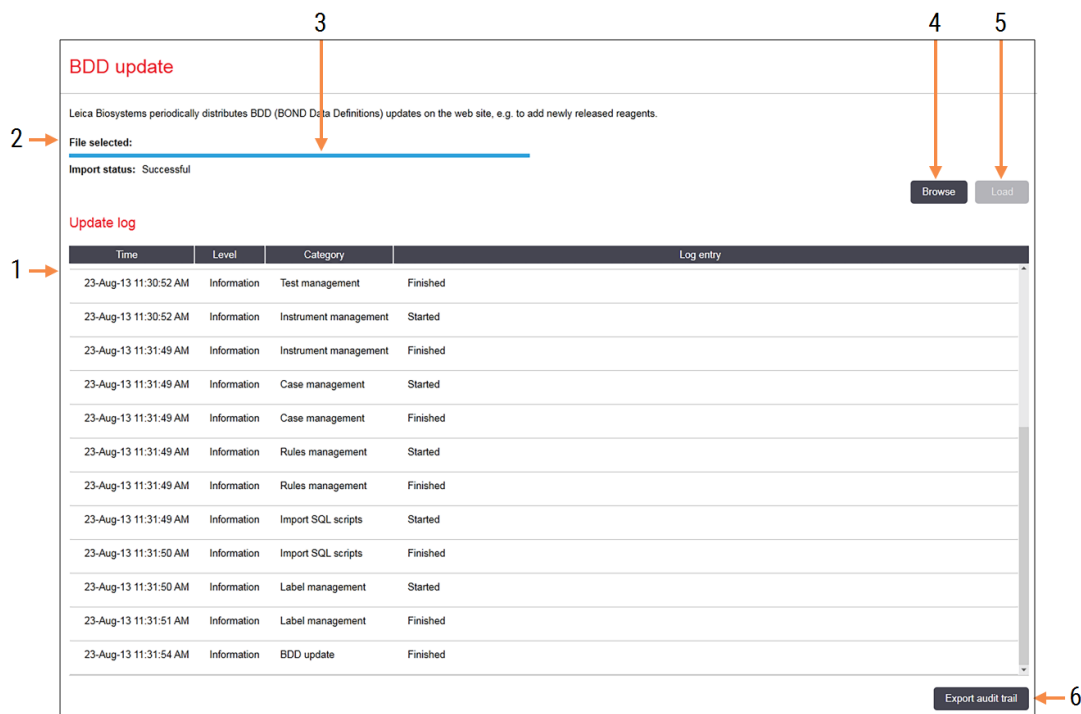

Legenda

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Denník aktualizácie BDD 2 Vybraný súbor aktualizácie BDD 3 Indikátor priebehu a stav aktualizácie BDD 4 Browse (Prehľadávať)
Vyhľadajte súbor aktualizácie BDD a otvorte ho do poľa vľavo | <ol style="list-style-type: none"> 5 Load (Načítať)
Kliknutím nainštalujete súbor aktualizácie BDD v poli vľavo 6 Export audit trail (Exportovať záznam z auditu)
Kliknutím vygenerujete súbory záznamu z auditu – 10.4.2 Záznam z auditu |
|---|---|

Pozrite si:

- [10.4.1 Aktualizácie BDD](#)
- [10.4.2 Záznam z auditu](#)

10.4.1 Aktualizácie BDD

Spoločnosť Leica Biosystems pravidelne distribuuje aktualizácie BDD (definície údajov BOND) pomocou webovej lokality, napríklad na pridanie novo vydaných reagensí. Súbor aktualizácií BDD pre BOND majú príponu súboru „*.bdd“. Nainštalujte tieto aktualizácie z obrazovky **BDD update** (Aktualizácia BDD).



POZOR: Existujú rôzne súbory aktualizácií BDD pre rôzne regióny sveta, ktoré odrážajú rôzne nariadenia v týchto regiónoch. Nezabudnite nainštalovať správny súbor aktualizácií pre váš región (v dialógovom okne **About BOND** (Informácie o systéme BOND) sa zobrazia informácie o oblasti, pozrite si časť **3.9 Informácie o systéme BOND**). Ak si nie ste istí správnym súborom, ktorý chcete použiť, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Aktualizáciu BDD môžete nainštalovať kedykoľvek.

- 1 Stiahnite si súbor aktualizácie z webovej stránky spoločnosti Leica Biosystems a uložte ho na USB kľúč bez vírusov.
- 2 Vložte USB kľúč do riadiaceho zariadenia BOND alebo BOND-ADVANCE (alebo prípadne do akéhokoľvek terminálu BOND v prípade systémov BOND-ADVANCE).
- 3 Otvorte obrazovku **BDD update** (Aktualizácia BDD) v klientovi správy.
- 4 Kliknite na možnosť **Browse** (Prehliadať) a vyhľadajte súbor aktualizácie v dialógovom okne Windows **Open** (Otvoriť).
- 5 Kliknutím na možnosť **Open** (Otvoriť) zobrazte súbor BDD v poli v ľavom hornom rohu obrazovky.
- 6 Kliknutím na možnosť **Load** (Načítať) aktualizujte definície o nové údaje.
- 7 Počas prebiehajúcej aktualizácie sa správy píše do záznamu **Update Log** (Denník aktualizácie). V poslednom riadku sa po dokončení aktualizácie zobrazuje „BDD update: Finished“ (Aktualizácia BDD: dokončená) a na hornom paneli sa v lište postupu zobrazuje stav „Successful“ (Úspešná).
- 8 Otvorte obrazovku **About BOND** (Informácie o systéme BOND) a skontrolujte, či došlo k aktualizácii BDD na najnovšiu verziu.



Jediným spôsobom, ako zistiť, či je aktualizácia BDD úspešná, je obrazovka **BDD update** (Aktualizácia BDD) alebo obrazovka **About** (Informácie o systéme BOND). Tento proces trvá iba niekoľko minút, preto odporúčame počkať, kým sa aktualizácia nedokončí, a potom prejsť na inú obrazovku.



Ak aktualizácia nie je úspešná, definície údajov sa vrátia do stavu pred aktualizáciou a v protokole aktualizácií sa na tento účel zobrazí správa. Ak sa aktualizácia nepodarí, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

10.4.2 Záznam z auditu



Táto časť sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME. Záznam z auditu pre systém BOND-PRIME sa zaznamená do správy servisného denníka.

Môžete vygenerovať záznam z auditu všetkých zmien v systéme vrátane toho, kto a kedy zmeny vykonal. Záznam z auditu sa zapisuje do viacerých súborov CSV, z ktorých každý zaznamenáva inú kategóriu informácií. Súbory sa zapisujú do priečinka: BOND Drop-box\Audit\RRRRMMDD-HHmms na riadiacom zariadení.

Vytvorenie súborov záznamu z auditu:

- 1 Otvorte obrazovku **BDD update** (Aktualizácia BDD) a kliknite na položku **Export audit trail** (Exportovať záznam z auditu).
- 2 Zvoľte možnosť **All data** (Všetky údaje) na nahlásenie všetkých zmien v priebehu celej životnosti systému alebo **Custom date range** (Vlastný rozsah dátumov), aby ste mohli definovať konkrétne obdobie, a potom definujte dátumy a časy **From** (Od) a **To** (Do).
- 3 Kliknite na položku **Export** (Exportovať).

10.5 Nastavenia

Na obrazovke **Settings** (Nastavenia) sa nachádzajú všeobecné laboratórne nastavenia pre systém BOND (**Laboratory settings** (Laboratórne nastavenia)) a predvolené nastavenia prípadu a sklíčka a možnosti pracovného toku (**Case and slide settings** (Nastavenia prípadu a sklíčka)).




- [10.5.1 Laboratórne nastavenia](#)
- [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)
- [10.5.3 Zálohy databázy](#)

10.5.1 Laboratórne nastavenia

Nastavte všeobecné laboratórne možnosti na table **Laboratory settings** (Laboratórne nastavenia):

Obrázok 10-7: Obrazovka **Settings** (Nastavenia) tabla **Laboratory settings** (Laboratórne nastavenia)

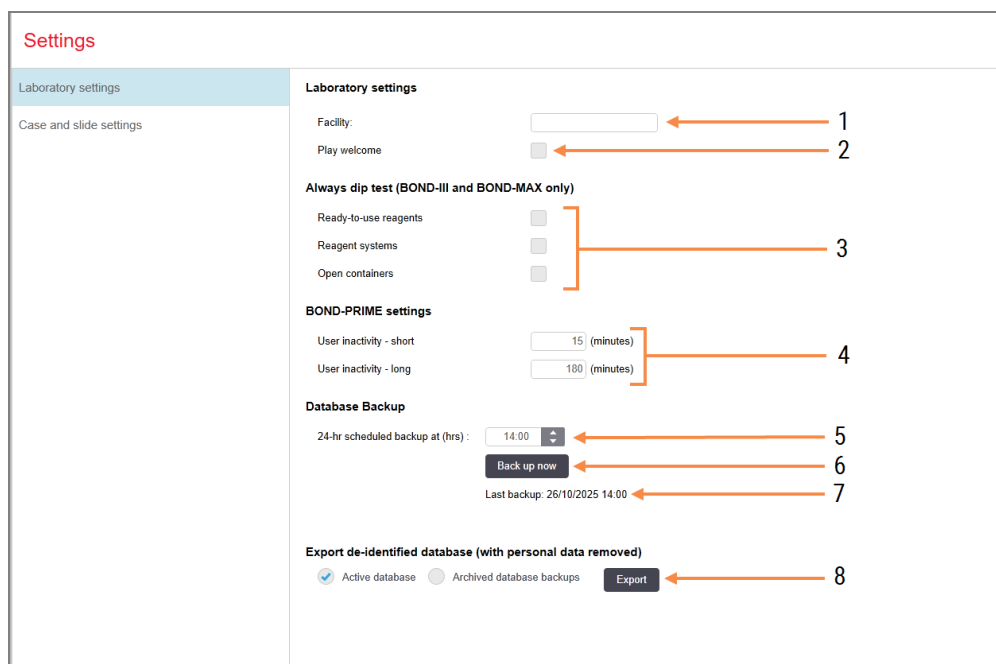

Legenda

- | | |
|---|--|
| <p>1 Facility (Zariadenie)
Zadajte názov svojho laboratória, aby sa zobrazil v správach</p> <p>2 Play welcome (Prehrať uvítanie)
Prehrá sa uvítacia správa pri spustení softvéru BOND</p> <p>3 Always dip test (Vždy vykonať testovanie namočením)
Skontrolujte, či sa pred každým cyklom namočia nádoby na reagentie špecifikovaných typov – pozrite si časť 8.3.1 Stanovenie objemu reagentie</p> <p>4 User inactivity (Nečinnosť používateľa)
Len BOND-PRIME.
Short (Krátka)– nastavte dobu nečinnosti (minúty), po ktorej musí používateľ znova zadať svoj PIN kód.
Long (Dlhá)– nastavte obdobie nečinnosti (minúty), po ktorom sa používateľ musí znova prihlásiť.</p> | <p>5 24-hr scheduled backup at (hrs) (24-hodinové plánované zálohovanie o (h))
Nastavte čas na automatické spúšťanie denných záloh databáz (24-hodinový formát času) – pozrite si časť 10.5.3 Zálohy databázy.</p> <p>6 Back up now (Zálohovať teraz)
Okamžite spustíte zálohu databázy – 10.5.3 Zálohy databázy.</p> <p>7 Informácie o poslednej zálohe alebo indikátore priebehu počas zálohovania.</p> <p>8 Export de-identified database (Exportujte de-identifikovanú databázu)
Vyberte, či chcete exportovať de-identifikované údaje z aktívnej databázy alebo zo zálohy databázy.</p> |
|---|--|

10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka

Nastavenia prípadu a sklíčka umožňujú nastaviť:

- predvolené hodnoty pre množstvo konfigurovateľných hodnôt v prípade vytvárania prípadov a sklíčok,
- možnosti pracovného toku pri vytvorení prípadu a sklíčka.

Opisy možností prípadu a sklíčka si pozrite na [Obrázok 10-8](#) a [Obrázok 10-9](#).


Obrázok 10-8: Nastavenia prípadu na table **Case and slide settings** (Nastavenia prípadu a sklíčka)

Case settings	
1	Default preparation: *Dewax
2	Default dispense volume: 150 µL
3	Create impromptu cases or slides: Cases and slides
4	Processed case lifetime: 30 (days)
5	Create daily case

Legenda

- | | |
|---|---|
| <p>1 Default preparation (Predvolená príprava)
Predvolený prípravný protokol pre nové prípady.</p> <p>2 Default dispense volume (Predvolený objem dávkovania)
Predvolený objem dávkovania pre nové prípady.</p> <p>3 Create impromptu cases/slides (Vytvorenie improvizovaných sklíčok prípadov/sklíčok)
Nastavte možnosti na vytváranie prípadov a/alebo sklíčok po vložení sklíčok – pozrite si časť 6.8.2 Možnosti identifikácie sklíčok v systéme.</p> | <p>4 Processed case lifetime (Životnosť spracovaného prípadu)
Počet dní, počas ktorých prípad zostane na obrazovke Slide setup (Nastavenie sklíčka) sklíčka po spustení posledného sklíčka v prípade – pozrite si časť 6.3.4.2 Životnosť spracovaného prípadu.</p> <p>5 Create daily case (Vytvorenie denného prípadu)
Automaticky vytvorte jeden prípad denne pre všetky sklíčka spracované v ten deň – pozrite si časť 6.3 Práca s prípadmi.</p> |
|---|---|

Poznámka: Nevzťahuje sa na moduly spracovania BOND-PRIME.

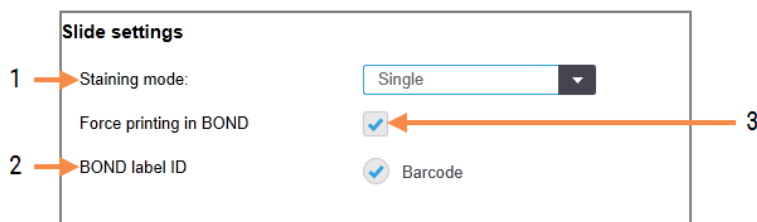Obrázok 10-9: Nastavenia sklíčka na table **Case and slide settings** (Nastavenia prípadu a sklíčka)

Legenda

- | | |
|--|--|
| <p>1 Staining mode (Režim farbenia)
Predvolené nastavenie pre nové sklíčka – pozrite si 6.5.2 Vytvorenie sklíčka.</p> <p>2 BOND label ID (Identifikátor štítku BOND)
Identifikátory štítkov pre sklíčka vytvorené v systéme BOND sú 2D čiarové kódy.</p> | <p>3 Force printing in BOND (Vynútená tlač v systéme)
Na spracovanie povoľte iba sklíčka so štítkami vytlačenými v systéme BOND – pozrite si časť 6.8.2 Možnosti identifikácie sklíčok v systéme.</p> <p>Poznámka: Nevzťahuje sa na moduly spracovania BOND-PRIME.</p> |
|--|--|

10.5.3 Zálohy databázy

Databáza ukladá kritické informácie o pacientovi a je nevyhnutná pre správne fungovanie systému BOND, aby sa zabezpečilo, že sa môžete obnoviť v prípade poškodenia databázy, systém BOND má systém automatických a manuálnych záloh:

- automatické denné zálohy,
- „manuálne“, zálohy na požiadanie.

Všetky záložné súbory sú uložené na riadiacom zariadení BOND v podadresároch adresára:

B:\BOND Drop-box\Backups

Pre každý typ zálohy sa vygenerujú dva súbory, vždy s rovnakým formátom názvu:

[Názov zariadenia]_BOND_RRRR-MM-DD-HH-mm-ss

kde sa názov zariadenia zadáva v klientovi správy na obrazovke **Settings** (Nastavenia) (pozrite si časť [10.5.1 Laboratórne nastavenia](#)) (alebo sa predvolene nastaví na „Facility“ (Zariadenie), ak nie je zadaný názov zariadenia). Názov obsahuje dátum a čas spustenia zálohy. Hlavný záložný súbor má príponu „.dump“ a existuje aj protokolový súbor s príponou „.log“.

Automatická denná záloha sa spustí v čase nastavenom v klientovi správy na obrazovke **Settings** (Nastavenia) ([10.5.1 Laboratórne nastavenia](#)). Posledná záloha je v priečinku „Scheduled_Latest“. Po spustení zálohovania na nasledujúci deň sa presunie do priečinka „Scheduled_1_Days_Old“, a následne na ďalších šesť dní (do priečinka „Scheduled_7_Days_Old“), po ktorom sa odstráni.

Ak je riadiace zariadenie BOND vypnuté v naplánovanom čase zálohy, záloha sa nespustí. Uistite sa, že ste nastavili čas, kedy bude riadiace zariadenie zapnuté a kedy je nepravdepodobné, že bude prebiehať spracovanie.

Manuálne zálohovanie môžete spustiť kedykoľvek (okrem prípadu, keď je spustené automatické zálohovanie) z klienta správy na obrazovke **Settings** (Nastavenie). Kliknite na položku **Back up now** (Zálohovať hneď) v časti **Database backup** (Zálohovanie databázy) (pozrite si časť **10.5.1 Laboratórne nastavenia**).

Po dokončení zálohovania sa zobrazí dialógové okno. Súbory záloh a denníkov sa ukladajú do priečinka „Manual“. Pri nasledujúcom manuálnom zálohovaní sa súbory prenású do priečinka „Manual_Previous“. Súbory sa vymažú po tretej manuálnej zálohe – t. j. uložia sa iba dve posledné manuálne zálohy.

Ak sa nepodarí úspešne dokončiť niektorý typ zálohy, na pravej strane panela funkcií v klientovi správy a klinickom klientovi sa zobrazí ikona (vpravo). Ikona zostáva, kým sa nespustí úspešné zálohovanie. Ak sa ikona zobrazí, čo najskôr sa pokúste o manuálne zálohovanie. Ak sa nepodarí ani to, okamžite sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.



Najmä v prípade starších systémov BOND, v ktorých bude nahromadených viac údajov, občas skontrolujte, či je k dispozícii dostatok miesta pre záložné súbory. Zvyčajne sa jeden záložný súbor odstráni, keď sa zapíše nový, takže využitie jednotky sa zvýši iba v relatívne malých prírastkoch. V určitom okamihu však budete potrebovať ďalšie miesto na disku. V takom prípade sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.

Pre väčšiu bezpečnosť pravidelne zálohujte záložné súbory na iné miesto (mimo riadiaceho zariadenia BOND). Ak je to možné, zabezpečte spolu so svojím oddelením IT automatické zálohovanie. Ak nie, skopírujte súbory manuálne raz týždenne (častejšie pre laboratória s vysokými obratmi). Riadiace zariadenie BOND prevádzkuje zabezpečený FTP server, aby sa oddelenie IT mohlo prihlásiť a stiahnuť záložné súbory z priečinka prostredníctvom zabezpečeného FTP systému BOND.

Ak potrebujete obnoviť databázu, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

10.6 Hardvér

Na konfiguráciu modulov spracovania, súborov (skupín modulov spracovania ovládaných z jedného klienta) a tlačiarň štítkov sklíčok použite obrazovku **Hardware configuration** (Konfigurácia hardvéru).



Konfigurácia hardvéru sa vykonáva na troch kartách:

- [10.6.1 Moduly spracovania](#)
- [10.6.2 Súbory](#)
- [10.6.3 Značkovače sklíčok](#)

10.6.1 Moduly spracovania

Zobrazte moduly spracovania v systéme BOND a nakonfigurujte ich nádoby na nebalené reagentie na karte **Processing modules** (Moduly spracovania).

Keď je modul spracovania fyzicky pripojený k riadiacemu zariadeniu BOND pomocou sieťového kábla, automaticky sa objaví v ľavej časti karty **Processing modules** (Moduly spracovania).




Riadiace zariadenie BOND umožní pripojenie iba kompatibilných modulov spracovania. Ak je pripojený nekompatibilný modul spracovania, zobrazí sa ikona a chybové hlásenie (pozrite si tabuľku ikon a významov na nasledujúcej strane).

Vyberte modul spracovania, aby sa jeho podrobnosti zobrazili na pravej strane karty. Zadajte pre modul spracovania jedinečný názov a ak je to potrebné, zakážte niektoré nádoby na nebalený materiál (pozrite si časť [10.6.1.1 Deaktivácia nádob na nebalené reagentie](#)). Keď tieto nastavenia uložíte, modul spracovania sa považuje za „uvedený do prevádzky“.

Zostane na karte, a to aj vtedy, keď je vypnutý alebo odpojený, kým ho nevyradíte z prevádzky (pozrite si časť [10.6.1.2 Vyradenie modulu spracovania z prevádzky](#)).

Obrázok 10-10: Karta **Processing modules** (Moduly spracovania) na obrazovke **Hardware configuration** (Konfigurácia hardvéru)

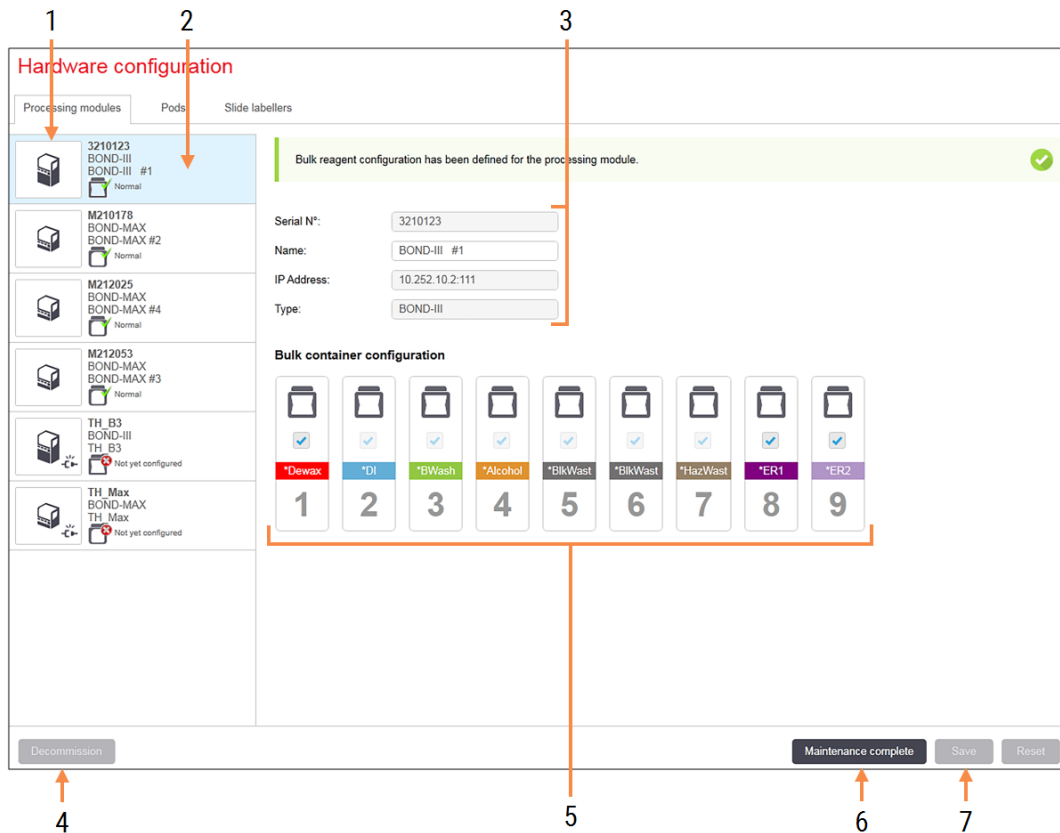







Legenda

- 1 Všetky pripojené moduly spracovania.
- 2 Aktuálne vybraný modul spracovania – podrobnosti sú zobrazené na pravej strane obrazovky.
- 3 Sériové číslo, názov (upraviteľný), IP adresa a typ modulu spracovania pre vybraný modul spracovania.
- 4 **Decommission (Vyradenie z prevádzky)**
Vyradíte vybraný modul spracovania z prevádzky – pozrite si časť [10.6.1.2 Vyradenie modulu spracovania z prevádzky](#).
- 5 Konfigurácia nádoby na nebalený materiál – môžete zrušiť začiarknutie niektorých staníc, ak sa nebudú používať – pozrite si časť [10.6.1.1 Deaktivácia nádob na nebalené reagenty](#) nižšie.
- 6 **Maintenance complete (Údržba je dokončená)**
Kliknutím obnovíte deň a počet sklíčok po preventívnej údržbe – pozrite si časť [Preventívna údržba a 12 Čistenie a údržba \(len BOND-III a BOND-MAX\)](#).
- 7 **Save (Uložiť)**
Ak chcete uviesť do prevádzky novo pripojený modul spracovania, musíte uložiť konfiguračné nastavenia. Ak chcete uložiť konfiguračné nastavenia modulu spracovania, musíte sa najprv presvedčiť, či sú všetky jeho zostavy na farbenie sklíčok odomknuté.

Poznámka: Nevzťahuje sa na moduly spracovania BOND-PRIME.

Ikony vedľa snímok modulov spracovania na ľavej table označujú, kedy sú moduly v rôznych stavoch:

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Modul spracovania nie je pripojený.		Modul spracovania prechádza údržbou. Táto ikona sa zobrazí (spolu s chybovou správou), ak je pripojený modul spracovania nekompatibilný so systémom BOND.
	Modul spracovania sa spúšťa.		Konfigurácia nebalenej reagentie nebola prijatá modulom spracovania. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) odošlite konfiguráciu.
	Na module spracovania momentálne prebiehajú opravy.		Konfigurácia nebalenej reagentie bola prijatá modulom spracovania.

10.6.1.1 Deaktivácia nádob na nebalené reagentie



Táto sekcia sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME.

Laboratóriá, ktoré nevykonávajú získavanie epitopov a/alebo odvoskovanie na systéme BOND môžu deaktivovať nádoby v softvéri a odstrániť príslušné nádoby z modulu spracovania. Nádoby sa potom nemusia udržiavať s reagentiou vloženou v nich a inicializácia modulu spracovania sa urýchli, pretože prívody tekutín do nádob nie sú preplachované. Ak chcete zakázať nádoby na nebalený materiál, zrušte ich začiaroknutie na table **Bulk container configuration** (Konfigurácia nádob na nebalený materiál) a kliknite na možnosť **Save** (Uložiť). Po zobrazení výzvy reštartujte modul spracovania, aby sa zmeny prejavili. Deaktivované nádoby môžete odstrániť alebo ich nechať v module spracovania na svojom mieste.

10.6.1.2 Vyradenie modulu spracovania z prevádzky


Ak už nepotrebujete modul spracovania, vyradte ho z prevádzky a odpojte ho na karte **Processing module** (Modul spracovania). Uistite sa, že je modul spracovania vypnutý, vyberte ho na karte **Processing modules** (Moduly spracovania) a kliknite na položku **Decommission** (Vyradenie z prevádzky). Ak je modul spracovania stále v súbore, po vyradení z prevádzky sa automaticky odstráni z modulu.

Ak chcete znova spracovať modul spracovania, znova pripojte jeho sieťový kábel.

10.6.2 Súborý

Súborý sú kolekcie modulov spracovania (a tlačiarň štítkov sklíčok), ktoré je možné ovládať z jedného klinického klienta – pozrite si časť [3.1 Architektúra systému](#). Vytvorte súbor aj pre inštalácie s jednou stanicou, kde sú všetky moduly spracovania ovládané z riadiaceho zariadenia BOND. Vytvárajte a upravujte súborý na table **Pods** (Súborý)

Obrazok 10-11: Karta **Pods** (Súborý) na obrazovke **Hardware configuration** (Konfigurácia hardvéru).

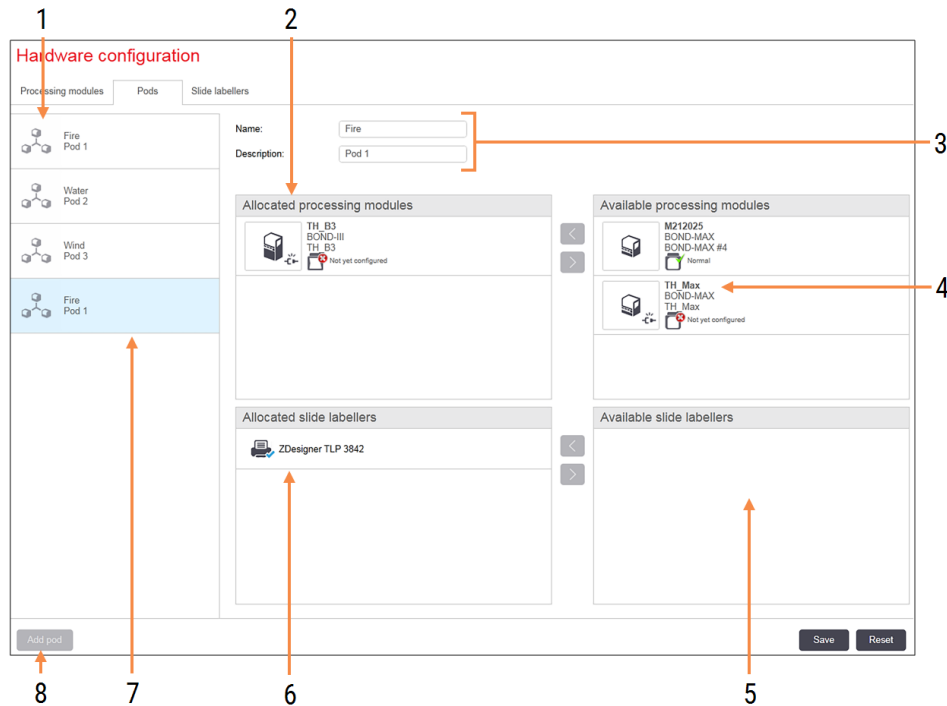

Legenda

- 1 Zoznam všetkých súborov
- 2 Moduly spracovania vo vybranom súbore. Rovnaké poradie sa používa u klinického klienta – pozrite si časť [10.6.2.1 Vytvorenie nového súboru](#) nižšie.
- 3 Názov a opis (oba polia upraviteľné) vybraného súboru.
- 4 Všetky moduly spracovania, ktoré nie sú v súboroch.
- 5 Všetky značkovače sklíčok, ktoré nie sú v súboroch.
- 6 Zasuňte tlačiarne štítkov sklíčok do vybraného súboru. Predvolená tlačiareň je označená modrou značkou začiarknutia – pozrite si časť [10.6.2.1 Vytvorenie nového súboru](#) nižšie.
- 7 Aktuálne vybraný súbor – detaily sú zobrazené v pravej časti obrazovky.
- 8 **Add pod (Pridať súbor)**
Kliknutím nakonfigurujete nový súbor – pozrite si časť [10.6.2.1 Vytvorenie nového súboru](#) nižšie.

Odstrániť

Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny súbor a kliknutím na príkaz **Delete** (Odstrániť) ho odstráňte.


Ak chcete sprístupniť moduly spracovania na zahrnutie do súboru, nakonfigurujte ich na karte **Processing modules** (Moduly spracovania) (pozrite si časť [10.6.1 Moduly spracovania](#)). Ak chcete štítky sklíčok sprístupniť na zaradenie do súboru, nakonfigurujte ich na karte **Slide labelers** (Značkovače sklíčok) (pozrite si časť [10.6.3 Značkovače sklíčok](#)).

10.6.2.1 Vytvorenie nového súboru

- 1 Kliknite na možnosť **Add pod** (Pridať súbor).
- 2 Zadajte jedinečný názov súboru a voliteľný opis.
- 3 Na table **Available processing modules** (Dostupné moduly spracovania) (vpravo hore) vyberte moduly

spracovania a kliknutím na tlačidlo so šípkou doľava  ich pridajte do tably **Allocated processing modules** (Pridelené moduly na spracovanie) (vľavo hore).

Ak pridávate viac modulov spracovania, pridajte ich v poradí, v akom chcete, aby sa karty zobrazili v klinickom klientovi, napr. ak vyberiete modul spracovania A ako prvý a modul spracovania B ako druhý, A sa objaví nad B na table a na kartách **System status** (Stav systému) klientov pripojených k súboru. Ak chcete zmeniť poradie

modulov spracovania, vyberte ich pomocou tlačidla so šípkou doprava  a potom ich pomeňte v správnom poradí.


- 4 Vyberte jeden alebo viac tlačiarň štítkov sklíčok na table **Available slide labelers** (Dostupné značkovače sklíčok) (vpravo dole) a pridajte ju do tably **Allocated slide labelers** (Pridelené značkovače sklíčok) (vľavo dole).
Ak pridáte viac tlačiarní, pri tlači sklíčok sú na výber k dispozícii všetky. Nastavte predvolenú tlačiareň kliknutím pravým tlačidlom myši a kliknutím na možnosť **Set as default printer** (Nastaviť ako predvolenú tlačiareň). Predvolená tlačiareň má modrú značku začiarknutia.
- 5 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).

Ak chcete odstrániť modul, odstráňte všetky moduly spracovania a tlačiarne a potom kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v ľavej table a kliknite na položku **Delete** (Odstrániť).

10.6.3 Značkovače sklíčok

Značkovače sklíčok používané systémom BOND musia byť lokalizované, identifikované a aktivované v klientovi správy na obrazovke **Hardware configuration** (Konfigurácia hardvéru), na karte **Slide labelers** (Značkovače sklíčok). Vďaka tomu sú dostupné na zaradenie do súborov (pozrite si časť [10.6.2 Súborov](#)).

Obrázok 10-12: Karta **Slide labelers** (Značkovače sklíčok) na obrazovke **Hardware configuration** (Konfigurácia hardvéru)

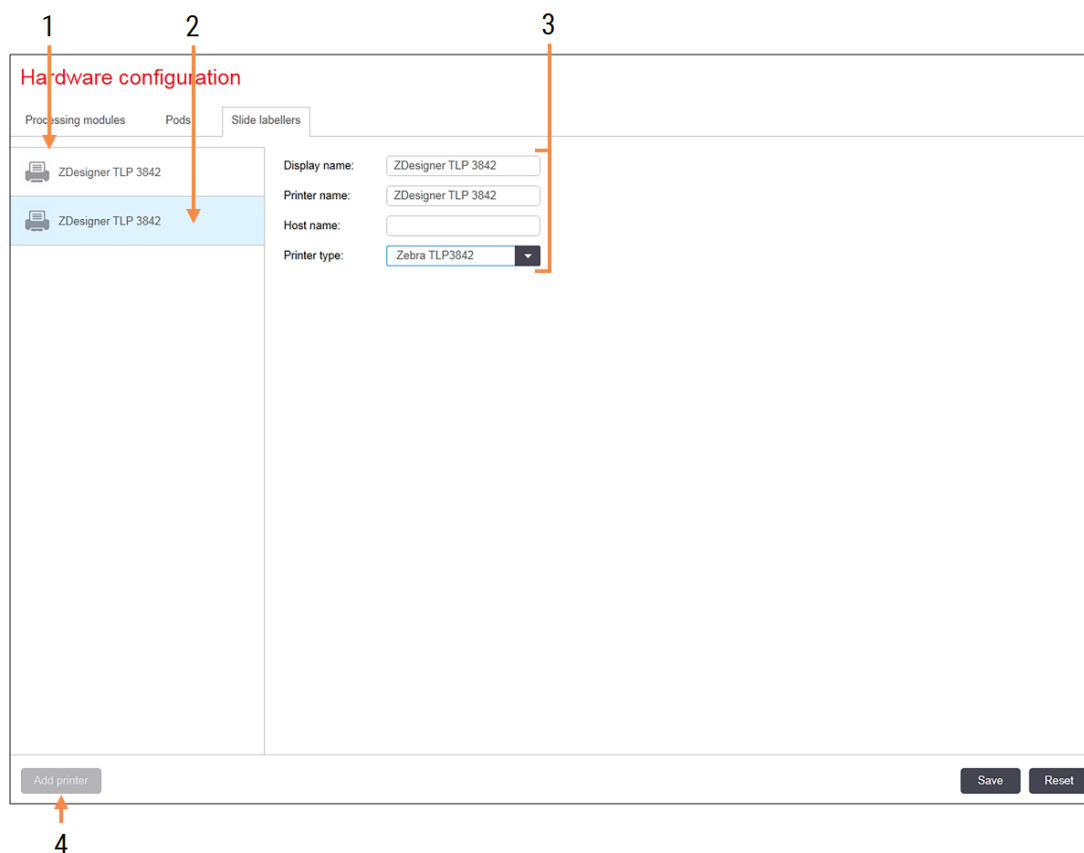

Legenda

- | | |
|--|--|
| <p>1 Zoznam všetkých značkovačov sklíčok.</p> <p>2 Aktuálne vybraný značkovač sklíčok – detaily sú zobrazené v pravej časti obrazovky.</p> | <p>3 Podrobnosti o tlačiarnach štítkov sklíčok – pozrite si časť 10.6.3.1 Podrobnosti o tlačiarnach štítkov sklíčok nižšie.</p> <p>4 Add printer (Pridanie tlačiarne)
Kliknutím pridáte nový značkovač sklíčok – nakonfigurujete ho v pravej časti obrazovky.</p> |
|--|--|

Ak chcete sprístupniť novo pripojený značkovač sklíčok na zaradenie do súboru, kliknite na ikonu **Add printer** (Pridať tlačiareň) a potom zadajte podrobnosti o tlačiarni na pravej strane obrazovky.



Nie všetky inštalácie majú súbory. Ak nie sú k dispozícii žiadne súbory, predvolená tlačiareň je prvá tlačiareň v zozname.



Ak sa značkovač sklíčok vymenení, nemusíte pridať nový značkovač – podrobnosti pôvodného značkovača môžete nahradiť údajmi nového značkovača.

Ak chcete značkovač zo zoznamu odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Delete** (Odstrániť).

10.6.3.1 Podrobnosti o tlačiarnach štítkov sklíčok

Systém BOND vyžaduje pre každú tlačiareň štítkov sklíčok nasledujúce podrobnosti:

- **Display name** (Zobrazený názov): názov pre značkovač, ktorý sa objaví v softvéri BOND
- **Printer name** (Názov tlačiarne): názov tlačiarne používaný systémom Windows




Názov tlačiarne v inštalácii BOND-ADVANCE je vlastne tlačiareň **Share name** (Názov zdieľania) zobrazená v systéme Windows v dialógovom okne **Printers and Faxes** (Tlačiarne a faxy).

- **Host name** (Meno hostiteľa): nechajte prázdne, ak sa nepoužíva tlačiareň **Zebra** (napr. **ZDesigner TLP 3842**) v inštalácii BOND-ADVANCE, inak zadajte položku **Computer name** (Názov počítača) terminálu, ku ktorému je pripojený značkovač sklíčok.



Computer name (Názov počítača) nájdete v systéme Windows v dialógovom okne **System** (Systém) (pozrite si **Obrázok 10-13**).

Obrázok 10-13: Názov počítača v dialógovom okne systému Windows

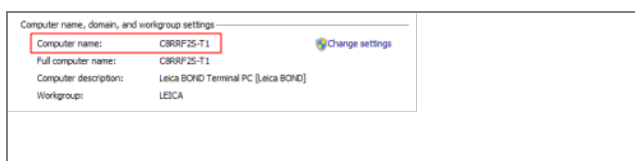

- **Printer type** (Typ tlačiarne): model tlačiarne (napr. **ZDesigner TLP 3842**)


10.6.3.2 Tlač testovacích štítkov

Kontrola zarovnania tlače:

- 1 Otvorte obrazovku **Labels** (Štítky) v klientovi správy.
- 2 Vyberte štítok na ľavom paneli a kliknite na tlačidlo **Print** (Vytlačiť).



Obrázok 10-14: Tlač testovacieho štítku

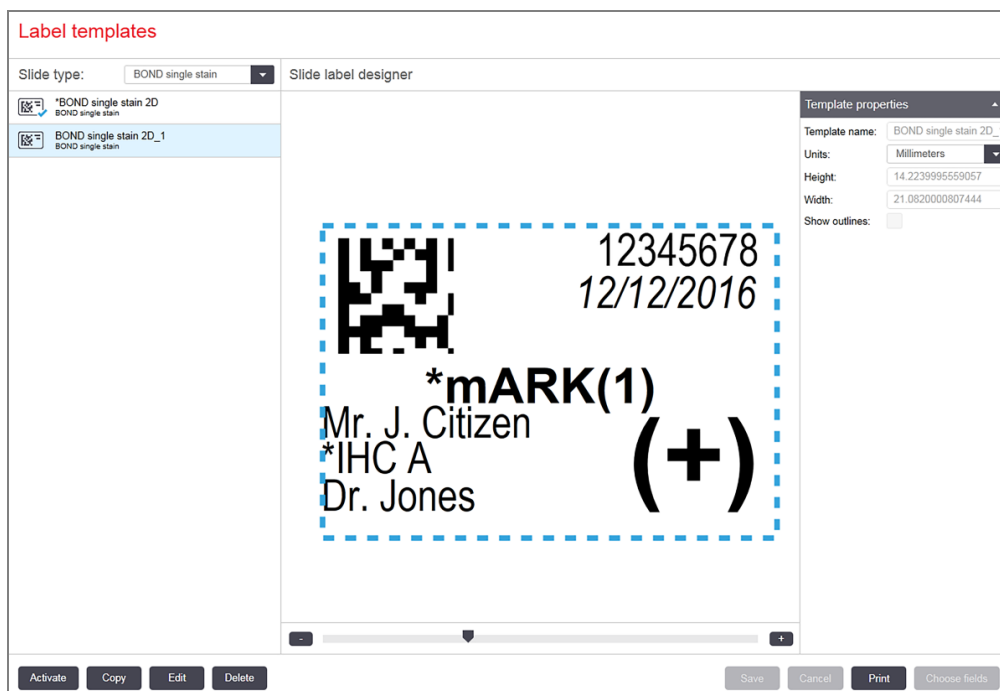

- 3 V dialógovom okne **Select a Printer** (Vyberte tlačiareň) vyberte príslušnú tlačiareň a kliknite na tlačidlo **Print** (Vytlačiť).
- 4 Krok 3 zopakujte trikrát až päťkrát. Uistite sa, že sú všetky znaky jasne a presne vytlačené na štítku.
- 5 Ak poloha snímky na štítku nie je správna, pozrite si časť [Úprava kalibrácie tlačiarne Zebra \(Sekcia 10.6.3.3 na strane 262\)](#) alebo [Úprava kalibrácie kognitívnej tlačiarne \(Sekcia 10.6.3.4 na strane 267\)](#).

10.6.3.3 Úprava kalibrácie tlačiarne Zebra



Nasledujúci postup platí pre obidva typy tlačiarní Zebra: TLP 3842 alebo GX430t. Existujú určité rozdiely, ktoré sú opísané v príslušných nastaveniach.




V prípade inštalácie BOND-ADVANCE vykonajte nasledujúci postup na termináli BOND-ADVANCE.

- 1 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Start** (Štart) a vyberte možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).

- Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne (napr. **ZDesigner TLP 3842**) a vyberte možnosť **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne).


Systém zobrazí dialógové okno Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne) znázornené na **Obrázok 10-15**.

Obrázok 10-15: Vlastnosti tlačiarne

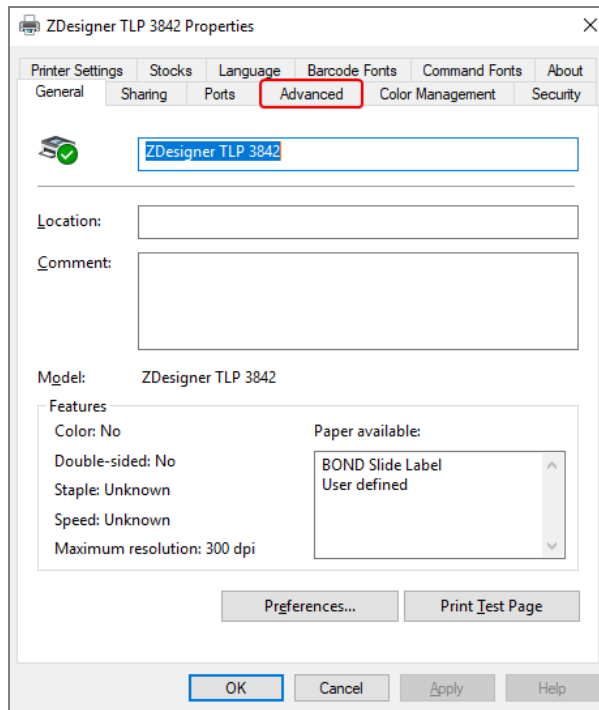

- 3 Vyberte kartu **Advanced** (Pokročilé).


Obrázok 10-16: Vlastnosti tlačiarne – karta Advanced (Pokročilé)

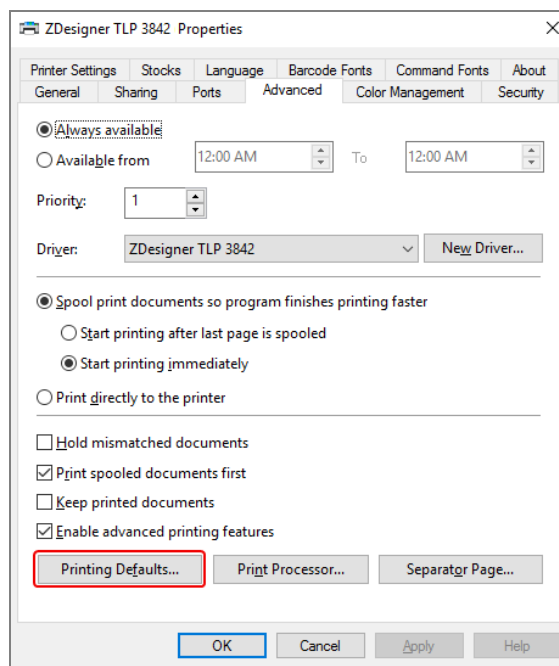

- 4 Kliknite na ikonu tlačidlo **Printing Defaults...** (Predvolené hodnoty tlače...).

System zobrazí dialógové okno Printer Defaults (Predvolené možnosti tlačiarne) znázornené na **Obrázok 10-17**.

Obrázok 10-17: Predvolené možnosti tlačiarne

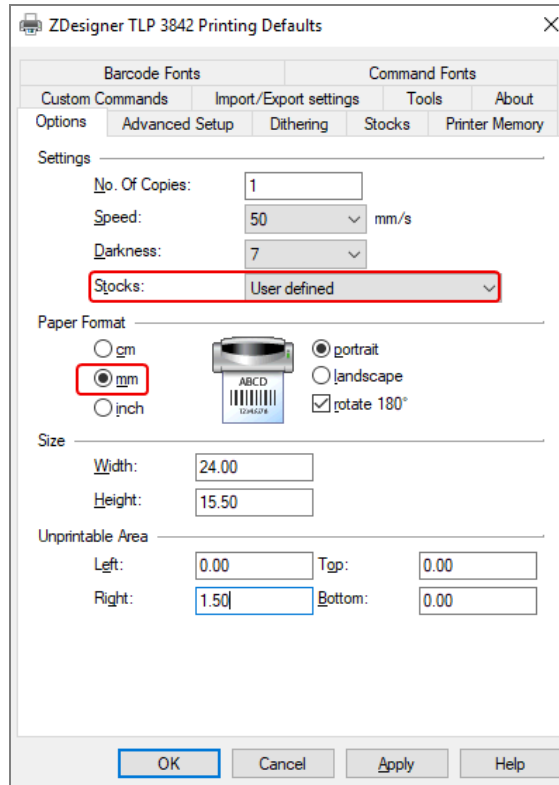


Tento dokument sa týka nastavení tlačiarne v milimetroch. Preto nastavte formát papiera na mm.

- 5 Z rozbaľovacieho zoznamu Stocks (Zásoby) vyberte možnosť „BOND Slide Label“ (Štítko sklíčka BOND).

- 6 Kliknite na kartu **Stocks** (Zásoby).

Obrázok 10-18: Predvolené možnosti tlače – karta Stocks (Zásoby)

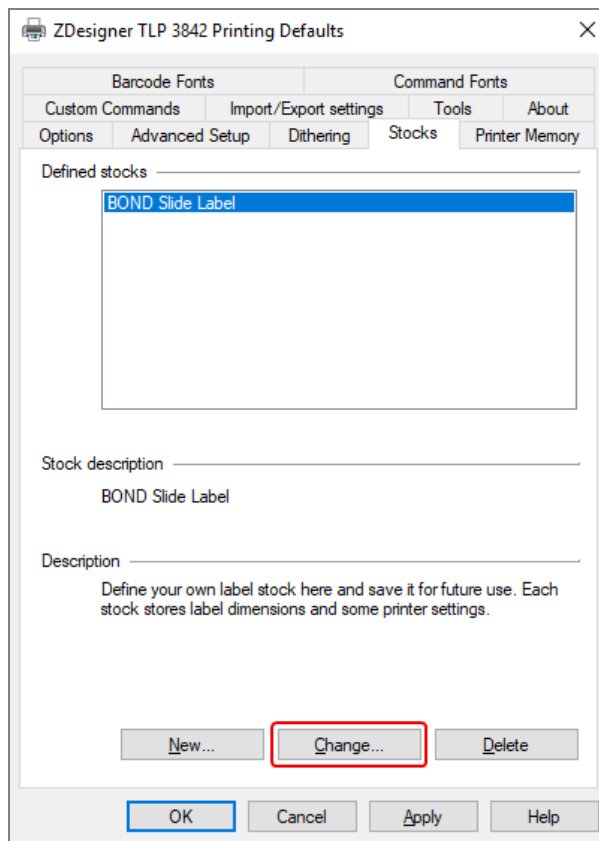

7 Kliknite na tlačidlo **Change...** (Zmeniť...).

System zobrazí okno **Define Stock** (Definovať zásoby), ako je to znázornené na **Obrázok 10-19**.

Pred zmenou nastavení sa odporúča vrátiť tlačiareň na predvolené nastavenia, ako je to uvedené v tabuľke nižšie, a vytlačiť niektoré testovacie štítky.

Nastavenie	TLP 3842	GX430t
Šírka štítka	24.00 mm	40.00 mm
Výška štítka	15.50 mm	15.00 mm
Nepotlačiteľná oblasť – vľavo	0.00 mm	4.50 mm
Nepotlačiteľná oblasť – vpravo	1.50 mm	0.00 mm

Obrázok 10-19: Dialógové okno Define Stock (Definovať zásoby)

- Ak je ľavý okraj orezaný, mierne znížte hodnotu **Right** (Vpravo) v časti **Unprintable Area** (Nepotlačiteľná oblasť), napríklad z 1.50 mm na 1.0 mm.
- Ak je pravý okraj orezaný, mierne zvýšte hodnotu **Right** (Vpravo) v časti **Unprintable Area** (Nepotlačiteľná oblasť), napríklad z 1.50 mm na 2.0 mm.

8 Kliknite na tlačidlo **OK**.

- 9 Opakujte tlač a nastavenie štítkov, až kým štítok nie je prijateľný (nezostrihne sa žiaden text).



Po kliknutí na tlačidlo **OK** sa môže zobraziť chybové hlásenie **Stock name already used by system form database** (Názov zásob už použitý v databáze systémových formulárov). V tomto prípade upravte pole **Name** (Názov) v dialógovom okne **Define Stock** (Definovať zásoby), ako je to uvedené na **Obrázok 10-20**, potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Obrázok 10-20: Premenovanie zásoby štítkov




10.6.3.4 Úprava kalibrácie kognitívnej tlačiarne

V prípade inštalácie BOND-ADVANCE sa prihláste do riadiaceho zariadenia BOND-ADVANCE ako BONDDashboard. Ak je ovládací panel aktuálne zobrazený, stlačte tlačidlo **Alt + F4** a zatvorte ho.

- 1 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Start** (Štart) a vyberte možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).
- 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne (napr. **Cognitive Terminal 1** (Terminál Cognitive 1)) a vyberte možnosť **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne).


Obrázok 10-21: Vyberte položku Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne)

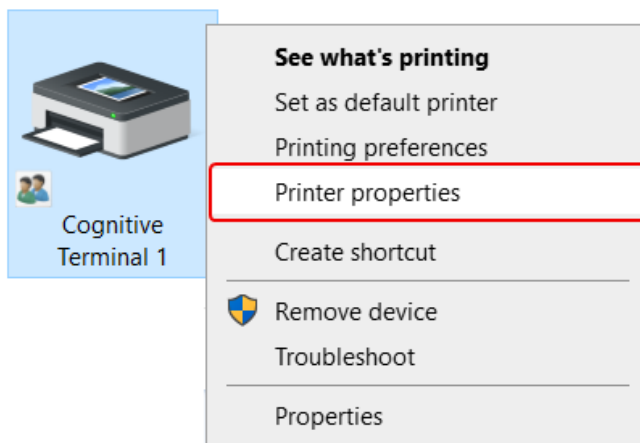

Nevyberajte možnosť **Printing Preferences** (Predvoľby tlače). Dialógové okná sú podobné, ale nastavenia sa neaktualizujú správne.

Systém zobrazí dialógové okno **Cognitive Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne Cognitive) znázornené na **Obrázok 10-22**.


Obrázok 10-22: Vlastnosti tlačiarne Cognitive

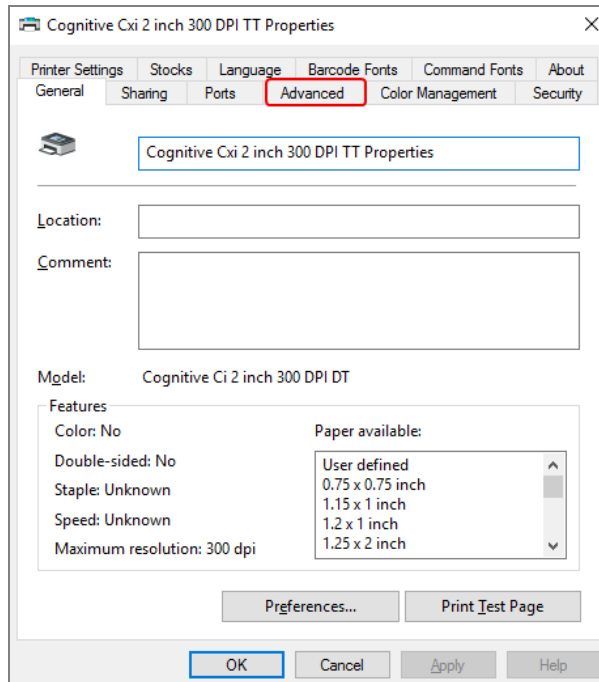

- 3 Vyberte kartu **Advanced** (Pokročilé).

Systém zobrazí kartu **Advanced** (Pokročilé), ako je to znázornené na **Obrázok 10-23**.


Obrázok 10-23: Karta Advanced (Pokročilé)

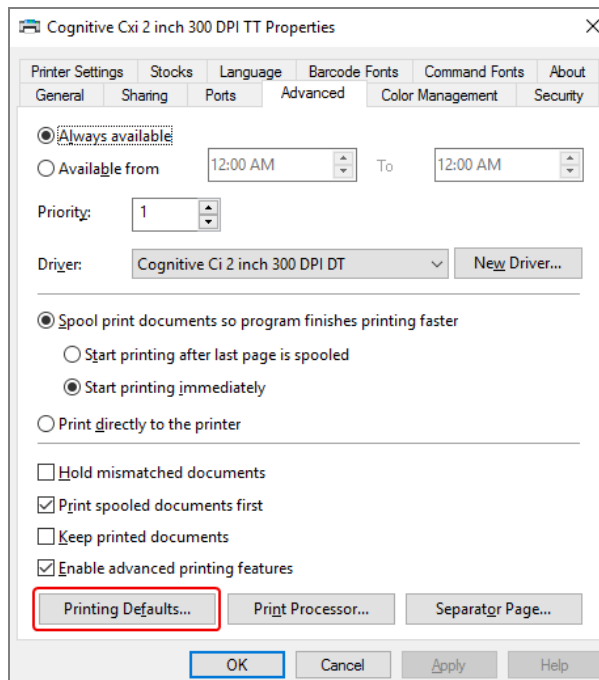

- 4 Kliknite na ikonu tlačidlo **Printing Defaults...** (Predvolené hodnoty tlače...).

System zobrazí dialógové okno **Printer Defaults** (Predvolené možnosti tlačiarne) znázornené na **Obrázok 10-24**.

Obrázok 10-24: Dialógové okno Printing Defaults (Predvolené možnosti tlače)

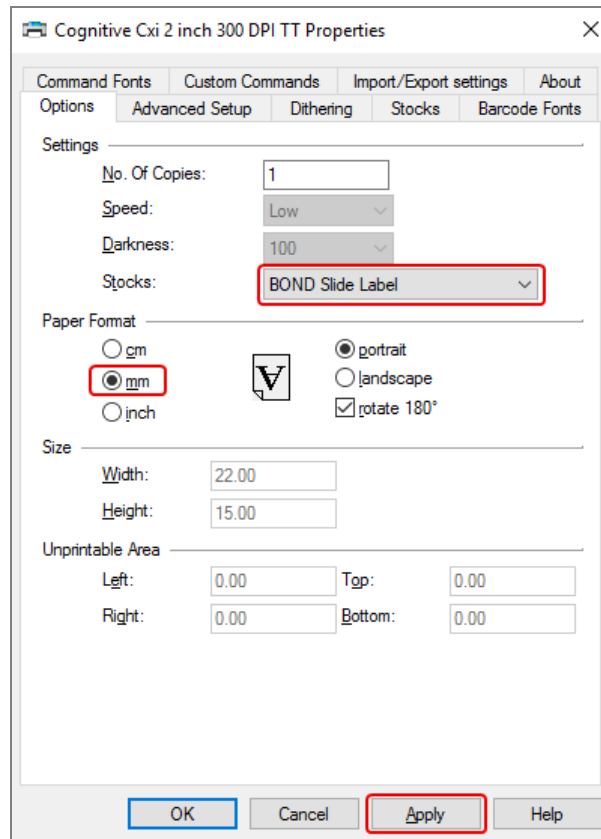


Tento dokument sa týka nastavení tlačiarne v milimetroch. Preto nastavte formát papiera na mm.

- 5 Z rozbaľovacieho zoznamu Stocks (Zásoby) vyberte možnosť „BOND Slide Label“ (Štítko sklíčka BOND).

- 6 Kliknite na kartu **Stocks** (Zásoby).

Obrázok 10-25: Predvolené možnosti tlače – karta Stocks (Zásoby)

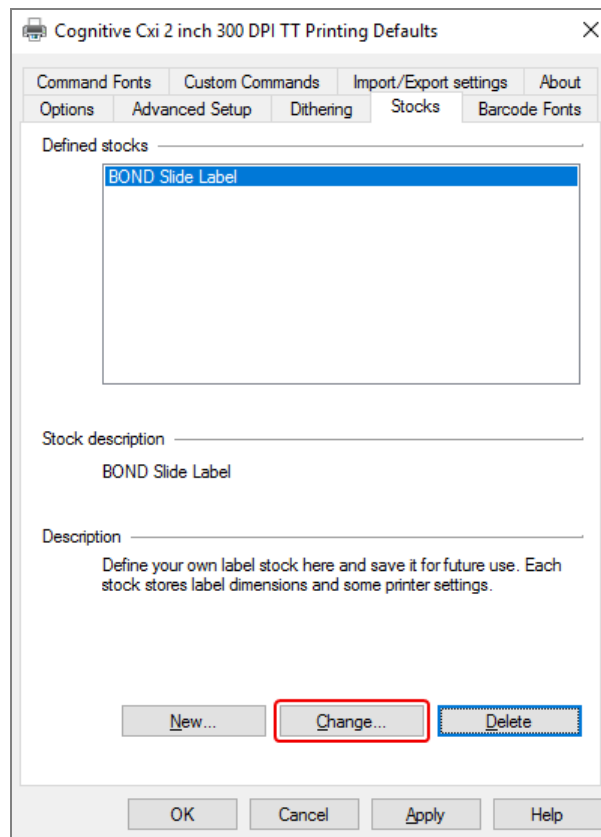

7 Kliknite na tlačidlo **Change...** (Zmeniť...).

System zobrazí dialógové okno **Define Stock** (Definovať zásoby), ako je to znázornené na **Obrázok 10-19**.

Obrázok 10-26: Dialógové okno Define Stock (Definovať zásoby)

- Ak je ľavý okraj orezaný, mierne znížte hodnotu **Right** (Vpravo) v časti **Unprintable Area** (Nepotlačiteľná oblasť), napríklad z 0,50 mm na 0,30 mm.
- Ak je pravý okraj orezaný, mierne zvýšte hodnotu **Right** (Vpravo) v časti **Unprintable Area** (Nepotlačiteľná oblasť), napríklad z 0,50 mm na 0,70 mm.
- Ak je horný alebo dolný okraj odrezaný, pozrite si časť **Úprava zvislej polohy štítka na tlačiarni Cognitive Cxi** (Sekcia 10.6.3.5 na strane 273).

- 8 Kliknite na tlačidlo **OK**.



Po kliknutí na tlačidlo **OK** sa môže zobraziť chybové hlásenie **Stock name already used by system form database** (Názov zásob už použitý v databáze systémových formulárov). V tomto prípade upravte pole **Name** (Názov) v dialógovom okne **Define Stock** (Definovať zásoby), ako je znázornené na **Obrázok 10-27**, potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Obrázok 10-27: Premenovanie zásoby štítkov


The image shows a dialog box titled "Define Stock" with a question mark and a close button (X) in the top right corner. The "Name" field contains the text "BOND Slide Label 1" and is highlighted with a red rectangular border. Below the "Name" field is the "Options" section, which contains two dropdown menus: "Darkness" with the value "300" and "Speed" with the value "Low".

- 9 Vytlačte štítok a skontrolujte výsledok. Opakujte postup, až kým štítok nie je prijateľný (neoreže sa žiaden text).

10.6.3.5 Úprava zvislej polohy štítka na tlačiarni Cognitive Cxi

Ak je poloha štítka príliš vysoko alebo nízko, v dialógovom okne **Printing Defaults** (Predvolené nastavenia tlače) vyberte kartu **Advanced Setup** (Rozšírené nastavenie), ako to znázorňuje **Obrázok 10-28**.

Obrázok 10-28: Karta Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

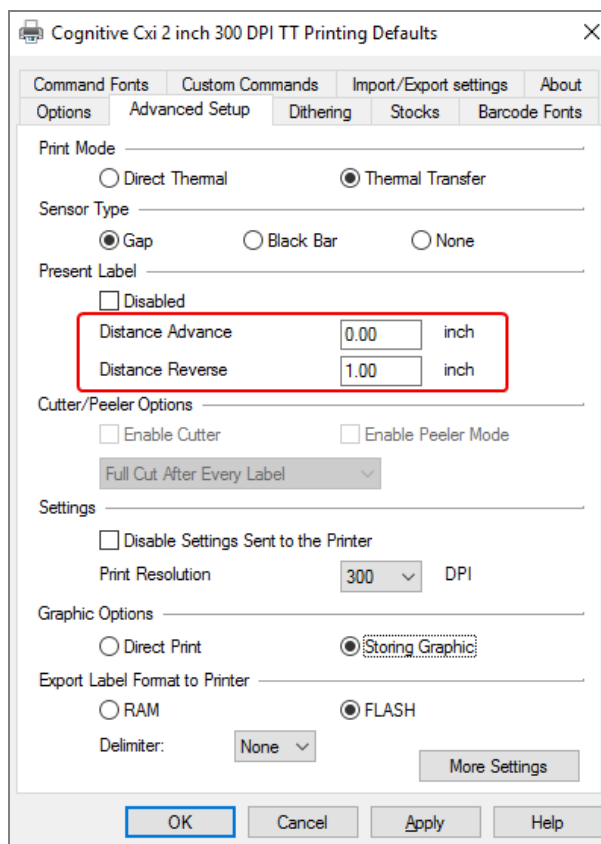

- Ak je horný okraj orezaný, mierne zvýšte hodnotu **Distance Advance** (Vzdialenosť vopred) v časti **Present Label** (Súčasný štítok) napríklad z 0.00 mm na 1.00 mm.
- Ak je spodný okraj orezaný, mierne zvýšte hodnotu **Distance Reverse** (Vzdialenosť dozadu) v časti **Present Label** (Súčasný štítok) napríklad z 0.00 mm na 1.00 mm.
- Použite úpravy iba na jedno nastavenie. Ak už existuje hodnota v časti **Distance Advance** (Vzdialenosť vopred) a spodný okraj je orezaný, znížte hodnotu **Distance Advance** (Vzdialenosť vopred), a nezvyšujte hodnotu **Distance Reverse** (Vzdialenosť dozadu). Jedna hodnota zostáva na nule a druhá hodnota riadi polohu.

- 1 Kliknite na tlačidlo **OK**.
- 2 Vytlačte štítok a skontrolujte výsledok. Opakujte postup, až kým štítok nie je prijateľný (neoreže sa žiaden text).

11

Integračný balík LIS (na BOND riadiacom zariadení)

Voliteľný integračný balík LIS (LIS-ip) BOND pripája systém BOND k akémukoľvek kompatibilnému laboratórnemu informačnému systému (LIS). Balík LIS-ip odovzdá informácie o prípade a sklíčku zo systému LIS do systému BOND a systém BOND vráti informácie o spracovaní cez balík LIS-ip do systému LIS.

Balík LIS-ip je vysoko konfigurovateľný a môže pracovať s mnohými rôznymi typmi systémov LIS a laboratórnymi pracovnými postupmi. Balík LIS-ip môže byť nakonfigurovaný tak, aby poskytoval bezproblémovú integráciu medzi systémom LIS a systémom BOND umožňujúcim automatické rozpoznávanie sklíčok LIS, čo eliminuje potrebu opätovného označenia sklíčok. Pozrite si časť **Pracovné postupy (Sekcia 11.8 na strane 284)**, kde nájdete všeobecný prehľad dostupných pracovných postupov.

Spoločnosť Leica Biosystems zabezpečuje komplexné školenie pre každú inštaláciu osobitne.

V nasledujúcich častiach nájdete informácie o balíku BOND LIS-ip:

- Podmienky týkajúce sa prevádzky balíka LIS-ip
Pozrite si časť **11.1 Terminológia systému LIS**
- Podrobnosti o ďalších softvérových funkciách
Pozrite si časť **11.2 Ďalšie softvérové funkcie**
- Prehľad pripojenia a konfigurácie systému LIS
Pozrite si časť **11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS**
- Opis indikácie chyby a obnovy systému LIS
Pozrite si časť **11.4 Oznámenia systému LIS**
Referenčný zoznam údajov z prípadov a sklíčok
Pozrite si časť **11.5 Požiadavky na údaje o prípade a sklíčku**
- Opis údajov o stave sklíčka dokáže balík BOND LIS-ip nahlásiť do systému LIS
Pozrite si časť **11.6 Posielanie údajov o sklíčku späť do systému LIS**
- Odkaz na požiadavky na štítky sklíčok
Pozrite si časť **11.7 Značkovače sklíčok**
- Prehľad typických implementácií systému LIS
Pozrite si časť **11.8 Pracovné postupy**.

11.1 Terminológia systému LIS

Na opis funkčnosti systému LIS a na rozlíšenie medzi normálnymi prvkami systému BOND a prvkami systému LIS sa vyžaduje množstvo nových pojmov. Tieto položky sú opísané v nasledujúcom zozname.

- LIS – laboratórny informačný systém; softvér, ktorý riadi informácie súvisiace s prácou laboratória.
- LIS-ip – integračný balík systému BOND LIS, voliteľný doplnok, ktorý umožňuje systému BOND spolupracovať so systémom LIS.
- Sklíčko LIS – sklíčko vytvorené v systéme LIS a odoslané do systému BOND na spracovanie.
- Prípád LIS – prípad vytvorený v systéme LIS a zaslaný do systému BOND.
- Štítok sklíčka s autoidentifikátorom – štítok sklíčka, ktorý dokáže systém BOND rozpoznať automaticky. Tieto štítky môžu byť vytlačené pomocou systému BOND alebo systému LIS, pokiaľ sa používa rozpoznateľný formát čiarového kódu. Pozrite si časť [11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS](#).
- Štítok s asistenčným identifikátorom – akýkoľvek štítok sklíčka, ktorý systém BOND nedokáže rozpoznať automaticky.
- Štítok sklíčka LIS – štítok sklíčka z tlačiarne pripojenej k systému LIS. Štítok sklíčka LIS zobrazuje čiarový kód LIS a akékoľvek ďalšie informácie nakonfigurované pre štítok v systéme LIS.
- Štítok sklíčka BOND-LIS – štítok sklíčka pre sklíčko, ktorý bol vytvorený v systéme LIS, ale vytlačený na tlačiarne pripojenej k systému BOND. Štítok BOND-LIS používa konfiguráciu štítka sklíčka BOND LIS, ktorú je možné upravovať pomocou softvéru BOND.
- Číslo záznamu – bežný výraz systému LIS pre číslo alebo iný identifikátor, ktorý identifikuje konkrétny prípad. Číslo záznamu je ekvivalent identifikátora prípadu systému BOND.
- Údaje o pacientovi – detaily pacienta, ktoré tvoria „prípád“ v systéme BOND.
- Demografické údaje – bežný výraz systému LIS pre údaje o pacientoch alebo o prípadoch.
- Čiarový kód LIS – čiarový kód pridelený systémom LIS, ktorý jednoznačne identifikuje každé sklíčko LIS.

11.2 Ďalšie softvérové funkcie

Systémy BOND s povoleným systémom LIS majú ďalšie softvérové funkcie, ktoré sa nenachádzajú v štandardnej verzii. BOND Systémy LIS-ip si zachovávajú všetky vlastnosti a funkcie štandardného softvéru BOND.

Pozrite si:

- [11.2.1 Ikona stavu systému LIS](#)
- [11.2.2 Prípady LIS](#)
- [11.2.3 Sklíčka LIS](#)
- [11.2.4 Názvy verejných značkovačov](#)
- [11.2.5 Prioritné sklíčka](#)
- [11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS](#)
- [11.7 Značkovače sklíčok](#)

11.2.1 Ikona stavu systému LIS

Obrázok 11-1: Ikona stavu systému LIS v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND



Softvér BOND s balíkom LIS-ip obsahuje ikonu stavu systému LIS úplne vpravo na štandardnom paneli funkcií. Zobrazuje nasledujúce:

- stav pripojenia systému LIS (pozrite si časť [11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS](#)),
- indikáciu chyby systému LIS (pozrite si časť [11.4 Oznámenia systému LIS](#)).

11.2.2 Prípady LIS

Prípady LIS sú prípady, ktoré sa vytvoria v systéme LIS a potom sa zašlú do systému BOND. Naopak, prípady BOND sú prípady vytvorené v systéme BOND.

- Prípady LIS obsahujú rovnaké vlastné polia ako prípady BOND, ale po zaslaní prípadu do systému BOND nemožno upravovať žiadne informácie.
- Systém BOND automaticky prideli každému prípadu LIS jedinečné číslo prípadu.
- Číslo záznamu alebo identifikátor prípadu LIS sa stáva identifikátor prípadu v rámci systému BOND.
- Ak je tento identifikátor prípadu totožný s identifikátorom existujúceho prípadu BOND, nový prípad LIS sa zamietne. V systéme LIS musíte zmeniť identifikátor prípadu.

- Ak sú identifikátor prípadu a meno pacienta nového prípadu LIS rovnaké ako v prípade aktívneho prípadu LIS a už sú uvedené na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka), automaticky sa použije existujúci prípad. Sklíčka v „novom“ prípade sa pridajú k sklíčkam v existujúcom prípade. Ak sú identifikátory prípadu rovnaké, ale mená pacientov sú odlišné, nový prípad sa odmietne.
- Ak je identifikátor prípadu a meno pacienta v prípade LIS rovnaké ako v prípade s expirovaným alebo odstráneným prípadom LIS v systéme BOND, buď sa existujúci prípad obnoví, alebo sa nový prípad zamietne v závislosti od vášho nastavenia na obrazovke klienta správy LIS (pozrite si časť **Duplicitný identifikátor prípadu (Sekcia na strane 240)**).
- Sklíčka pridané do prípadu LIS pomocou softvéru BOND sa vytvárajú ako sklíčka BOND.
- Prípady LIS majú rovnaký predvolený prípravný protokol a dávkovaný objem ako prípady BOND, ako je stanovené v klientovi správy (pozrite si časť **10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka**).

11.2.3 Sklíčka LIS

Sklíčka LIS sú sklíčka, ktoré boli vytvorené v systéme LIS a potom odoslané do systému BOND. Naopak, sklíčka BOND sú sklíčka vytvorené v systéme BOND, a to buď v prípade BOND alebo prípade LIS.

Sklíčka LIS možno v zozname sklíčok identifikovať podľa ich farby označenia: sklíčka LIS majú sivý štítok.

Obrázok 11-2: Sklíčko LIS (vľavo) a rutinné sklíčko BOND s jedným farbením (vpravo)



Na sklíčka LIS sa vzťahujú tieto body:

- Štítky vytlačené zo systému LIS zvyčajne obsahujú čiarový kód. Ak je čiarový kód v jednom zo šiestich formátov podporovaných systémom BOND a systém BOND bol nakonfigurovaný na čítanie tohto formátu, potom systém BOND dokáže identifikovať sklíčko pri načítaní. Pozrite si časť **11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS**.
- Štítky vytlačené zo systému BOND pre sklíčka LIS používajú konfiguráciu štítka sklíčka LIS BOND. Pozrite si časť **10.3 Labels (Štítky)**.
- Sklíčka LIS môžu obsahovať ďalšie polia špecifické pre systém LIS. Pozrite si časť **11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS**.
- Vlastnosti sklíčok pochádzajúcich zo systému LIS nie je možné upravovať pomocou softvéru BOND.
- Keď sa softvér BOND používa na kopírovanie sklíčka LIS, kópia sa vytvára ako sklíčko BOND pomocou a konfigurácie štítka sklíčka BOND. Všetky polia špecifické pre systém LIS sa odstránia a všetky polia sa dajú upravovať.

11.2.4 Názvy verejných značkovačov

Názvy verejných značkovačov (pre primárne protilátky a sondy) poskytujú spojenie medzi značkovačmi špecifikovanými v LIS a tými, ktoré sú zaregistrované v systéme BOND. Keď systém LIS špecifikuje značkovač pre test, systém BOND používa pre tento test reagentie s rovnakým názvom verejného značkovača. Systém BOND odmietne test špecifikovaný v systéme LIS, ak neexistuje žiadny verejný názov zodpovedajúci názvu značkovača LIS.

Názvy verejných značkovačov sa určujú pomocou poľa **Public name** (Verejný názov) v dialógovom okne **Edit reagent properties** (Upravte vlastnosti reagentií) (pozrite si časť [8.2](#) **Obrazovka nastavenia reagentií**). Toto pole sa stane viditeľným, iba ak je nainštalovaný balík LIS-ip.

Každý verejný názov musí byť jedinečný. Verejné názvy pre reagentie BOND je možné kedykoľvek zamieňať a keď k tomu dôjde, sklíčka, ktoré už boli vytvorené, nie sú ovplyvnené.

11.2.5 Prioritné sklíčka

Systém LIS môže určiť prioritné sklíčka, ktoré vyžadujú neodkladné spracovanie. Každý prípad, ktorý obsahuje prioritné sklíčko, sa zobrazí s červeným pruhom na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka).



Ak chcete uprednostniť sklíčko v module spracovania BOND-PRIME, vložte do zásuvky na predbežné vloženie iba prioritné sklíčko a pred vložením ďalších sklíčok do zásuvky na predbežné vloženie počkajte, kým sa tieto sklíčka prenesú na spracovanie.

Obrázok 11-3: Prípady s prioritnými sklíčkami zvýraznenými červenou farbou na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka)

Case ID	Patient name	Doctor name	Slides
LS0012 - 45216	Shady, Albert	Joseph	1
20130416-ISHRefine	Benjamin Hightower	Kevin Pannell	10
20130416-IHC	Fannie Hurley	Arthur Josey	10



V súčasnosti sa prioritný prípad LIS na začiatku pridá na spodok zoznamu. Prípad sa zobrazuje v hornej časti zoznamu až v nasledujúcich reláciách klinického klienta.

Prioritné sklíčka sú označené červeným písmenom „P“.

Obrázok 11-4: Prioritné sklíčko LIS, ako sa zobrazuje na obrazovke **Slide setup** (Nastavenie sklíčka)



11.2.6 Dátové polia sklíčka v LIS

Okrem štandardných vlastností sklíčka má balík BOND LIS-ip sedem konfigurovateľných dátových polí, ktoré je možné nastaviť tak, aby zobrazovali vybrané informácie zo systému LIS. Základné pripojenie nastavuje servisný zástupca spoločnosti Leica Biosystems počas inštalácie. Keď už je však na mieste, používatelia sa môžu rozhodnúť zobrazovať alebo nezobrazovať polia a môžu nastaviť názov každého poľa – pozrite si časť **Dátové polia sklíčka v LIS (Sekcia na strane 240)**.

Polia sa zobrazujú na špeciálnej karte **LIS** v dialógovom okne **Slide properties** (Vlastnosti sklíčka) a možno ich vytlačiť aj na štítky sklíčok (pozrite si časť **10.3 Labels (Štítky)**). Sú určené iba na účely podávania správ a nemajú žiadny vplyv na spracovanie sklíčok.

11.3 Pripojenie a inicializácia systému LIS

Každý modul BOND LISip musí byť nainštalovaný autorizovaným zástupcom spoločnosti Leica Biosystems, ktorý prispôsobí operáciu v súlade s požiadavkami jednotlivých laboratórií.

Systém BOND je možné nakonfigurovať tak, aby čítal ktorýkoľvek z nasledujúcich formátov čiarového kódu:

2D čiarové kódy,	
QR,	
Aztec,	
Data Matrix.	

Po nainštalovaní modulu LIS sa v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND zobrazí ikona LIS označujúca stav pripojenia (**Obrázok 11-5**)

Obrázok 11-5: Systém LIS nie je pripojený (vľavo) a je pripojený (vpravo)



11.4 Oznámenia systému LIS

Softvér BOND indikuje pripojenie systému LIS alebo chyby údajov zobrazením ikony stavu systému LIS v pravom hornom rohu obrazovky softvéru BOND (pozrite si časť [11.2.1 Ikona stavu systému LIS](#)). Ak sú v systéme nejaké nevybavené oznámenia systému LIS, zobrazí sa počítadlo počtu nevybavených oznámení. Keď nastane nová udalosť na oznámenie, počítadlo krátko zabliká.

Obrázok 11-6: Ikona stavu systému LIS



Ak chcete nájsť podrobnosti o oznámení, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu stavu a vyberte položku **Show LIS report** (Zobraziť správu systému LIS) a otvorte dialógové okno **LIS service events** (Servisné udalosti systému LIS). V dialógovom okne sa zobrazia chyby a všetky sklíčka, ktoré neboli úspešne prenesené. Uvedený je aj dôvod chyby. Typické chyby systému LIS zahŕňajú chýbajúce údaje, konflikty údajov (napr. rovnaké číslo záznamu použité pre rôzne prípady) alebo prípady, keď verejný značkovač nie je zaregistrovaný v systéme BOND (pozrite si časť [11.2.4 Názvy verejných značkovačov](#)).

Obrázok 11-7: Dialógové okno LIS service events (Servisné udalosti systému LIS)

ID	Date	Event N°	Details	Message	
1...	24-Jan-17 2:33...	7012	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP Marker2 ID Tissue type test Message ID 002.1 Barcode 88820	Unable to add LIS slide - Barcode already used	Acknowledge
1...	24-Jan-17 2:34...	7007	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP Marker2 ID Tissue type tesst Message ID 002.1 Barcode 88820	Cannot map tissue type	Acknowledge
1...	24-Jan-17 2:35...	7006	Case ID LS0012-45210 Patient ID PID120 Doctor ID Dr Jones Marker ID GFAP	Marker does not exist	Acknowledge

Close

V závislosti od konfigurácie systému LIS môže byť možné chyby opraviť a znovu odoslať prípad alebo sklíčko. Ak systém LIS nie je schopný opätovne odoslať informácie, prípad alebo sklíčko sa môžu vytvoriť priamo pomocou softvéru BOND.

Po prečítaní každej chybovej správy kliknite na súvisiace tlačidlo **Acknowledge** (Potvrdiť) na odstránenie oznamu z dialógového okna.

Keď sa všetky chybové správy vymažú z dialógového okna, počítadlo oznámení zmizne z obrazovky.



V prípade potreby môžete správy zobrazit' aj v protokole služieb systému LIS kliknutím na logo Leica Biosystems v pravom hornom rohu obrazovky klienta správy na zobrazenie dialógového okna **About BOND** (Informácie o BOND). Potom kliknite na tlačidlo **Service log** (Servisný denník) a z rozbaľovacieho zoznamu **Serial No.** (Sériové číslo) vyberte možnosť ***LIS***. Voliteľne nastavte časový rámec a potom kliknite na tlačidlo **Generate** (Generovať) na vygenerovanie denníka služby systému LIS.

11.5 Požiadavky na údaje o prípade a sklíčku

Údaje požadované systémom BOND zo systému LIS na import prípadov a sklíčok sú uvedené v častiach nižšie (pozrite si časť [11.5.1 Údaje o prípade](#) a [11.5.2 Údaje sklíčka](#)).



Údaje v systéme LIS o prípadoch a sklíčkach nie je možné v systéme BOND zmeniť, s výnimkou komentárov pre sklíčka.

11.5.1 Údaje o prípade

11.5.1.1 Povinné polia

Názov poľa BOND	Opis	Bežné výrazy v systéme LIS
Case ID (Identifikátor prípadu)	Číslo alebo názov identifikujúce prípad	Číslo záznamu Číslo objednávky

11.5.1.2 Nepovinné polia

Názov poľa BOND	Opis	Bežné výrazy v systéme LIS
Meno pacienta	Meno pacienta	Meno pacienta Identifikátor pridelený laboratóriu (labAssld)
Doctor (Lekár)	Odporúčajúci lekár	Meno a/alebo identifikátor lekára Ošetrujúci lekár Objednávajúci lekár

11.5.2 Údaje sklíčka

11.5.2.1 Povinné polia

Názov poľa BOND	Opis	Bežné výrazy v systéme LIS	Komentáre
Marker (Značkovač)	Primárna protilátka (IHC) alebo sonda (ISH)	Primárna protilátka (IHC) Sonda (ISH) Značkovač (ktorýkoľvek) Farbenie	Verejný názov poskytuje spojenie medzi značkovačmi určenými systémom LIS a značkovačmi zaregistrovanými v systéme BOND. Pre každý značkovač, ktorý bude uvedený v systéme LIS, sa musí uviesť verejný názov. Pozrite si časť 11.2.4 Názvy verejných značkovačov . Každý značkovač má predvolené protokoly farbenia a predúpravy, ktoré je možné v prípade potreby zmeniť pomocou softvéru BOND.

11.5.2.2 Nepovinné polia

Názov poľa BOND	Opis	Bežné výrazy v systéme LIS	Komentáre
[Čiarový kód LIS] Poznámka: Čiarový kód nie je viditeľný pre používateľa v systéme BOND	Jedinečný čiarový kód identifikátor pridelený každému sklíčku v systéme LIS (identifikátor odstránených sklíčok sa nedá znovu použiť)	Čiarový kód	Musí sa dodať kompletný čiarový kód identifikátora pre systém BOND na rozpoznanie sklíčka. Vyžaduje sa to pri použití pracovného postupu LIS 1 (pozrite si časť 11.8 Pracovné postupy).
Tissue type (Typ tkaniva)	Testovacia alebo kontrolná vzorka tkaniva (pozitívna alebo negatívna)	Typ testu	Ak systém LIS tieto informácie neposkytuje, použije sa predvolená hodnota „Test“. Pozrite si časť 6.2.1 Kontrolná vzorka tkaniva .
Komentáre	Akýkoľvek komentár alebo pokyn týkajúci sa sklíčka	Komentár	Ak systém LIS odošle aktualizáciu sklíčka LIS, všetky nové komentáre sklíčka sa pripoja k existujúcim komentárom sklíčka.

11.6 Posielanie údajov o sklíčku späť do systému LIS

Balík BOND LIS-ip dokáže nahlásiť stav sklíčka do systému LIS. Balík BOND LIS-ip môže nahlásiť nasledujúce informácie:

- Sklíčko vytvorené – zadané sklíčko bolo vytvorené v rámci softvéru BOND
- Sklíčko vytlačené – pre zadané sklíčko bol vytlačený štítok
- Sklíčko sa spracúva – zadané sklíčko sa spracúva
- Sklíčko spracované – zadané sklíčka dokončili spracovanie (s chybami alebo bez chýb)
- Sklíčko odstránené – zadané sklíčko bolo zo systému BOND odstránené.

11.7 Značkovače sklíčok

Každé fyzické sklíčko vyžaduje identifikačný štítok, aby sa mohlo prispôbiť informáciám o správnom prípade a teste. V najvýhodnejšom pracovnom postupe majú sklíčka LIS vytlačené štítky LIS („štítky sklíčok LIS“) a tieto štítky rozpoznáva systém BOND. To je však možné, iba ak:

- 1 BOND systém LIS poskytuje jedinečný čiarový kód pre každé sklíčko do systému.
- 2 tlačiareň LIS používa jeden z formátov čiarového kódu, ktoré podporuje systém BOND.

Ak váš systém LIS nespĺňa tieto požiadavky, potom systém BOND môže vytvoriť vlastné štítky pre sklíčka LIS – „štítky sklíčok balíka BOND-LIS“. V tomto prípade môžete voliteľne nastaviť systém BOND tak, že bude spracovávať sklíčka LIS iba vtedy, ak ich štítky vytlačí systém BOND. Táto možnosť sa nastavuje v klientovi správy na obrazovke LIS – pozrite si časť [10.2 LIS \(Laboratórny informačný systém\)](#).

Alternatívne je možné použiť štítky od tretích strán alebo ručne napísané štítky. Tieto štítky sa musia ručne identifikovať v systéme BOND pred spracovaním (pozrite si časť [5.1.5.2 Manuálna identifikácia sklíčok v systéme](#)).

11.8 Pracovné postupy

Aj keď je každá implementácia balíka LIS-ip vysoko prispôsobená, stále je užitočné poskytnúť niekoľko všeobecných opisov pracovných postupov balíka BOND LIS-ip na základe hlavných možností balíka LIS-ip. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené štyri pracovné postupy. Možné sú aj iné pracovné postupy. K dispozícii sú komplexné školenia pre každú inštaláciu osobitne.

Pracovný postup	Údaje zo systému LIS	Údaje zadané v systéme BOND	Štítky vytlačené v systéme	Identifikácia
1	Údaje o prípade a sklíčku (s čiarovým kódom LIS)	Žiadne	LIS (Laboratórny informačný systém)	Automatická
2	Údaje o prípade a sklíčku	Žiadne	System BOND	Automatická
3		Dodatočné sklíčko	System BOND	Automatická
4		Žiadne	Externé	Asistovaná

Pracovný postup 1 je najpohodlnejší, pretože poskytuje bezproblémovú integráciu medzi systémom LIS a systémom BOND. Systém BOND automaticky rozpozná sklíčka LIS a spracovanie sa môže začať okamžite, bez toho, aby sa sklíčka museli opätovne označiť alebo zadávať ďalšie informácie.

12 Čistenie a údržba (len BOND-III a BOND-MAX)



Postupy čistenia a údržby súvisiace s modulom spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.



VÝSTRAHA: Pri vykonávaní úloh čistenia alebo údržby vždy vypnite modul spracovania (okrem prípadu, keď sú spustená nasávací sonda alebo robot na nebalenú tekutinu čisté).



VÝSTRAHA: Niektoré z reagensí používaných v imunohistochemickom rozbere a in situ hybridizácii sú nebezpečné. Pred pokračovaním sa uistite, že ste absolvovali primerané školenie pre tento postup:

- 1 Pri manipulácii s reagensmi alebo čistení modulu spracovania používajte latexové alebo nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iný vhodný ochranný odev.
- 2 S reagensmi a kondenzátom manipulujte a likvidujte ich v súlade so všetkými postupmi a štátnymi nariadeniami, ktoré platia v laboratóriu.



VÝSTRAHA: Moduly spracovania majú ohrievače a vyhrievané povrchy, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo vznietenia, ak sa do ich blízkosti umiestnia horľavé materiály.

Na ohrievače ani blízko nich nekladte horľavé materiály.

Na modul spracovania nekladte horľavé materiály.

Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.



VÝSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklíčok a ich okolím. Môžu byť veľmi horúce a spôsobiť vážne popáleniny. Po ukončení činnosti nechajte zostavy na farbenie sklíčok a ich okolie vychladnúť dvadsať minút.



POZOR: Všetky vymeniteľné komponenty čistite iba rukou. V automatickej umývačke riadu neumývajte žiadne súčasti, aby ste predišli poškodeniu. Nečistite žiadnu časť rozpúšťadlami, tvrdými ani drsnými čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými či drsnými utierkami.

V tejto kapitole sú uvedené postupy čistenia a údržby. V klinickom klientovi sa nachádza obrazovka údržby pre každý modul spracovania v systéme. Kliknutím na kartu modulu spracovania na ľavej strane hlavného okna zobrazíte jeho obrazovku **System status** (Stav systému) a potom kliknite na kartu **Maintenance** (Údržba).

Viac informácií nájdete na obrazovke **5.3 Obrazovka údržby** (Údržba). Vždy, keď budete používať systém BOND, dávajte pozor na netesnosti, opotrebované alebo poškodené časti. Ak sú v tejto kapitole uvedené pokyny na opravu alebo výmenu opotrebovaného alebo chybného dielu, postupujte podľa týchto pokynov. V opačnom prípade sa obráťte na oddelenie podpory zákazníka.

Preventívna údržba

Okrem pravidelných úloh údržby uvedených v tejto kapitole (vykonávaných používateľmi) sa moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX majú pravidelne opravovať prostredníctvom zástupcu servisu spoločnosti Leica Biosystems.

V prípade systému BOND-III a BOND-MAX vás softvér BOND upozorní, aby ste pre každý modul spracovania zabezpečili preventívnu údržbu raz ročne alebo po každých 15 600 sklíčkach (podľa toho, čo nastane skôr).



Počet sa vynuluje pomocou tlačidla **Maintenance complete** (Údržba je dokončená) na karte **Processing modules** (Moduly spracovania) v klientovi správy (**10.6.1 Moduly spracovania**).

Táto kapitola má nasledujúce časti:

- [12.1 Plán čistenia a údržby](#)
- [12.2 Nádoby na nebalený materiál](#)
- [12.3 krycie sklíčka Covertile](#)
- [12.4 Zostava na farbenie sklíčok](#)
- [12.5 Reštart modulu spracovania](#)
- [12.6 Nasávacia sonda](#)
- [12.7 Premývací blok a zmiešavacia stanica](#)
- [12.8 Kryty, dvere a veko](#)
- [12.9 Snímač identifikátorov](#)
- [12.10 Odkvapkávací podnos](#)
- [12.11 Podnosy na sklíčka](#)
- [12.12 Sondy robota na nebalenú tekutinu \(len BOND-III\)](#)
- [12.13 Injekčné striekačky](#)
- [12.14 Poistky napájania](#)

12.1 Plán čistenia a údržby

Použite nasledujúci plán, ak farbíte maximálne 300 sklíčok týždenne na jeden modul spracovania. Ak ich spracúvate viac, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka ohľadom prispôbeného plánu.

Úloha	Sekcia
Denne – začiatok dňa	
Skontrolujte, či sú nádoby na nebalený odpad naplnené maximálne do polovice.*	12.2
Skontrolujte, či sú nádoby na nebalené reagenty naplnené adekvátnou reagenciou pre dni farbenia*	12.2
Denne – koniec dňa	
Vyčistite krycie sklíčka Covertile	12.3
Týždenne	
Vyčistite zostavy na farbenie sklíčok*	12.4
Skontrolujte svorky krycích sklíčok Covertile	12.4
Reštartujte modul spracovania	12.5
Utrite nasávaciu sondu v ramene robota	12.6
Skontrolujte premývacie bloky a zmiešavaciu stanicu – v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.	12.7
Vyčistite kryty, dvere (ak sú namontované) a veko	12.8
Vyčistite snímač identifikátorov	12.9
Vyčistite ručnú čítačku čiarových kódov	13.1
Mesačne	
Vyčistite všetky odkvapkávacie podnosy*	12.10
Vymeňte zmiešavaciu stanicu	12.7
Vyčistite nádoby na nebalené reagenty	12.2
Vyčistite nádoby na nebalený odpad	12.2
Vyčistite podnosy na sklíčka	12.11
Vyčistite sondy s robotmi na nebalenú tekutinu (BOND-III)	12.12
Vyčistite značkovač sklíčok	13.2
Skontrolujte injekčné striekačky	12.13
Po zobrazení výzvy	
Vyčistite nasávaciu sondu hlavného robota	12.6.1
Vymeňte injekčné striekačky	12.13

* V prípade potreby tieto úlohy vykonávajte častejšie, ako bolo naplánované.

12.1.1 Kontrolné zoznamy čistenia a údržby

Na nasledujúcej strane sa uvádza plán údržby reprodukováný v tabuľke určenej na tlač a použitie ako kontrolný zoznam. K dispozícii sú oblasti na zaznamenanie čísel šarží roztokov BOND Wash, ER1, ER2 a Dewax. Po dokončení úloh skontrolujte alebo inicializujte zostávajúce bunky.

Plán čistenia a údržby

	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne						
DENNE													
Skontrolujte nádoby na nebalené reagenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Číslo šarže premývacieho roztoku BOND													
Číslo šarže ER1													
Číslo šarže ER2													
Číslo šarže roztoku na odvoskovanie													
Skontrolujte nádoby na odpad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Vyčistite krycie sklíčka Covertile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
TÝŽDENNE													
Vyčistite zostavy na farbenie sklíčok*	<input type="checkbox"/>	Pre BOND-MAX: <ul style="list-style-type: none"> • Ak je na nádobe na externý odpad iba jedno viečko, pred odskrutkovaním odpojte kábel a privody tekutín. • Ak sú nádoby na nebalený materiál nepriehľadné, zdvihnite konce nádob na mieste, aby ste odhadli objem – nie je potrebné odstraňovať nádoby z modulu spracovania. *V prípade potreby čistite častejšie, ako bolo naplánované											
Skontrolujte svorky krycích sklíčok Covertile	<input type="checkbox"/>												
Reštartujte PM	<input type="checkbox"/>												
Utrite nasávaciu sondu	<input type="checkbox"/>												
Skontrolujte premývací blok a zmiešavaciu stanicu	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite kryty, dvere (ak sú namontované) a veko	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite snímač identifikátorov	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite ručnú čítačku	<input type="checkbox"/>												
MESAČNE													
Vyčistite odkvapkávacie podnosy	<input type="checkbox"/>												
Vymeňte zmiešavaciu stanicu	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite nádoby na nebalené reagenty	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite nádoby na nebalený odpad	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite podnosy na sklíčka	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite sondy s robotmi na nebalenú tekutinu (len BOND-III)	<input type="checkbox"/>												
Vyčistite značkovač sklíčok	<input type="checkbox"/>												

	Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
Skontrolujte injekčné striekačky	<input type="checkbox"/>	Za týždeň od do					
PO ZOBRAZENÍ VÝZVY							
Vyčistite nasávaciu sondu	<input type="checkbox"/>	Za mesiac					
Vymeňte injekčné striekačky	<input type="checkbox"/>						

12.2 Nádoby na nebalený materiál



VÝSTRAHA: Niektoré z reagensí používaných v imunohistochemickom rozbere a in situ hybridizácii sú nebezpečné. Pred pokračovaním sa uistite, že ste absolvovali primerané školenie pre tento postup:

- 1 Pri manipulácii s reagensiami alebo čistení modulu spracovania používajte latexové alebo nitrilové rukavice, ochranné okuliare a iný vhodný ochranný odev.
- 2 S reagensiami a kondenzátom manipulujte a likvidujte ich v súlade so všetkými príslušnými postupmi a štátnymi nariadeniami, ktoré platia v zariadení.



VÝSTRAHA: Niektoré reagensie použité na moduloch spracovania BOND sú horľavé:

Neumiestňujte plameň ani zdroj zapálenia do blízkosti modulov spracovania.

Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádob na nebalený materiál riadne uzavreté.

Hladiny v nádobách na nebalený materiál kontrolujte (aspoň) každý deň a každý mesiac nádoby na nebalený materiál vyčistite. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

- [12.2.1 Kontrola hladín v nádobách](#)
- [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#)
- [12.2.3 Čistenie nádob na nebalený materiál](#)
- [12.2.4 Nádobu na externý odpad \(len BOND-MAX\)](#)

12.2.1 Kontrola hladín v nádobách

Na začiatku každého dňa skontrolujte hladinu v nádobách na nebalený materiál. Skontrolujte ju aj pred spustením nočného alebo dlhšieho cyklu. V laboratóriách s vysokým obratom môže byť potrebné naplánovať dve kontroly nádob na nebalený materiál denne.

V systéme BOND-III a na súčasnom modeli modulov spracovania BOND-MAX (a všetkých nádobách na externý odpad BOND-MAX) sú hladiny kvapaliny viditeľné cez steny nádoby. V prípade modelov BOND-MAX s nepriehľadnými nádobami zdvihnite konce nádob, aby ste odhadli objem – nie je potrebné ich vyberať z modulu spracovania, pretože pri ich návrate sa spustí preplachovanie fluidiky.

Ikony na obrazovke **System status** (Stav systému) uvádzajú hladiny v nádobách na nebalený materiál pre systém BOND-III a používajú sa na oznamovanie vysokých hladín odpadu alebo nízkych hladín reagensie na systéme BOND-MAX. Ikony používajte iba na potvrdenie hladín a/alebo na prezeranie oznámení – nenahrádzajú denné fyzické kontroly.



Moduly spracovania BOND-III sú vybavené systémom osvetlenia nádob na nebalený materiál (pozrite si časť [Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál \(BOND-III\) \(Sekcia na strane 53\)](#)).

Naplňte alebo vyprázdňte nádoby za nasledujúcich podmienok:

- Vyprázdňte tie nádoby na odpad, ktoré sú naplnené viac ako do polovice
- Znova naplňte nádoby na reagentie, aby ste sa uistili, že je k dispozícii adekvátne množstvo reagentie.

Pozrite si časť [12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál](#).



VÝSTRAHA: Skontrolujte hladinu v nádobe na nebalený materiál a podľa potreby ich vyprázdňte alebo naplňte na začiatku každého dňa (v prípade potreby častejšie – pozrite si pokyny vyššie). V opačnom prípade môže dôjsť k pozastaveniu cyklov, čo môže ohroziť farbenie.

12.2.2 Dopĺňanie alebo vyprázdňovanie nádob na nebalený materiál

Keď kontrolujete hladiny nádob na nebalený materiál, vyprázdňte nádoby na odpad, ktoré sú plné viac ako do polovice, a naplňte nádoby na reagentie, aby ste sa uistili, že je k dispozícii adekvátne množstvo reagentie. Únik, ktorý sa vyskytne pri plnení alebo vyprázdňovaní nádob na nebalený materiál, vždy utrite. Pred vrátením do modulu spracovania očistite vonkajšiu stranu nádob a uzáverov.

Pozrite si časť samostatné pokyny na vyprázdňovanie a dopĺňovanie nižšie. V časti [12.2.2.5 Počas cyklov](#) sú uvedené pokyny, ak potrebujete vyprázdniť alebo naplniť nádobu počas cyklu.

- [12.2.2.1 Doplnenie nebalených reagentí – BOND-III](#)
- [12.2.2.2 Vyprázdnite nebezpečného odpadu – BOND-III](#)
- [12.2.2.3 Vyprázdnenie štandardného odpadu – BOND-III](#)
- [12.2.2.4 Vyprázdnenie nebezpečného odpadu alebo doplnenie nebalenej reagentie – BOND-MAX](#)
- [12.2.2.5 Počas cyklov](#)

Pozrite si časť [12.2.4 Nádobu na externý odpad \(len BOND-MAX\)](#), kde nájdete pokyny na vyprázdňovanie externej nádoby BOND-MAX.



VÝSTRAHA: Naplnené alebo vyprázdnené nádoby vždy vráťte na rovnaké miesto na module spracovania. Ak tak neurobíte, môže kontaminovať reagentie a zhoršiť farbenie.



VÝSTRAHA: V nádobách na nebalené reagentie nemeňte typ reagentie. Mohlo by to viesť ku kontaminácii a zhoršeniu farbenia.



POZOR: Nádoby na nebalený materiál nenasúvajte späť na svoje miesto, pretože to môže poškodiť nádobu a snímač kvapaliny.

12.2.2.1 Doplnenie nebalených reagensí – BOND-III

Nádoby na nebalené reagensie BOND-III sa môžu plniť v module spracovania. Nie je potrebné ich odstraňovať z priehradky na nádoby na nebalený materiál.

- 1 Odskrutkujte uzáver nádoby na nebalené reagensie a naplňte nádobu.
- 2 Keď je nádoba plná, nasadte uzáver a utiahnite ho.



VÝSTRAHA: Ak používate lievik pri pridávaní reagensie do nádob na moduloch spracovania BOND-III, zabezpečte, aby bol lievik čistý. Ak tak neurobíte, môže kontaminovať reagensie a zhoršiť farbenie.

12.2.2.2 Vyprázdniť nebezpečného odpadu – BOND-III

- 1 Uistite sa, že modul spracovania nie je v prevádzke. (Ak sa však počas prevádzky zobrazí oznámenie, že nádoba na odpad je plná, vyprázdniť nádobu podľa týchto pokynov – pozrite si časť tiež časť [12.2.2.5 Počas cyklov.](#))
- 2 Vytiahnite nádobu z priehradky na nádoby na nebalený materiál.
- 3 Otvorte uzáver a zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.
- 4 Nasadte uzáver a utiahnite ho.
- 5 Vráťte nádobu do modulu spracovania. Jemne zatlačte, až kým nebudete cítiť, ako je konektor nádoby zarovnaný s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nádobu pevne zatlačte, až kým konektor úplne nezapadne, aby ste zabezpečili tesné spojenie.

12.2.2.3 Vyprázdnenie štandardného odpadu – BOND-III

Keďže existujú dve nádoby na štandardný odpad, môžete vybrať plnú nádobu (na ikone sa zobrazuje ikona plnej nádoby na obrazovke **System status** (Stav systému) kedykoľvek, aj počas spracovania (pozrite si časť [5.1.3.6 Stav nádoby na nebalený materiál](#)). Nikdy však neodstraňujte obidve nádoby na nebalený odpad, keď je modul spracovania v prevádzke, a ak sa nádoba nezobrazuje ako plná na obrazovke **System status** (Stav systému), odporúčame pred odstránením počkať, kým sa spracovanie neskončí. Ak je bezpečné odstrániť nádobu na nebalený odpad, postupujte podľa pokynov ako pri vyprázdňovaní nebezpečného odpadu z vyššie uvedeného kroku (2).


Obrázok 12-1: Vrátenie nádoby na odpad na svoje miesto



12.2.2.4 Vyprázdnenie nebezpečného odpadu alebo doplnenie nebalenej reagensie – BOND-MAX

- 1 Uistite sa, že modul spracovania nie je v prevádzke. (Ak sa však počas prevádzky zobrazí oznámenie, že nádoba na odpad je plná, vyprázdnite nádobu podľa týchto pokynov – pozrite si časť tiež časť 12.2.2.5 Počas cyklov.)
- 2 Vytiahnite nádobu z priehradky na nádobu na nebalený materiál.

Obrázok 12-2: Nádoba na nebezpečný odpad BOND-MAX (vľavo) a nádoba na nebalený materiál (vpravo)

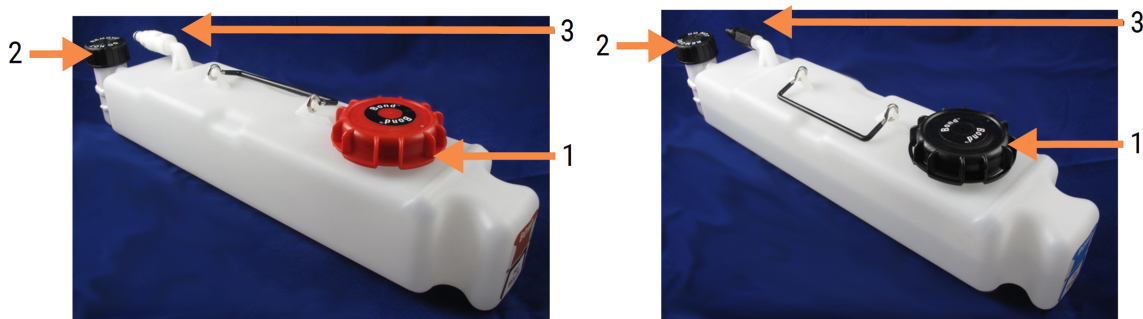

Legenda

- 1 Plniaci/vyprázdňovací uzáver (modrý uzáver na novších nádobách na nebezpečný odpad)
- 2 Uzáver snímača hladiny kvapaliny
- 3 Konektor

3 Naplňte alebo vyprázdňte nádobu:

- V prípade odpadu otvorte uzáver na plnenie/vyprázdňovanie (položka 1 na **Obrázok 12-2**) a zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.
- V prípade nebalenej reagentie umiestnite nádobu na rovný povrch, otvorte uzáver na plnenie/vyprázdňovanie (položka 1 na **Obrázok 12-2**) a naplňte nádobu tesne pod spodnú časť krku, na ktorý naskrutkuje uzáver.



POZOR: Nevyberajte kryt snímača hladiny kvapaliny z nádoby na nebalený materiál, pretože sa môže poškodiť. Nádoby na nebalený materiál vyprázdňujte a doplňujte iba cez uzáver na plnenie/vyprázdňovanie.


4 Nasadte uzáver a utiahnite ho.

- ### 5 Vráťte nádobu do modulu spracovania. Jemne zatlačte, až kým nebudete cítiť, ako je konektor nádoby zarovnaný s konektorom na zadnej strane skrinky. Potom nádobu pevne zatlačte, až kým konektor úplne nezapadne, aby ste zabezpečili tesné spojenie.

12.2.2.5 Počas cyklov



Ak sa vykonávajú denné kontroly nádob na nebalený materiál (s dodatočnými kontrolami pred nočnými a predĺženými cyklami a pravidelnými dodatočnými kontrolami v laboratóriách s vysokou fluktuáciou), nádoby na odpad by sa nikdy nemali naplniť a nádoby na reagentie by sa počas spracovania nikdy nemali vyčerpať. Ak sa však niektorý z týchto prípadov vyskytne počas cyklu, musíte vyprázdniť alebo naplniť príslušné nádoby. Prečítajte si pokyny uvedené nižšie, aby ste postupovali správne.

Nádoba na odpad plná – BOND-MAX

Ak sa nádoba na odpad počas cyklu takmer naplní, na obrazovke **System status** (Stav systému) sa na ikone príslušnej nádoby zobrazí symbol informácie .


Okamžite vyprázdňte nádobu. Dodržiavajte všetky štandardné bezpečnostné opatrenia a postupy likvidácie odpadu vo vašom zariadení. Rýchlym konaním sa môžete vyhnúť pozastaveniu cyklu alebo môžete skrátiť čas, kedy je pozastavený. Pozastavenie cyklu môže narušiť farbenie.

Ak sa cyklus zastaví, keď vyprázdňujete nádobu, alebo ak budete pokračovať, až kým sa modul spracovania

automaticky nezastaví, spustí sa alarm  (bliká) alebo sa na ikone nádoby zobrazí výstražný symbol . Vyprázdnenú nádobu vráťte čo najskôr s ohľadom na vyššie uvedené pokyny a bezpečnostné opatrenia.

Vytvorte správu o udalostiach cyklu, aby ste videli, aké účinky mala pauza na priebeh.

Nádoba na reagensiu prázdna – BOND-MAX

Ak sa nádoba na nebalené reagensie takmer vyprázdni, na obrazovke **System status** (Stav systému) sa na ikone príslušnej nádoby zobrazí symbol upozornenia .

- 1 Otvorte obrazovku **Protocol status** (Stav protokolu) a zobrazte aktuálne a nasledujúce kroky pre každý cyklus na module spracovania.
- 2 Ak niektoré zo sérií momentálne používajú nebalené reagensie alebo ich čoskoro použijú, počkajte na dokončenie krokov, ktoré používajú danú reagensiu.
- 3 Po dokončení krokov, ktoré používajú nebalené reagensia, vyberte nádobu, čo najskôr ju doplňte a čo najskôr ju vymeňte (pri dodržaní všetkých štandardných bezpečnostných opatrení).

Aby ste ušetrili čas, pravdepodobne nebudete musieť naplniť nádobu na obvyklú maximálnu hladinu.



VÝSTRAHA: Ak sa pri spracovaní musí nádoba na nebalený materiál BOND-MAX naplniť, vždy skontrolujte obrazovku **Protocol status** (Stav protokolu) a skontrolujte, či sa nádoba nepoužíva alebo nie je plánované jej použitie. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu spracovania sklíčok. Ihneď po naplnení nádobu vráťte.

12.2.3 Čistenie nádob na nebalený materiál

Nasledujúce postupy čistenia by sa mali vykonávať mesačne.

12.2.3.1 Nádobu na roztoky ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanú vodu.

- 1 Vyprázdňte nádobu na nebalené reagensie s roztokmi ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanou vodou.
- 2 Umyte nádoby silným priemyselným čistiacim prostriedkom a potom ich dôkladne opláchnite deionizovanou vodou.
- 3 Pred opätovným naplnením čerstvou reagensiou a návratom do modulu spracovania nechajte nádoby uschnúť.

12.2.3.2 Nádobu na odvoskovací roztok a etanol

- 1 Vyprázdňte nádoby na nebalené reagensie s odvoskovacím roztokom a etanolom. Zvyšky odvoskovacieho roztoku a etanolu vyhodte v nádobách na nebalené reagensie zlikvidujte v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.

- 2 Nalejte malý objem čerstvej reagensie do každej nádoby a pohybujte tekutinou okolo stien nádoby, aby ste odstránili všetky kontaminanty. Po dokončení vyprázdňte nádobu. Zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.



Nikdy nedávajte vodu ani saponáty do nádob na etanol alebo odvoskovací roztok.

- 3 Naplňte nádobu na nebalený materiál čerstvou reagensiou a vráťte ju do modulu spracovania.

12.2.3.3 Nádoby na nebalený odpad

- 1 Vyprázdňte všetok odpad z nádob. Zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.
- 2 Vyčistite nádoby na odpad pomocou 0,5 % roztoku bielidla (hm./obj.) alebo priemyselného čistiaceho prostriedku a opláchnite ich dôkladne deionizovanou vodou.
- 3 Vráťte nádoby na odpad do modulu spracovania.

12.2.4 Nádoba na externý odpad (len BOND-MAX)

Vyprázdnite 9 l nádobu na externý štandardný odpad BOND-MAX na začiatku každého dňa a pred začiatkom noci alebo pred dlhými cyklami skontrolujte hladinu. Vyprázdnite, keď je plná na polovicu alebo viac; bielu vodorovnú čiaru na štítku nádoby použite ako ukazovateľ polovičnej hladiny – pozrite si **Obrázok 12-3**.

Obrázok 12-3: Nádoba na externý štandardný odpad BOND-MAX s objemom 9 l



Legenda

- 1 Uzáver na plnenie/vyprázdnovanie
- 2 Polovičná úroveň

Nádoby čistite mesačne, rovnako ako v prípade ostatných nádob na nebalený materiál (pozrite si časť **12.2.3 Čistenie nádob na nebalený materiál**).

- 1 uistite sa, že modul spracovania nie je v prevádzke, (Ak sa však počas prevádzky zobrazí oznámenie, že nádoba na odpad je plná, vyprázdnite nádobu podľa týchto pokynov – pozrite si tiež časť **12.2.2.5 Počas cyklov**.)

- 2 Nádoba má konektory podobné tým, ktoré sú uvedené na **Obrázok 12-4** (nezabudnite, že niektoré konektory snímačov sú čierne, nie strieborné, ako je to znázornené):

Obrázok 12-4:



Legenda

- 1 Konektor snímača hladiny kvapaliny
- 2 Kvapalinový konektor

- a Palcom zdvihnite červenú západku na konektore snímača (1) a vytiahnite konektor z krytu.
 - b Stlačte kovové tlačidlo na kvapalinovom konektore (2) a konektor vytiahnite z uzáveru.
- 3 Ak chcete nádobu vyprázdniť, vyberte uzáver na plnenie/vyprázdňovanie. Neodstraňujte uzáver s konektormi. Zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.
 - 4 Nasadte uzáver na plnenie/vyprázdňovanie a pevne ho dotiahnite a vráťte späť do modulu spracovania.
 - 5 Zatlačte kvapalinový konektor späť na pripojenie uzáveru, kým nezacvakne na mieste.
 - 6 Znova pripojte konektor snímača. Zatlačte konektor nadol k základni pripojenia uzáveru.



VÝSTRAHA: Po naplnení je nádoba na externý odpad ťažká.

Pri vyprázdňovaní nádoby na externý odpad používajte správne techniky zdvíhania.



POZOR: Pred vyprázdnením nádoby vždy odpojte konektory senzora a kvapaliny, aby ste predišli poškodeniu.

12.3 krycie sklíčka Covertile

Po každom použití očistite krytie sklíčka Covertile (na tento účel je možné použiť ochranný stojan na čistenie krycích sklíčok Covertile Leica Biosystems). Krycie sklíčka Covertile sa môžu opätovne použiť až 25-krát za predpokladu, že nie sú poškodené alebo nemajú výrazne zmenenú farbu, a ak sú správne vyčistené. Krycie sklíčka Covertile zlikvidujte, ak sú poškodené alebo ak sa zhoršuje kvalita farbenia.

12.3.1 Odstránenie zvyšku DAB (voliteľné)

- 1 Namočte najmenej na 30 minút do čerstvého roztoku 0.5% hm./obj. chlórnanu sodného v deionizovanej vode.
- 2 Vyberte a ponorte do čerstvej deionizovanej vody 10-krát.
- 3 Dokončite štandardné čistenie (pozrite si časť nižšie).

12.3.2 Štandardné čistenie (povinné)

- 1 Namočte najmenej na 10 minút v 100 % IMS (priemyselný metylovaný lieh), etanole alebo etanole reagenčného stupňa.
- 2 Miešajte 30 sekúnd a vyberte.
- 3 Nechajte vyschnúť:
 - utrite dosucha handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, alebo
 - na vzduchu.
- 4 Opatrne skontrolujte, či krycie sklíčka Covertile neobsahujú úlomky, praskliny alebo deformácie. Ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené, zlikvidujte ich.

12.4 Zostava na farbenie sklíčok



VÝSTRAHA: Moduly spracovania majú ohrievače a vyhrievané povrchy, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo vznietenia, ak sa do ich blízkosti umiestnia horľavé materiály.

- Na ohrievače ani blízko nich nekladte horľavé materiály.
- Na modul spracovania nekladte horľavé materiály.
- Po doplnení alebo vyprázdnení sa uistite, že sú všetky uzávery nádoby na nebalený materiál riadne uzavreté.



VÝSTRAHA: Vyvarujte sa kontaktu so zostavami na farbenie sklíčok a ich okolím. Môžu byť veľmi horúce a spôsobiť vážne popáleniny. Po ukončení činnosti nechajte zostavy na farbenie sklíčok a ich okolie vychladnúť dvadsať minút.



POZOR: Určené komponenty čistite iba rukou. V automatickej umývačke riadu neumývajte žiadne súčasti, aby ste predišli poškodeniu. Nečistite žiadnu časť rozpúšťadlami, tvrdými ani drsnými čistiacimi prostriedkami alebo tvrdými či drsnými utierkami.



POZOR: Pred čistením alebo odstránením hornej dosky zaistite, aby boli roboty na nebalenú tekutinu (BOND-III) v pôvodnej polohe v zadnej časti modulu spracovania a aby neboli umiestnené pred zostavami na farbenie sklíčok.



POZOR: Nepoužívajte vatové tyčinky ani iné aplikátory s hrotmi z bavlny na čistenie vnútorných otvorov premývacieho bloku alebo v odsávacích stĺpkoch zostavy na farbenie sklíčok, pretože sa môže vatový konček uvoľniť a spôsobiť upchatie.

Štandardné čistenie

Zostavy na farbenie sklíčka čistite každý týždeň alebo častejšie, ak sú na ňom viditeľné usadeniny.

Používajte handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenú v 70 % etanole (čo najmenej). Na ťažko odstrániteľné zrazeniny použite roztok BOND Wash (čo najmenej) a potom opláchnite deionizovanou vodou.


V prípade systému BOND-III utrite vodiacu koľajnicu robota na nebalenú tekutinu (položka 3 na [Obrázok 12-6](#)).

Vyklopte hornú dosku (pozrite si časť [Demontáž hornej dosky \(Sekcia na strane 303\)](#)) a vyčistite:

- vyhrievacie podložky,
- drenážne otvory a mazacie stĺpiky,
- oblasti medzi vyhrievacími podložkami,
- odkvapkávací podnos okolo podložiek.

Vždy skontrolujte, či drenážne otvory (vrátane malých odsávacích stĺpikov na okrajoch portov) neobsahujú cudzí materiál a či nie sú poškrábané ani inak poškodené. Ak dôjde k poškodeniu týchto alebo akýchkoľvek iných súčastí zostáv na farbenie sklíčok, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Obrázok 12-5: Zostava na farbenie sklíčok s otvorenou hornou doskou

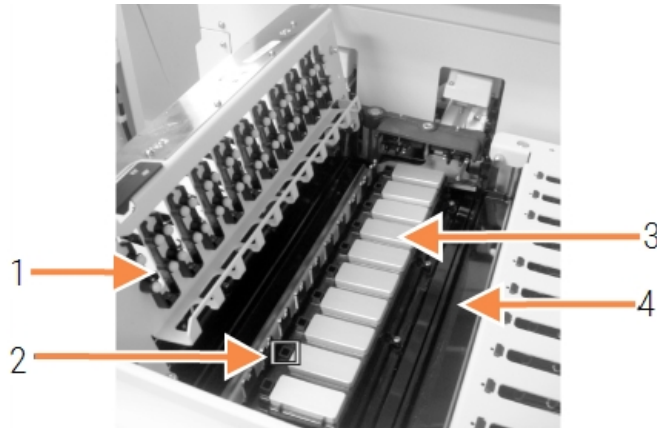

Legenda

- 1 Svorky krycích sklíčok
Covertile
- 2 Drenážny otvor a odsávacie
stĺpiky
- 3 vyhrievacie podložky,
- 4 Odkvapkávací podnos

Keď je horná doska otvorená, skontrolujte svorky krycích sklíčok Covertile na spodnej strane platne a zaistite voľný pohyb pružinových nožičiek. Ak upínacie pružiny pri stlačení pružinou nevyskočia, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka a požiadajte o výmenu.

Demontáž hornej dosky

- 1 Uistite sa, že je modul spracovania nečinný a že nie je vložený žiadny podnos na sklíčka, a vypnite napájanie.
- 2 Otvorte hornú dosku zatlačením nadol na hornú dosku a skrútením modrých upevňovacích prvkov na oboch koncoch (položky 1 na **Obrázok 12-6** a **Obrázok 12-7**) o štvrt' otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Vyklopte hornú dosku späť na jej pántoch (keď je modul spracovania otočený, pravá strana hornej platne sa otvorí).

Obrázok 12-6: Horná doska BOND-III



Legenda

- 1 Otočné spojovacie prvky
- 2 Otočné pánty
- 3 Vodiaca koľajnica robota na nebalenú tekutinu

Obrázok 12-7: Horná doska BOND-MAX




Legenda

- 1 Otočné spojovacie prvky
- 2 Otočné pánty

- 3 Ak chcete úplne odstrániť hornú dosku (nevyžaduje sa na bežné čistenie), potiahnite pružinové otočné upevňovacie prvky na každom konci platne (položky 2 na **Obrázok 12-6** a **Obrázok 12-7**) a potom dosku zdvihnite zo zostavy na farbenie sklíčok.

Obrázok 12-8: Uvoľnenie otočného spojovacieho prvku hornej dosky

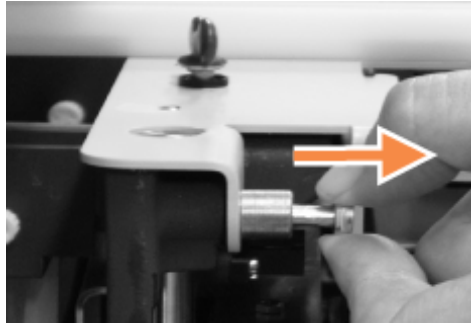

Spätná montáž hornej dosky



Horné dosky na farbenie sklíčok BOND-III sú očíslované. Vždy umiestňujte správnu hornú dosku na správnu zostavu na zafarbenie sklíčok (pri protiahlom module spracovania je zostava na farbenie sklíčok na ľavej strane číslo jedna).

- 1 Vyhľadajte otočné body na zostave na farbenie sklíčok. Držte hornú dosku v otvorenej polohe a jeden z otočných upevňovacích prvkov umiestnite do otočného bodu zostavy na farbenie sklíčok.
- 2 Vytiahnite druhý otočný upevňovací prvok a koniec dosky umiestnite na svoje miesto a potom uvoľnite upevňovací prvok.
- 3 Zatvorte hornú dosku a skontrolujte, či otvory na každom konci platne správne zapadajú do polohovacích kolíkov.
- 4 Pridržte hornú dosku a otočte upevňovacie prvky v smere hodinových ručičiek. Mali by sa pevne zviazať pri otočení o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

12.4.1 Ručné odomykanie zostáv na farbenie sklíčok

Každá zostava na farbenie sklíčok sa môže odomknúť ručne, napríklad na odstránenie sklíčok v prípade výpadku napájania.



VÝSTRAHA: Zostavy na farbenie sklíčok obsahujú pohyblivé časti, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie. Predtým, ako sa pokúsite ručne odomknúť zostavy na farbenie sklíčok: vypnite hlavný vypínač modulu spracovania, vypnite sieťovú zástrčku a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- **12.4.1.1 BOND-III**
- **12.4.1.2 BOND-MAX**

12.4.1.1 BOND-III



VÝSTRAHA: Modul pumpy injekčných striekačiek (BOND-III) je ťažký a po uvoľnení môže spadnúť. Tento postup by mali vykonávať iba operátori, ktorí boli upozornení na potenciálne nebezpečenstvo a ktorí absolvovali primeranú odbornú prípravu.

Manuálne odomknutie zostavy na farbenie sklíčok na systéme BOND:

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Odskrutkujte štyri šesťhranné skrutky pripevňujúce kryt modulu injekčných striekačiek pomocou 3 mm kľúča s vnútorným šesťhranom. Z dôvodu lepšieho prístupu k uvoľňovacím kolíkom a rukoväti modulu odstráňte kryt.
- 3 Vyhľadajte dva uvoľňovacie kolíky vedľa pumpy injekčnej striekačky jedna a štyri.

Obrázok 12-9: Umiestnenie uvoľňovacích kolíkov s otvorenou jednotkou pre prístup



- 4 Vytiahnite dva kolíky smerom dopredu k sebe, kým nezacvaknú a nezatlačia modul. Pri pohybe modulu smerom dopredu dávajte pozor, aby ste neťahali ani nestláčali hadičky z tekutín na hlavách injekčných striekačiek.
- 5 Modul pumpy injekčných striekačiek sa otvorí dostatočne na to, aby umožnil prístup do zostáv na farbenie sklíčok.

- 6 Vyhľadajte gombík na ručné uvoľnenie pod zostavou na farbenie sklíčok.

Obrázok 12-10: Gombík na manuálne uvoľnenie



- 7 Otočte gombík v smere znázornenom na **Obrázok 12-10**. Počas tejto činnosti sa krycie sklíčka Covertile posunú po podložných sklíčkach a celá zostava a podnos sa pohnú smerom nahor.
- 8 Pokračujte v otáčaní uvoľňovacieho gombíka, kým nepocítite odpor. V tomto bode by malo byť možné vybrať podnos na sklíčka zo zostavy.
- 9 Sklíčka skladujte podľa postupov vo vašom zariadení.
- 10 Opatrne zatlačte modul pumpy injekčných striekačiek späť na svoje miesto, dávajte pozor, aby ste neťahali ani nestláčali hadičky fluidiky na hlavách striekačiek.
- 11 Zaistite, aby dva kolíky na oboch stranách modulu zacvakli späť do uzamknutej polohy.



POZOR: Pred spustením cyklu alebo inicializáciou modulu spracovania sa uistite, že je modul injekčných striekačiek (BOND-III) úplne zatvorený. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu injekčných striekačiek počas prevádzky.

- 12 Nasad'te kryt modulu injekčnej striekačky a zaistite ho pomocou štyroch šesťhranných skrutiek.

Pred zapnutím modulu spracovania je potrebné skontrolovať položku **Protocol status** (Stav protokolu) (pozrite si **5.2 Obrazovka stavu protokolu**).

Keď je modul spracovania zapnutý, inicializuje sa, zistí stav zostáv a podnikne všetky kroky potrebné na ich prípravu na použitie.

Po inicializácii sa stav zostavy na farbenie sklíčok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia žiadne kroky. Môže byť možné dokončiť spracovanie na systéme BOND-III, prípadne dokončíte zvyšné kroky manuálne.

12.4.1.2 BOND-MAX

Manuálne odomknutie zostavy na farbenie sklíčok pre systém BOND-MAX vykonajte takto:

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Otvorte dvierka nádob na nebalený materiál a vyberte nádoby na nebalený materiál.
- 3 Vysuňte podnos v hornej časti priehradky na nádoby na nebalený materiál von.
- 4 Vyhľadajte ručné uvoľňovacie tlačidlo (pozrite si **Obrázok 12-10**) pod zostavou na farbenie sklíčok.
- 5 Otočte gombík v smere znázornenom na **Obrázok 12-10**. Počas tejto činnosti by sa krycie sklíčka Covertile mali posunúť po podložných sklíčkach a celá zostava a podnos sa pohnú smerom nahor.
- 6 Pokračujte v otáčaní uvoľňovacieho gombíka, kým nepocítite odpor. V tomto bode by malo byť možné vybrať podnos na sklíčka zo zostavy.
- 7 Sklíčka skladujte podľa postupov vo vašom zariadení.
- 8 Vyčistite spodnú a hornú odkvapkávaciu misku, ak je to potrebné, potom znovu vložte hornú misku do priehradky na nádoby na nebalený materiál – koniec podnosu so zahnutím 45 stupňov smeruje dopredu, s uhlom nahor.
- 9 Znovu vložte nádoby na nebalený materiál.
- 10 Zatvorte dvierka priehradky na nádoby na nebalený materiál.

Pred zapnutím modulu spracovania je potrebné skontrolovať položku **Protocol status** (Stav protokolu) (pozrite si **5.2 Obrazovka stavu protokolu**).

Keď je modul spracovania zapnutý, inicializuje sa, zistí stav zostáv a podnikne všetky kroky potrebné na ich prípravu na použitie.

Po inicializácii sa stav zostavy na farbenie sklíčok odomkne a na obrazovke stavu protokolu sa nezobrazia žiadne kroky. Môže byť možné dokončiť spracovanie na systéme BOND-MAX, prípadne dokončíte zvyšné kroky manuálne.

12.5 Reštart modulu spracovania

Každý modul spracovania by sa mal vypnúť a reštartovať každý týždeň. Je to dôležité, pretože to umožňuje modulu spracovania dokončiť autodiagnostickú kontrolu systému.

Riadiace zariadenie BOND s jednou stanicou sa nemusí vypínať a reštartovať pravidelne. Ak však dôjde k viditeľnému spomaleniu softvéru BOND, možno budete musieť reštartovať riadiace zariadenie pomocou ponuky Štart systému Windows.

Ak však máte systém BOND-ADVANCE, pozrite si časť [16.1 Reštartovanie systému BOND-ADVANCE](#).

Modul spracovania

V prípade modulov spracovania sa uistite, že nie sú načítané, naplánované alebo spracované žiadne cykly, a vypnite ich pomocou vypínača na pravej strane modulu spracovania. Počkajte 30 sekúnd a potom ich znovu zapnite. Pri spustení systém BOND pripraví systém fluidiky a vykoná niekoľko systémových testov (pozrite si časť [2.2.2 Inicializácia modulu spracovania](#)).

Upozorňujeme, že môžete spustiť čiastočné naplnenie systému fluidiky bez vypnutia modulu spracovania (pozrite si časť [Čistenie fluidiky](#)).

Čistenie fluidiky

Pomocou tlačidla **Clean fluidics** (Čistenie fluidiky) na obrazovke **Maintenance** (Údržba) sa prepláchnu hadičky fluidiky z nádob na nebalený materiál (časť inicializácie modulu spracovania spustená pri štarte). Spustite rutinný postup, ak máte podozrenie na zablokovanie alebo vzduch v dávkovacom systéme fluidiky.

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný a nemá načítané, naplánované ani nespracováva žiadne cykly.
- 2 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).
- 3 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Clean fluidics** (Čistenie fluidiky).
- 4 Po výzve na potvrdenie kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno).
- 5 Systém fluidiky je prepláchnutý, čo môže trvať niekoľko minút.

12.6 Nasávacia sonda

Nasávacia sonda sa automaticky čistí v premývacom bloku medzi kontaktom s každou reagensiou ako súčasť normálnej prevádzky. Je však potrebné vykonávať aj dodatočné týždenné čistenie a čistenie pomocou čistiaceho systému nasávacej sondy BOND. Reagencie čistiaceho systému sú optimalizované pre systém BOND a softvér BOND používa čistiaci protokol určený na maximalizáciu účinnosti prania. Softvér BOND upozorňuje používateľov, keď dôjde k vyčisteniu a výmene sondy.



VÝSTRAHA: Pokiaľ je modul spracovania zapnutý, nepohybujte hlavným ramenom robota. Robot sa môže vyrovnať, čo má za následok zlé farbenie.

Ak bol robot presunutý: vypnite modul spracovania, počkajte 30 sekúnd a potom ho znovu inicializujte.

Pozrite si:

- [12.6.1 Čistenie nasávacej sondy](#)

12.6.1 Čistenie nasávacej sondy

Pred utieraním vždy vypnite modul spracovania a dávajte pozor, aby ste sondu neohli. Exteriér nasávacej sondy utierajte každý týždeň pomocou 70 % roztoku etanolu na handričke, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, alebo tampónu namočeného v etanole. Skontrolujte hadičku pripojenú k nasávacej sonde a uistite sa, že vo vnútri hadičky nie sú žiadne zlomy alebo cudzie predmety. Hadička by mala byť čistá.

Softvér BOND vás upozorní, aby ste vyčistili sondu pomocou systému na čistenie nasávacích sond BOND po každých 300 sklíčkach (pozrite si časť [12.6.2 Spustenie čistenia nasávacej sondy](#)). Počet sa automaticky vynuluje, keď je spustené čistenie alebo je sonda úspešne vymenená.



Systémy na čistenie nasávacej sondy BOND by sa mali zaregistrovať v systéme BOND po prijatí rovnakým spôsobom ako detekčné systémy (pozrite si časť [8.3.3 Registrácia reagensí a systémov reagensí](#)). Tento softvér vedie záznamy o používaní čistiaceho systému a umožňuje 15 čistení z každého systému.



Na zachovanie účinnosti reagensí v čistiacich systémoch ich vkladajte do modulov spracovania iba vtedy, keď sa majú použiť. Pokiaľ je do modulu spracovania vložená iná reagentia alebo systém reagensí, nie je možné vyčistiť nasávaciu sondu, a keď je do modulu spracovania vložený čistiaci systém, nie je možné spustiť spracovanie sklíčka.

12.6.2 Spustenie čistenia nasávacej sondy

Podľa pokynov nižšie vyčistíte nasávaciu sondu pomocou systému na čistenie nasávacej sondy BOND.


Spustenie čistiaceho protokolu trvá približne 20 minút.

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný a nemá načítané, naplánované ani nespracováva žiadne cykly.
- 2 Z modulu spracovania vyberte všetky reagentie alebo podnosy systému reagentií.
- 3 Vložte systém na čistenie nasávacích sond BOND do podnosu na reagentie na module spracovania.
- 4 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).
- 5 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Clean aspirating probe** (Čistenie nasávacej sondy).
- 6 Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo **Yes** (Áno) spustíte čistenie.
Spustí sa protokol čistenia označený ikonou čistenia na karte modulu spracovania.
- 7 Počkajte, kým sa nezobrazí upozornenie, že sa čistenie ukončilo.
- 8 Odstráňte systém na čistenie nasávacích sond BOND z podnosu na reagentie.
- 9 Kliknutím na tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Cleaning complete** (Čistenie je dokončené) pokračujte v normálnej prevádzke.

12.7 Premývací blok a zmiešavacia stanica

Zmiešavacie stanica obsahuje šesť jamiek na miešanie reagensí. Hodí sa ako vložka do premývacieho bloku.

Obrázok 12-11: Pohľad zhora na premývací blok s umývacou oblasťou (1) a zmiešavacou stanicou (2) na svojom mieste

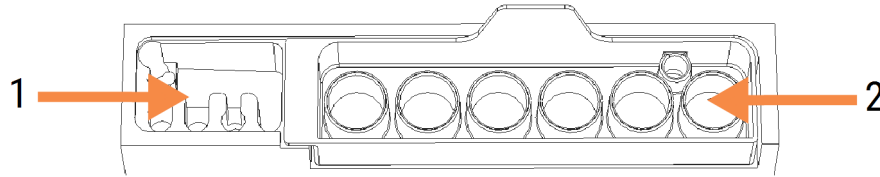

VÝSTRAHA: Niektoré z reagensí používaných v imunohistochemickom rozbere a in situ hybridizácii sú nebezpečné. Pred pokračovaním sa uistite, že ste absolvovali primerané bezpečnostné školenie.

Pravidelne kontrolujte zmenu zafarbenia a celkový stav zmiešavacej stanice a v prípade potreby ju vymeňte. Výmenu stanice vykonávajte mesačne ako súčasť bežnej údržby. Pred odstránením vždy skontrolujte, či sú všetky cykly dokončené.

Ak chcete odstrániť zmiešavaciu stanicu, uchopte jazýček na zadnej strane zmiešavacej stanice a vyberte ju.

Čistenie zmiešavacej stanice

Zmiešavaciu stanicu je možné opakovane používať až do uplynutia mesačnej výmeny za predpokladu, že nie je poškodená ani silne sfarbená a je riadne vyčistená.

- 1 Ak sa vyžaduje čistenie, namočte najmenej na 30 minút do čerstvého roztoku % hm./obj. chlórnanu sodného v deionizovanej vode.
- 2 Vyberte a ponorte do čerstvej deionizovanej vody 10-krát.
- 3 Namáčajte najmenej 10 minút v etanole reagenčného stupňa.
- 4 Miešajte 30 sekúnd a vyberte.
- 5 Nechajte vysušiť na vzduchu.

Čistenie premývacieho bloku

Premývací blok čistite každý týždeň pomocou handričky, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.



POZOR: Na čistenie vnútorných otvorov premývacieho bloku nepoužívajte vatové tyčinky ani iné aplikátory s hrotmi z bavlny – ak sa bavlna z hrotov uvoľní, môže tieto otvory zablokať.

12.8 Kryty, dvere a veko

Každý deň čistite kryty, dvere (ak sú nainštalované) a veko modulu spracovania prachovkou alebo handričkou.


Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ak je to potrebné, navlhčite vodou handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, a utrite kryty, dvere a veko, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt.

Ak sa niektorý z krytov, dvere alebo veko zdeformujú alebo poškodia, požiadajte oddelenie podpory zákazníka o výmenu.

12.9 Snímač identifikátorov

Okno snímača identifikátorov na hlavnom ramene robota sa musí udržiavať čisté, aby sa zabezpečilo správne identifikovanie sklíčok. Každý týždeň, alebo ak sa v snímači často nedarí správne identifikovať identifikátor, vyčistite okno handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou 70 % roztokom etanolu.

Obrázok 12-12: Snímač identifikátorov

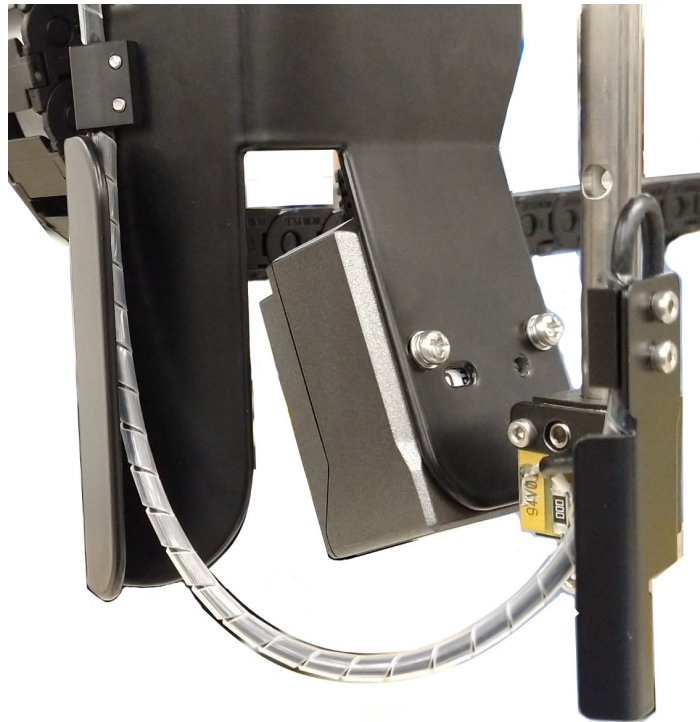

12.10 Odkvapkávací podnos

Odkvapkávacie podnosy čistíte mesačne alebo častejšie, ak sa objaví rozliata reagentia alebo odpad. Ak existujú dôkazy o nadmernom rozliatí alebo usadení soli na podnosoch, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

- [12.10.1 BOND-III Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál](#)
- [12.10.2 Odkvapkávací podnos modulu spracovania BOND-III](#)
- [12.10.3 BOND-MAX Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál](#)

12.10.1 BOND-III Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál

Systém BOND-III má dva odkvapkávacie podnosy pre nádoby na nebalený materiál, ktoré sa nachádzajú pod nádobami na nebalený materiál na hornej a dolnej úrovni modulu spracovania.

Na čistenie odkvapkávacích podnosov nádoby na nebalený materiál BOND-III použite nasledujúci postup:

- 1 uistite sa, že modul spracovania nie je v prevádzke,
- 2 odstráňte všetky nádoby na nebalený materiál,

- 3 odstráňte čierne kryty, ktoré chránia snímače hmotnosti každej nádoby na nebalený materiál (pozrite si **Obrázok 12-13**). Každý kryt utrite handričkou alebo gázou navlhčenou v 70 % roztoku etanolu.

Obrázok 12-13: Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál BOND-III, na ktorých sú znázornené kryty snímača hmotnosti



- 4 Odkvapkávacie podnosy utrite 70 % roztokom etanolu. Vyhnite sa kontaktu s exponovanými kovovými snímačmi hmotnosti.
- 5 Odkvapkávacie podnosy vysušte papierovou utierkou.
- 6 Utrite všetky nádoby na nebalený materiál a vráťte ich na správne miesto.

12.10.2 Odkvapkávací podnos modulu spracovania BOND-III

Systém BOND-III má tretí odkvapkávací podnos umiestnený pod modulom spracovania, ako to znázorňuje **Obrázok 12-14** nižšie.

Obrázok 12-14: Odkvapkávací podnos modulu spracovania BOND-III



Na prístup k odkvapkávaciemu podnosu modulu spracovania použite nasledujúci postup:

- 1 Vyhľadajte odkvapkávací podnos pod modulom spracovania (pozrite si **Obrázok 12-14**) a vytiahnite podnos von. Obidvomi rukami podopierajte podnos a zabráňte rozliatiu kvapaliny.
- 2 Vyprázdňte obsah podnosu a zlikvidujte odpad v súlade so schválenými postupmi vo vašom zariadení.



Podnos má v zadnom rohu kanálik, ktorý pomáha pri vylievaní a zabraňuje rozliatiu.

- 3 Podnos umyte 70 % roztokom etanolu a potom ho vráťte do správnej polohy.

12.10.3 BOND-MAX Odkvapkávacie podnosy nádoby na nebalený materiál

Systém BOND-MAX má jeden odkvapkávací podnos umiestnený pod nádobami na nebalený materiál v priehradke na nádoby na nebalený materiál.

Na prístup k odkvapkávaciemu podnosu nádoby na nebalený materiál použite nasledujúci postup:

- 1 Uistite sa, že modul spracovania nie je v prevádzke, a vyberte všetky nádoby na nebalený materiál.
- 2 Vyberte odkvapkávací podnos a utrite ho handričkou alebo gázou navlhčenou v 70 % roztoku etanolu.
- 3 Vysušte odkvapkávací podnos papierovou utierkou a vráťte ho do správnej polohy (zakrivená hrana v prednej časti modulu spracovania).
- 4 Utrite všetky nádoby na nebalený materiál a vráťte ich na správne miesto.

12.11 Podnosy na sklíčka

Podnosy na sklíčka čistite každý mesiac umývaním teplou mydlovou vodou a opláchnutím tečúcou vodou. Pred použitím vždy skontrolujte, či sú podnosy na sklíčka suché. Vymeňte zdeformované alebo poškodené podnosy.

12.12 Sondy robota na nebalenú tekutinu (len BOND-III)

Sonda každého robota na nebalenú tekutinu vyžaduje každý mesiac čistenie 70 % roztokom etanolu na handričke, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, alebo tampónom namočeným v etanole.

Počas čistenia skontrolujte poškodenie sond a v prípade potreby ich vymeňte.

- [12.12.1 Čistenie sond robota na nebalenú tekutinu](#)

12.12.1 Čistenie sond robota na nebalenú tekutinu

Dávkovacie sondy robota na nebalenú tekutinu čistite každý mesiac, pričom dbajte na to, aby sa sondy neohýbali.




VÝSTRAHA: Roboty na nebalenú tekutinu sa pohybujú pozdĺž zostáv na farbenie sklíčok, aby umožnili používateľom prístup na čistenie. Tento postup by mali vykonávať iba operátori, ktorí boli upozornení na potenciálne nebezpečenstvo a ktorí absolvovali primeranú odbornú prípravu.

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný a nemá načítané, naplánované ani nespracováva žiadne cykly.
- 2 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).

- 3 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Clean bulk fluid robot probes** (Vyčistenie sond robota na nebalenú tekutinu).
- 4 Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v dialógovom okne **Clean bulk fluid robot probes** (Vyčistenie sond robota na nebalenú tekutinu), zamknite všetky podnosy na sklíčka a kliknutím na tlačidlo **Yes** (Áno) pokračujte.

Obrázok 12-15: Utrite všetky tri sondy robota na nebalenú tekutinu pomocou 70 % roztoku etanolu (je uvedená sonda)

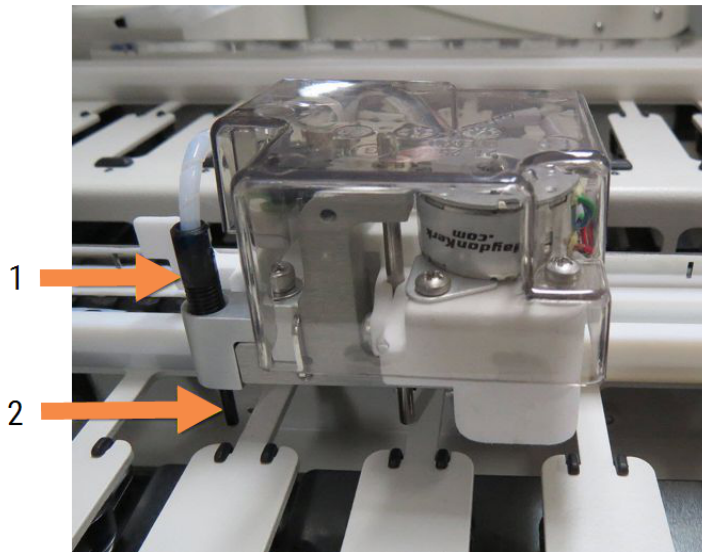

Legenda

- 1 Konektor sondy
- 2 Sonda

- 5 Keď sa všetky tri roboty na nebalenú tekutinu presunuli do prednej časti modulu spracovania, vypnite ho.
- 6 Sondy jemne očistite 70 % roztokom etanolu na mäkkej handričke alebo tampónom namočeným v etanole. Dávajte pozor, aby ste sondy nevyviedli zo zarovnaní.
- 7 V dialógovom okne vyberte roboty na nebalenú tekutinu, ktoré ste úspešne vyčistili, a potom kliknite na tlačidlo **Done** (Hotovo). Ak ste nič nevyčistili, kliknite na tlačidlo **None were cleaned** (Žiadne neboli vyčistené).
- 8 Reštartujte modul spracovania. Počas inicializácie sa roboty na nebalenú tekutinu vrátia do východiskovej polohy na zadnej strane modulu spracovania.

12.13 Injekčné striekačky

Softvér BOND vás upozorní na výmenu injekčnej striekačky (BOND-MAX) alebo injekčných striekačiek (BOND-III) každých šesť mesiacov alebo po spracovaných 7 800 sklíčkach, podľa toho, čo nastane skôr (pozrite si časť [5.1.2 Stav hardvéru](#)).



Vizuálne skontrolujte injekčné striekačky, najmä hornú časť injekčnej striekačky a časť pod piestom, či sa tam nenachádzajú netesnosti, raz za týždeň počas inicializácie alebo počas cyklu čistenia fluidiky (pozrite si časť [12.5 Reštart modulu spracovania](#)). Skontrolujte tiež pripojené hadičky a konektory. Vymeňte, ak sa na nich nachádzajú nejaké netesnosti.

Ak by ste uprednostnili, aby injekčné striekačky vymenil servisný technik spoločnosti Leica Biosystems, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka. V opačnom prípade môžete vymeniť injekčné striekačky podľa opisu nižšie.




VÝSTRAHA: Vždy noste ochranný odev a rukavice.

- 12.13.1 Výmena injekčných striekačiek BOND-III
- 12.13.2 Výmena 9-portovej injekčnej striekačky BOND-MAX

12.13.1 Výmena injekčných striekačiek BOND-III

Pokiaľ nevymeníte jednu chybnú injekčnú striekačku krátko po výmene, vymeňte všetky injekčné striekačky súčasne.

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný (nemá načítané ani naplánované žiadne cykly).
- 2 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).
- 3 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Replace syringe** (Vymeniť injekčnú striekačku).
- 4 Prečítajte si pokyny a kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno).


Modul spracovania odstráni kvapalinu zo všetkých injekčných striekačiek a umiestni ich na miesto na výmenu (môže to trvať až 10 minút). Počkajte na odpojenie modulu spracovania , potom ho vypnite. Nevypínajte riadiace zariadenie (alebo terminál, v systéme BOND-ADVANCE).



POZOR: Pred pokračovaním skontrolujte, či je modul spracovania vypnutý.

- 5 Odskrutkujte štyri šesťhranné skrutky pripevňujúce kryt modulu injekčných striekačiek pomocou 3 mm kľúča s vnútorným šesťhranom. Odstráňte kryt.
- 6 Pre každú injekčnú striekačku uvoľnite skrutku svorky striekačky a sklopte svorku.
- 7 Použite 2.5 mm kľúč s vnútorným šesťhranom na odstránenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej strane piesta.

Obrázok 12-16: Odskrutkujte skrutku piesta pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom.

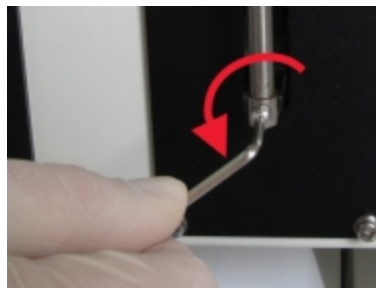


Niektoré modely majú namiesto skrutky s vnútorným šesťhranom krídlovú skrutku.

- 8 Odskrutkujte valec injekčnej striekačky z ventilu. Vyberte injekčnú striekačku a svorku z modulu spracovania.
- 9 Nasadte novú injekčnú striekačku cez svorku.
- 10 Nasadte injekčnú striekačku a svorku na modul spracovania – striekačku naskrutkujte do ventilu.
- 11 Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.
- 12 Nadvihnite svorku na vrch injekčnej striekačky a utiahnite skrutku.
- 13 Nasadte kryt modulu injekčnej striekačky a zaistite ho pomocou štyroch šesťhranných skrutiek.
- 14 V dialógovom okne vyberte injekčné striekačky, ktoré ste úspešne vyčistili, a potom kliknite na tlačidlo **Done** (Hotovo). Ak ste žiadne úspešne nevymenili, kliknite na tlačidlo **None were replaced** (Žiadne neboli nahradené).
- 15 Reštartujte modul spracovania.
- 16 Počas inicializácie modulu spracovania skontrolujte, či nedochádza k úniku, najmä v hornej časti injekčných striekačiek a pod piestami. Akékoľvek úniky nahláste oddeleniu podpory zákazníka.
- 17 Ak chcete skontrolovať, či boli nové injekčné striekačky správne nainštalované, spustite testovacie tkanivá alebo kontrolné tkanivá, aby ste si overili, či je dosiahnuté správne farbenie.

12.13.2 Výmena 9-portovej injekčnej striekačky BOND-MAX

- 1 Uistite sa, že modul spracovania je nečinný (nemá načítané ani naplánované žiadne cykly).
- 2 V klinickom klientovi výberom karty modulu spracovania zobrazte obrazovku **System status** (Stav systému).
- 3 Kliknite na ikonu **Maintenance** (Údržba) a potom kliknite na tlačidlo **Replace syringe** (Vymeniť injekčnú striekačku).
- 4 Prečítajte si pokyny a kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno).

Modul spracovania odstráni kvapalinu z injekčnej striekačky a umiestni ju na miesto na výmenu. Počkajte na odpojenie modulu spracovania , potom ho vypnite. Nevypínajte riadiace zariadenie (alebo terminál, v systéme BOND-ADVANCE).



POZOR: Pred pokračovaním skontrolujte, či je modul spracovania vypnutý.

- 5 Uvoľnite skrutku svorky injekčnej striekačky a sklopte svorku.

- 6 Použite kľúč s vnútorným šesťhranom na odstránenie skrutky na zaistenie piesta na spodnej strane piesta.

Obrázok 12-17: Odskrutkujte skrutku piesta pomocou kľúča s vnútorným šesťhranom.



Niektoré modely majú namiesto skrutky s vnútorným šesťhranom krídlovú skrutku.

- 7 Odskrutkujte valec injekčnej striekačky z ventilu. Vyberte injekčnú striekačku a svorku z modulu spracovania.
- 8 Nasadte novú injekčnú striekačku cez svorku.
- 9 Nasadte injekčnú striekačku a svorku na modul spracovania – striekačku naskrutkujte do ventilu.
- 10 Zaskrutkujte skrutku piestu a utiahnite ju.
- 11 Nadvihnite svorku na vrch injekčnej striekačky a utiahnite skrutku.
- 12 V dialógovom okne kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno) na potvrdenie toho, že ste úspešne vymenili injekčnú striekačku.
- 13 Reštartujte modul spracovania.
- 14 Počas inicializácie modulu spracovania skontrolujte, či nedochádza k únikom, najmä v hornej časti injekčnej striekačky a pod piestom. Akékoľvek úniky nahláste oddeleniu podpory zákazníka.
- 15 Ak chcete skontrolovať, či bola nová injekčná striekačka správne nainštalovaná, spustite testovacie tkanivá alebo kontrolné tkanivá, aby ste si overili, či je dosiahnuté správne farbenie.

12.14 Poistky napájania

Staršie moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX majú dve sieťové poistky a dve poistky napájania ohrievača. Alternatívne moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX majú iba dve sieťové poistky. Hodnoty poistiek sa líšia v závislosti od sieťového napájania. Poistky sú umiestnené na zadnom kryte (pozrite si časť [2.2.13 Zadný kryt](#)).

Starší systém BOND-III používa nasledujúce poistky:

Poistka	Opis	Napájanie 100 – 240 VAC
F1	Napájanie ohrievača	3AG T8A 250V UL
F2	Napájanie systému	3AG T8A 250V UL
F3	Sieťové napájanie (neutrálne)	3AG T15A 250V UL
F4	Sieťové napájanie striedavým prúdom (aktívne)	3AG T15A 250V UL

Alternatívny systém BOND-III používa nasledujúce poistky:

Poistka	Opis	Napájanie 100 – 240 VAC
F3	Sieťové napájanie (neutrálne)	3AG T15A 250V UL
F4	Sieťové napájanie striedavým prúdom (aktívne)	3AG T15A 250V UL

Staršie moduly spracovania BOND-MAX používajú nasledujúce poistky:

Poistka	Opis	Napájanie 100 – 240 VAC
F1	Sieťové napájanie striedavým prúdom (aktívne)	3AG T15A 250V UL
F2	Sieťové napájanie (neutrálne)	3AG T15A 250V UL
F3	24 V napájanie ohrievača	3AG T8A 250V UL
F4	24 V DC napájací zdroj	3AG T8A 250V UL

Alternatívne moduly spracovania BOND-MAX používajú nasledujúce poistky:

Poistka	Opis	Napájanie 100 – 240 VAC
F1	Sieťové napájanie striedavým prúdom (aktívne)	3AG T15A 250V UL
F2	Sieťové napájanie (neutrálne)	3AG T15A 250V UL



VÝSTRAHA: Poistky neprepájajte ani neskratujte.

Pred výmenou poistiek modul spracovania vypnite a odpojte napájací kábel.

Poistky vymeňte iba za štandardné diely a ak poistky opakovane vyhoria, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.

Pri výmene poistiek postupujte takto:

- 1 Vypnite modul spracovania.
- 2 Vypnite sieťové napájanie a odpojte sieťové napájanie zo zásuvky v stene.
- 3 Odskrutkujte kryt poistky.
- 4 Vytiahnite kryt poistky a vymeňte poistku. Uistite sa, že ste vymenili za poistku správnych špecifikácií.
- 5 Zatlačte kryt poistky a zaskrutkujte poistku v smere hodinových ručičiek, aby ste poistku zaistili na svojom mieste. Nedoťahujte príliš.

13 Čistenie a údržba (rôzne)

13.1 Ručné čítačky čiarových kódov

13.1.1 Čítačka čiarových kódov Honeywell



Tieto pokyny sa vzťahujú iba na novšiu čítačku čiarových kódov Honeywell. Ak máte čítačku čiarových kódov Zebra DS2208, pozrite si časť [13.1.2 Čítačka čiarových kódov Zebra DS2208](#).

Vyčistite svoju ručnú čítačku každý týždeň:

- Zabráňte kontaktu akéhokoľvek drsného materiálu s oknom
- Nestriekajte vodu ani iné čistiace kvapaliny priamo do okna

Vyčistite čítačku takto:

- Najskôr odpojte čítačku od riadiaceho zariadenia alebo terminálu.
- Odstráňte nečistoty pomocou navlhčenej handričky, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.
- Vyčistite okno handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou v 70 % roztoku etanolu.

Ak ručná čítačka čiarových kódov nefunguje správne, vaša servisná organizácia môže požiadať o jeho opätovnú inicializáciu. Hlasitosť bzučiaka môžete upraviť aj na čítačke.

13.1.1.1 Konfigurácia čítačky čiarových kódov Honeywell

Ak chcete znova inicializovať čítačku čiarových kódov Honeywell (USB), vytlačte kvalitnú tlačenú kópiu tejto stránky a naskenujte čiarové kódy v uvedenom poradí:

Obrázok 13-1: Čiarové kódy pre konfiguráciu čítačky



Sken 1: Odstránenie vlastných predvolených hodnôt



Sken 2: Aktivácia predvolených hodnôt



Sken 3: Konfigurácia čítačky Honeywell

13.1.1.2 Nastavenie hlasitosti bzučiaka

Ak chcete pre čítačku čiarových kódov Honeywell nastaviť hlasitosť bzučiaka, vytlačte kvalitnú tlačenú kópiu tejto stránky a naskenujte čiarový kód, ktorý zodpovedá požadovanej úrovni.

Obrázok 13-2: Čiarové kódy bzučiaka pre čítačku Honeywell



Nízka hlasitosť



Stredná hlasitosť



Vysoká hlasitosť



Bzučiak vypnutý

13.1.1.3 Konfigurácia použitia bez použitia rúk

Keď je čítačka umiestnená v stojane, používa sa normálne bez použitia rúk a pri čítaní čiarového kódu nemusíte stlačiť spúšť.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prevádzku bez použitia rúk pre čítačku čiarových kódov Honeywell, vytlačte kvalitnú tlačенú kópiu tejto stránky a naskenujte čiarový kód, ktorý zodpovedá požadovanej funkcii.

Obrázok 13-3: Čiarové kódy na prevádzku bez použitia rúk pre čítačku Honeywell



Prevádzka bez použitia rúk ZAPNUTÁ



Prevádzka bez použitia rúk VYPNUTÁ

13.1.2 Čítačka čiarových kódov Zebra DS2208



Tieto pokyny sa vzťahujú iba na novšiu čítačku čiarových kódov Zebra. Ak máte čítačku čiarových kódov Honeywell, pozrite si časť [13.1.1 Čítačka čiarových kódov Honeywell](#).

Vyčistite svoju ručnú čítačku každý týždeň:

- Zabráňte kontaktu akéhokoľvek drsného materiálu s oknom
- Nestriekajte vodu ani iné čistiace kvapaliny priamo do okna

Vyčistite čítačku takto:

- Najskôr odpojte čítačku od riadiaceho zariadenia alebo terminálu.
- Odstráňte nečistoty pomocou navlhčenej handričky, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.
- Vyčistite okno handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou v 70 % roztoku etanolu.

Ak ručná čítačka čiarových kódov nefunguje správne, vaša servisná organizácia môže požiadať o jeho opätovnú inicializáciu. Hlasitosť bzučiaka môžete upraviť aj na čítačke.

13.1.2.1 Konfigurácia čítačky čiarových kódov Zebra

Ak chcete znova inicializovať čítačku čiarových kódov Zebra (USB), vytlačte kvalitnú tlačenú kópiu tejto stránky a naskenujte každý z nasledujúcich čiarových kódov.

Obrázok 13-4: Sekvencia snímania čiarových kódov pre konfiguráciu čítačky Zebra



Sken 1: Nastavenie predvolených hodnôt



Sken 2: Aktivácia kódu 128



Sken 3: Možnosti skenovania



Sken 4: <DATA> <SUFFIX>



Sken 5: Potvrdenie



Sken 6: Prepísať kláves CAPS LOCK (Povolenie)

13.1.2.2 Nastavenie hlasitosti bzučiaka

Ak chcete pre čítačku čiarových kódov Zebra nastaviť hlasitosť bzučiaka, vytlačte kvalitnú tlačenú kópiu tejto stránky a naskenujte čiarový kód, ktorý zodpovedá požadovanej úrovni.

Obrázok 13-5: Čiarové kódy bzučiaka pre čítačku Zebra



Nízka hlasitosť



Stredná hlasitosť



Vysoká hlasitosť

13.1.2.3 Konfigurácia použitia bez použitia rúk

Keď je čítačka umiestnená v stojane, používa sa normálne bez použitia rúk a pri čítaní čiarového kódu nemusíte stlačiť spúšť.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prevádzku bez použitia rúk pre čítačku čiarových kódov Zebra, vytlačte kvalitnú tlačenú kópiu tejto stránky a naskenujte čiarový kód, ktorý zodpovedá požadovanej funkcii.

Obrázok 13-6: Čiarové kódy na prevádzku bez použitia rúk pre čítačku Zebra



Prevádzka bez použitia rúk ZAPNUTÁ



Prevádzka bez použitia rúk VYPNUTÁ

13.2 Značkovač sklíčok

Príručky sa dodávajú so značkovačom sklíčok. Pokyny na čistenie a vkladanie štítkov a tlačovej pásky nájdete v týchto pokynoch. Čistite mesačne.

14 Použitie reagensí BOND

Táto kapitola všeobecne opisuje vedecké a klinické dôvody farbenia tkanív v systéme BOND.

Každý výrobok Leica Biosystems sa dodáva s úplným návodom na použitie. Najprv si prečítajte tieto pokyny, kde nájdete špecifické informácie o reagensiach na prípravu vzorky, kontrolu kvality a interpretáciu testu. Všeobecné pokyny pre tieto procesy v systéme BOND sú opísané nižšie.

- [14.1 Princíp postupu](#)
- [14.2 Príprava vzorky](#)
- [14.3 Kontrola kvality](#)
- [14.4 Interpretácia farbenia](#)
- [14.5 Všeobecné obmedzenia](#)
- [14.6 Literatúra](#)

14.1 Princíp postupu

Táto časť obsahuje všeobecné úvody k imunohistochemickému rozboru (IHC) a hybridizácii in situ (ISH). Opisuje tiež detekčné systémy BOND.

Imunohistochemický rozbor (IHC)

Techniky imunohistochemického rozboru sa používajú na detekciu špecifických antigénov v bunkách alebo tkanivách už najmenej 50 rokov. Prvá zapísaná metóda používala fluorescenčné značky v roku 1941¹. Následne boli zavedené enzýmy, ako je peroxidáza². Dnes sa imunohistochemický rozbor používa na uľahčenie rozpoznávania buniek popri rutinnom H a E parafínovom farbení a pomáha pri rozpoznávaní normálnych a abnormálnych buniek. Metódy imunohistochemického rozboru sa stali štandardnou starostlivosťou v chirurgickej patológii, keď samotné klasické metódy neposkytujú definitívnu diagnózu^{3,4}. Existujú však určité výhrady týkajúce sa reprodukovateľnosti⁵ napriek takmer univerzálnemu prijatiu.

Reagencie na automatizovanom prístroji BOND ukazujú antigény v tkanivových sekciách imunohistochemickými technikami. V súhrne sa teda špecifická primárna protilátka viaže na sekciu, potom reagencie detekčného systému BOND vizualizujú komplex.



Diagnostický značkovač je reagent, ktorá sa používa na detekciu špecifického väzbového miesta pre antigén alebo DNA/RNA vo vzorke tkaniva. Značkovač je primárna protilátka v IHC alebo sonda v ISH (pozrite nižšie).

In situ hybridizácia (ISH)

Molekulárne biologické techniky nám značne pomohli pri pochopení chorôb. In situ hybridizácia kombinuje molekulárnu biológiu a histológiu, čo umožňuje vizualizáciu DNA alebo RNA v ich bunkovom kontexte. Od detekcie nukleových kyselín bola prvýkrát zavedená v roku 1969⁶ a vďaka zlepšeniam in situ hybridizačných protokolov sa stala čoraz cennejším nástrojom pre klinickú patológiu, ako aj pre výskum.

In situ hybridizácia využíva komplementárne viazanie nukleotidových báz v DNA alebo RNA. Značená sonda nukleovej kyseliny sa špecificky viaže na svoju komplementárnu sekvenciu vo vzorke fixovaného tkaniva alebo bunky. Sonda sa vizualizuje pomocou aplikácie protilátky proti značke, po ktorej nasledujú reagenty BOND na detekciu polymérov. Automatizovaný systém BOND a reagenty ponúkajú spoľahlivú a efektívnu alternatívu k ťažkopádnej manuálnej technike.

14.1.1 Detekčné systémy BOND

Spoločnosť Leica Biosystems dodáva celý rad detekčných systémov vyvinutých špeciálne pre systém BOND. Medzi nimi je predovšetkým systém BOND Polymer Refine Detection™, ktorý poskytuje farbenie vysokej intenzity spojené s ostrým definovaním bez použitia streptavidínu a biotínu.

Dostupné detekčné systémy BOND sú uvedené v nasledujúcich častiach.

- [14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection](#)
- [14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection](#)

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection



Modul spracovania BOND-PRIME používa inú verziu tohto detekčného systému. Dodáva sa v podnose duálneho systému reagensí a nádoba na hematoxylínové reagenty je samostatná doplnková položka. Ďalšie informácie nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Systém na báze polyméru DAB BOND, BOND Polymer Refine Detection, poskytuje farbenie vysokej intenzity spojené s ostrým vymedzením väzby protilátky na cieľový antigén alebo väzby sondy na nukleovú kyselinu. Systém nepoužíva streptavidín a biotín, a preto eliminuje nešpecifické farbenie v dôsledku endogénneho biotínu. Endogénny biotín prevláda v niektorých tkanivách, ako je karcinóm gastrointestinálneho traktu, obličiek, pečene a prsníka. Systémy detekcie polymérov BOND majú vyššiu citlivosť ako označené streptavidín-biotínové systémy, čo vedie k nižším koncentráciám protilátok a rýchlejšim časom obratu.

V každom kroku systém BOND inkubuje sekcie v presnom čase, potom premýva sekcie, aby sa odstránil nenaviazaný materiál. Kroky protokolu vrátane inkubácie, premývania a interpretácie výsledkov sa vykonávajú podľa opisu v návode na použitie systému BOND Polymer Refine Detection. Výsledky sa interpretujú pomocou optického mikroskopu a pomáhajú pri diferenciálnej diagnostike patologických procesov, ktoré môžu, ale nemusia byť spojené s konkrétnym antigénom.

Ak sa požaduje silnejšia intenzita, k dispozícii sú nasledujúce možnosti pre všetky systémy na detekciu polymérov BOND:

- predĺžte časy inkubácie pre komponenty primárnej protilátky alebo sondy a/alebo detekčného systému;
- vykonajte krok BOND DAB Enhancer.
- iba pre IHC zvýšte koncentráciu primárnych protilátok.



Tieto tri možnosti nie sú k dispozícii pre systém HER2 IHC Bond Oracle™.

Systém HER2 IHC BOND predstavuje kompletný systém na určovanie prítomnosti cieľového proteínu, a teda vhodnosti liečby cieľenou terapiou. Tento test sa poskytuje ako celkový optimalizovaný systém s protilátkami, detekčnými reagensiami, kontrolnými reagensiami a kontrolnými sklíčkami, aby sa zabezpečilo úplné zabezpečenie kvality diagnostického výsledku. Test je založený na metodike imunohistochemického rozboru. K systému sa dodáva úplný návod na používanie. Tento návod použijete na nastavenie cyklov. Z dôvodu povahy testovania pomocou imunohistochemického rozboru HER2 je nanajvýš dôležité, aby sa tento návod dodržiaval presne, aby nedošlo k znehodnoteniu testu.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection



Modul spracovania BOND-PRIME používa inú verziu tohto detekčného systému. Dodáva sa v podnose duálneho systému reagensí. Ďalšie informácie nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

Systém BOND Polymer Refine Red Detection™ má rovnaké výhody ako systémy na detekciu polymérov na báze DAB opísané vyššie, ale na vizualizáciu sa namiesto DAB používa chromogén Fast Red. Systém je vhodný na použitie na tkanivách, ako je koža, kde sa tkanivové pigmenty môžu zamieňať s DAB.

Systém BOND Polymer Refine Red Detection je vysoko citlivý systém Compact Polymer™ spojený s alkalickou fosfatázou, ktorý zaisťuje jasné imunofarbenie fuchsiovou červeňou, ako aj kontrastné farbenie hematoxylínom (vrátane modrania).



Chromogén Fast Red je za normálnych laboratórnych podmienok chemicky nestabilný. Prísne dodržiavajte návod na používanie systému Polymer Refine Red Detection BOND na udržanie účinnosti chromogénu. Kontrolnú vzorku tkaniva vždy umiestnite na rovnaké sklíčko ako tkanivo pacienta, aby ste mohli rýchlo zistiť akékoľvek zhoršenie systému.



Pre systém Polymer Refine Red Detection BOND sa odporúča fixačné médium Leica CV Ultra. Iné fixačné médiá si nemusia zachovať intenzitu pôvodne získaného farbenia.

Kroky pre systém BOND Polymer Refine Red Detection:

- 1 aplikácia špecifickej primárnej protilátky,
- 2 inkubácia s post primárnou reagensiou,
- 3 inkubácia s polymérnou reagensiou, ktorá obsahuje konjugáty polymérnej alkalickéj fosfatázy (AP) terciárnej protilátky,
- 4 vizualizácia komplexu so substrátom chromogénu Fast Red prostredníctvom červenej zrazeniny,
- 5 farbenie hematoxylínom umožňuje detekciu bunkových jadier.

Inkubácia, premývanie a interpretácia výsledkov sa uskutočňujú tak, ako je to popísané pre systémy na detekciu polymérov na báze DAB BOND,

14.2 Príprava vzorky

Táto sekcia sa zaoberá prípravou tkaniva na farbenie.

- [14.2.1 Potrebne materiály](#)
- [14.2.2 Príprava tkaniva](#)
- [14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie](#)
- [14.2.4 Získavanie epitopov](#)

14.2.1 Potrebne materiály

Nasledujúce materiály sú potrebné na imunohistochemické a in situ hybridizačné farbenie pomocou systému BOND.

14.2.1.1 Bežné materiály

- Fixačný prípravok – odporúča sa 10 % neutrálny pufrovaný formalín
- Parafínový vosk
- Tkanivový procesor a zalievacie centrum
- Negatívne a pozitívne kontrolné vzorky tkanív (pozrite si časť [14.3 Kontrola kvality](#))
- Mikrotóm
- Sušiaci rúra
- Fixačné médium na báze živice alebo na vodnej báze
- Nabité mikroskopické sklíčka (napr. Leica BOND Plus Slides)
- Súprava BOND Slide Labels and Printer Ribbon
- Krycie sklíčka
- Univerzálne krycie sklíčka BOND Covertile alebo krycie sklíčka BOND-PRIME ARC Covertiles (BOND-PRIME ARC Covertile)
- BOND-PRIME Suction Cups (Prísavky BOND-PRIME)
- BOND-PRIME Mixing Well Plate (Doska so zmiešavacími jamkami BOND-PRIME)
- Vhodný systém reagensí BOND alebo BOND-PRIME
- Súprava na predprípravu enzýmu BOND
- Roztok na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution
- Premývací roztok (pripravený z koncentráту BOND Wash Solution 10X Concentrate) alebo BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
- Deionizovaná voda
- Etanol (reagenčného stupňa)



* Etanol reagenčného stupňa obsahuje: etanol s koncentráciou vyššou alebo rovnajúcou sa 90 % (hm. %), izopropanol, nie viac ako 5 % (hm. %), metanol, nie viac ako 5 % (hm. %).



Informácie o module spracovania BOND-PRIME nájdete v samostatnej používateľskej príručke systému BOND-PRIME.

14.2.1.2 Materiály pre IHC

Okrem vyššie uvedených materiálov sa pri testoch IHC vyžadujú:

- Negatívne kontrolné reagensie špecifické pre primárne protilátky (pozrite si časť [14.3 Kontrola kvality](#))
- Roztok na získavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
- Roztok na získavanie epitopov BOND alebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2
- Hotové primárne protilátky BOND alebo primárne protilátky zriedené v riediacom prípravku BOND Primary Antibody Diluent v otvorených nádobách BOND, 7ml alebo 30ml
- Fixačné médium na báze živice alebo na vodnej báze
- Titračná súprava, voliteľná (pozrite si časť [14.2.1.4 Titračná súprava](#))

14.2.1.3 Materiály pre ISH

Okrem vyššie uvedených bežných materiálov sa pri testoch ISH vyžadujú:

- sondy ISH,
- protilátka proti fluoresceínu,
- Pozitívne a negatívne kontrolné sondy špecifické pre ISH (pozrite si časť [14.3 Kontrola kvality](#)).

14.2.1.4 Titračná súprava

Titračná súprava BOND pozostáva z 10 prázdnych nádob a 50 vložiek (6 ml) a používa sa pri optimalizácii koncentrácie primárnych protilátok pre systém BOND. Môžu sa pripraviť malé objemy každej koncentrácie primárnej protilátky a umiestniť do vložiek. Každá nádoba sa môže použiť pre celkový objem 40 ml reagensie.

Titraciu koncentrovaných protilátok je možné dosiahnuť pomocou sériových dvojnásobných riedení. Nasledujúca metóda opisuje, ako pripraviť sériové riedenia pre jednu dávku s objemom 150 µl.

- 1 Označte tri vložky s vhodnými riediacimi prípravkami pre každú protilátku.
- 2 Vykonajte počiatkové riedenie v prvej vložke s objemom 700 µl.
- 3 Nadávkujte 350 µl prípravku BOND Primary Antibody Diluent do vložky 2 a 3.
- 4 Z počiatkového riedenia preneste 350 µl do vložky 2 a jemne premiešajte.
- 5 Z vložky 2 preneste 350 µl do vložky 3 a jemne premiešajte.

14.2.2 Príprava tkaniva

Na fixáciu tkaniva na imunohistochemické a in situ hybridizačné farbenie pomocou systému BOND sa odporúča 15- až 20-násobok objemu tkaniva 10 % neutrálneho pufrovaného formalínu. Fixáciu je možné vykonať pri izbovej teplote (15 – 25 °C).

Pokiaľ ide o testovanie HER2, prečítajte si odporúčania týkajúce sa prípravy tkanív pre združenie American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists¹⁰ alebo si prečítajte miestne smernice a nariadenia.

Na uľahčenie rezania tkaniva a zabránenie poškodeniu mikrotómových čepelí sa pred spracovaním tkaniva odvápnia kostné tkanivá^{11,12}.

Zákon Spojených štátov amerických o zlepšovaní práce klinických laboratórií (Clinical Laboratory Improvement Act, CLIA) z roku 1988 vyžaduje v 42 CFR b) nasledujúce: „Laboratórium si musí ponechať zafarbené sklíčka najmenej desať rokov od dátumu vyšetrenia a ponechať bloky vzoriek najmenej dva roky od dátumu vyšetrenia.“¹³ Požiadavky vzťahujúce sa na vaše zariadenie nájdete v miestnych predpisoch.

Narežte a vyberte sekcie s hrúbkou 3 – 5 µm na nabitú sklíčka (niektoré špecifické typy tkanív môžu vyžadovať rôzne hrúbky sekcií). Na vysušenie tkaniva vložte dobre vysušené podložné sklíčka do rúry s teplotou 60 °C (± 5 °C) na 10 – 30 minút alebo cez noc pri 37 °C. Sklíčka sa môžu tiež zahriať v moduloch spracovania BOND-III a BOND-MAX. Sklíčka sa musia pred zahrievaním dobre vysušiť na vzduchu. Ďalšie podrobnosti o príprave vzoriek nájdete v literatúre č. 13, 14 a 15.

Prilepte štítky na podložné sklíčka so vzorkami a kontrolné sklíčka tak, ako je to opísané v časti **4 Rýchly štart**. Odvoskovanie, rehydratácia a získavanie epitopov sú plne automatizované v systéme BOND.

14.2.3 Odvoskovanie a zahrievanie

Sekcie tkaniva zabudované do parafínu na imunohistochemický rozbor musia najprv prejsť odstránením parafínového vosku a rehydratovaním sekcie. Vosk sa odstráni pomocou roztoku na odvoskovanie BOND alebo BOND-PRIME Dewax Solution a sekcie sa rehydratujú. Systém BOND obsahuje protokoly odvoskovania, ktoré automatizujú tento proces.

Pred odvoskovaním môžu moduly spracovania BOND-III a BOND-MAX tiež zahriať tkanivo, aby sa zlepšila jeho adhézia na podložné sklíčko. Protokoly zahrievania a odvoskovania systému BOND automatizujú procesy zahrievania aj odvoskovania.



Upozorňujeme, že tkanivo musí byť vzduchom vysušené, aby sa odstránila všetka voda ešte pred umiestnením do modulu spracovania na zahrievanie a odvoskovanie.

14.2.4 Získavanie epitopov

Fixácia tkaniva vo formalíne spôsobuje zosieťovanie medzi aldehydovými a aminoskupinami v tkanive a tvorba týchto väzieb môže viesť k premenlivej strate antigenicity v dôsledku maskovacieho účinku. Formalín tvorí metylénové mostíky, ktoré môžu meniť celkový trojrozmerný tvar epitopu. Niektoré epitopy sú citlivé na formalín a vykazujú zníženú imunoreaktivitu po fixácii formalínom, zatiaľ čo iné sú rezistentné voči formalínu.

Nukleové kyseliny sú obklopené proteínmi, preto je potrebná permeabilizácia tkaniva, aby boli cieľové sekvencie prístupné sonde.

Získavanie epitopov^{7,8} sa môže dosiahnuť buď pomocou HIER (teplom indukovaného získavania epitopov), predprípravou enzýmu, alebo kombináciou oboch. Metóda HIER je najrozšírenejšou metódou získavania epitopov pre IHC. Mechanizmus metódy HIER nie je úplne pochopený.

Hypotéza je, že pri zahriatí sekcie na vysokú teplotu v roztoku na získavanie epitopu sa hydrolyzujú zosieťované väzby vytvorené pri fixácii formalínom. To vedie k remodelácii epitopu, ktorý sa potom môže farbiť imunohistochemickým rozborom. Dôležitými faktormi v metóde HIER sú teplota, čas a pH získaného roztoku. Existujú dve rôzne riešenia na získavanie epitopov, ktoré sa používajú v systéme BOND: citrátový pufor a pufor na báze EDTA.

Predpríprava enzýmu využíva proteolytické enzýmy na prerušenie peptidových väzieb, aby sa odkryla epitop/cieľová sekvencia nukleovej kyseliny. Koncentrácia enzýmu a čas inkubácie sú úmerné času fixácie vzorky a mali by sa podľa toho optimalizovať. Predpríprava enzýmu je vhodná iba pre niektoré epitopy, ale často sa používa v protokoloch ISH.

14.3 Kontrola kvality

Rozdiely v spracovaní tkanív a technických postupoch v laboratóriu používateľa môžu spôsobiť značnú variabilitu výsledkov, čo si okrem nasledujúcich postupov vyžaduje pravidelné vykonávanie vnútropodnikových kontrol. Prečítajte si miestne návody a predpisy, taktiež môžete využiť aj druhé vydanie príručky pre klinické laboratóriá CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition²² a navrhované usmernenia NCCLS pre IHC¹⁴.



Kontrolné vzorky by mali byť nedávne pitevné/biopsické/chirurgické vzorky fixované, spracované a zaliate čo najskôr rovnakým spôsobom ako vzorka (vzorky) pacienta. Takouto kontrolou sa monitorujú všetky kroky analýzy od prípravy tkaniva po farbenie.



Dôrazne odporúčame umiestniť vhodné kontrolné tkanivo na rovnaké podložné sklíčko ako tkanivo pacienta. Pozrite si časť **6.2 Práca s kontrolnými vzorkami**, kde nájdete ďalšie informácie.

Pozrite si:

- [14.3.1 Overenie testu](#)
- [14.3.2 Kontrolné vzorky tkanív](#)
- [14.3.3 Negatívna kontrolná reagentia pre IHC](#)
- [14.3.4 Kontrolné reagentie pre ISH](#)
- [14.3.5 Výhody kontroly kvality](#)

14.3.1 Overenie testu

Pred prvým použitím protilátky, sondy alebo systému farbenia v diagnostickom postupe overte špecifickosť protilátky/sondy jej testovaním na sérii interných tkanív, ktorých známa expresia predstavuje známe pozitívne a negatívne tkanivá. Pozrite si vyššie uvedené postupy a odporúčania na kontrolu kvality v rámci certifikačného programu CAP 14 pre imunohistochemický rozbor a/alebo usmernenia NCCLS IHC¹⁴, prípadne miestne predpisy a smernice. Opakujte tieto postupy kontroly kvality pre každú novú dávku protilátky alebo vždy, keď dôjde k zmene parametrov testu. Kontrola kvality nemôže byť zmysluplne vykonaná na jednotlivých reagentii izolovane, pretože porovnané reagentie spolu s definovaným testovacím protokolom musia byť testované jednotne pred použitím detekčného systému na diagnostické účely. Informácie o tkanivách, ktoré sú vhodné na overenie testu, nájdete v každom príbalovom letáku k primárnym protilátkam.

Okrem vyššie uvedených postupov na overenie testu odporúčame farbiť pozitívne kontrolné vzorky tkanív mesačne a porovnávať ich s rovnakými kontrolnými vzorkami tkanív zafarbenými v predchádzajúcom mesiaci. Porovnanie kontrolných vzoriek zafarbených v mesačných intervaloch slúži na monitorovanie stability testu, citlivosti, špecifickosti a reprodukovateľnosti.

Všetky požiadavky na kontrolu kvality by sa mali vykonávať v súlade s miestnymi, štátnymi a/alebo federálnymi predpismi alebo požiadavkami na akreditáciu.

14.3.2 Kontrolné vzorky tkanív

14.3.2.1 Pozitívna kontrolná vzorka tkaniva

- Tento krok označuje správne pripravené tkanivá a správne farbiace techniky.
- Zahrňte jednu pozitívnu kontrolnú vzorku tkaniva pre každú zostavu testovacích podmienok v každom cykle farbenia.
- Tkanivo so slabým pozitívnym farbením je vhodnejšie ako tkanivo so silným pozitívnym farbením pre optimálnu kontrolu kvality a detekciu menších hladín degradácie reagensie ¹⁴.
- Použitie kontrolného sklíčka s viacerými tkanivami, ktoré obsahuje tkanivá vykazujúce silnú, strednú a slabú hustotu antigénu/expresiu nukleovej kyseliny, poskytuje široké pokrytie kontroly.
- Ak pozitívna kontrolná vzorka tkaniva nepreukáže pozitívne farbenie, výsledky so skúšobnými vzorkami by sa mali považovať za neplatné.
- Dôrazne odporúčame, aby ste vždy spustili systém BOND s kontrolným tkanivom na rovnakom sklíčku ako tkanivo vzorky, aby sa zabezpečila optimálna kontrola kvality.

14.3.2.2 Negatívna kontrolná vzorka tkaniva

- Po pozitívnej kontrolnej vzorke tkaniva overte špecifickosť značenia cieľového antigénu primárnou protilátkou v IHC alebo cieľovej nukleovej kyseliny sondou v ISH a poskytnite indikáciu špecifického farbenia pozadia (nesprávne pozitívne farbenie).
- Rôzne typy buniek prítomné vo väčšine tkanivových sekcií často ponúkajú negatívne kontrolné miesta, ale používateľ by to mal overiť.
- Ak sa pri negatívnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne špecifické farbenie, výsledky zo vzoriek pacientov by sa mali považovať za neplatné.

14.3.3 Negatívna kontrolná reagencia pre IHC

Použite negatívnu kontrolnú reagenciu pre IHC namiesto primárnej protilátky so sekciou vzorky od každého pacienta na vyhodnotenie nešpecifického farbenia a lepšiu interpretáciu špecifického farbenia.

- Odporúčaná ideálna kontrolná reagencia:
 - a Pre monoklonálne protilátky použite protilátku rovnakého izotypu, ktorý je produkovaný zo supernatantu tkanivových kultúr a rovnakým spôsobom ako primárna protilátka, ale ktorý nevykazuje žiadnu špecifickú reaktivitu s ľudskými tkanivami.
Zriedte ju na rovnakú koncentráciu imunoglobulínu alebo proteínu ako primárna protilátka pomocou rovnakého riediaceho prípravku (BOND Primary Antibody Diluent).
Ak sa fetálne teľacie sérum po spracovaní uchová v čistej protilátke, na použitie je tiež vhodné fetálne teľacie sérum s koncentráciou proteínu ekvivalentnou zriedenej primárnej protilátke v rovnakom riediacom prípravku.
 - b V prípade polyklonálnych protilátok použite imunoglobulínovú frakciu (alebo celé sérum, ak je to vhodné) normálneho alebo neimunitného séra z toho istého živočíšneho zdroja a rovnakú koncentráciu proteínu ako primárna protilátka, pričom použite rovnaký riediaci prípravok (BOND Primary Antibody Diluent).
- Ako menej žiaduca alternatíva k vyššie opísaným negatívnym kontrolným reagenciám sa môže použiť samotný riediaci prípravok BOND Primary Antibody Diluent.
- Inkubačná doba pre negatívnu kontrolnú reagenciu by mala zodpovedať inkubačnej dobe primárnej protilátky.
- Pre každú použitú metódu získania (vrátane nezískania) pre danú primárnu protilátku použite samostatné sklíčko na negatívnu kontrolnú reagenciu.
- Ak sa na sériové sekcie použijú panely niekoľkých protilátok, negatívne farbené oblasti jedného sklíčka môžu slúžiť ako negatívne/nešpecifické väzbové pozadia pre iné protilátky.
- Na rozlíšenie endogénnej enzýmovej aktivity alebo nešpecifickej väzby enzýmov od špecifickej imunoreaktivity sa farbivá dodatočné tkanivá pacienta výlučne v poradí pomocou komplexov substrátu-chromogénu alebo enzýmových komplexov a substrátu-chromogénu.
- Systém BOND obsahuje predvolenú negatívnu kontrolnú reagenciu IHC s názvom „*negatívna“, ktorá sa môže vybrať ako značkovač pre akýkoľvek protokol IHC. Dávkuje premývací roztok BOND (pozrite si časť [10.5.2 Nastavenia prípadu a sklíčka](#)).

14.3.4 Kontrolné reagencie pre ISH

14.3.4.1 Pozitívna kontrolná reagentia

Pre in situ hybridizáciu použite pozitívnu kontrolnú sondy.

- Namiesto sondy použite sekciu každej vzorky pacienta, aby ste získali informácie o konzervácii nukleových kyselín v tkanive, ako aj o dostupnosti nukleových kyselín pre sondy.
- Protokol pre pozitívnu kontrolnú sondy by mal zodpovedať protokolu testovacej sondy.
- Ak pozitívna kontrolná sonda nepreukáže pozitívne farbenie, výsledky so skúšobnými vzorkami by sa mali považovať za neplatné.

14.3.4.2 Negatívna kontrolná reagentia

Pre in situ hybridizáciu použite negatívnu kontrolnú sondy.

- Protokol pre negatívnu kontrolnú sondy by mal zodpovedať protokolu testovacej sondy.
- Namiesto sondy použite sekciu každej vzorky od pacienta na vyhodnotenie nešpecifického farbenia a lepšiu interpretáciu špecifického farbenia.
- Inkubačná doba pre negatívnu kontrolnú reagentiu by mala zodpovedať inkubačnej dobe sondy.
- Pre každú použitú metódu získania (vrátane nezískania) pre danú sondy použite samostatné sklíčko na negatívnu kontrolnú reagentiu.
- Na rozlíšenie endogénnej enzýmovej aktivity alebo nešpecifickej väzby enzýmov od špecifickej imunoreaktivity sa farbivá dodatočné tkanivá pacienta výlučne v poradí pomocou komplexov substrátu-chromogénu alebo enzýmových komplexov a substrátu-chromogénu.

14.3.5 Výhody kontroly kvality

Výhody kontroly kvality sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

<p>Pozitívna kontrolná vzorka tkaniva:</p> <p>Tkanivo alebo bunky obsahujúce cieľový antigén/sekvenciu nukleovej kyseliny, ktoré sa majú detegovať (mohli byť umiestnené v tkanive pacienta).</p> <p>Ideálnou kontrolnou vzorkou je slabo pozitívne farbiace tkanivo, ktoré je najcitlivejšie na degradáciu protilátok/nukleových kyselín.</p>	<p>Kontroluje všetky kroky analýzy.</p> <p>Overuje platnosť reagensí a postupov používaných na farbenie.</p>		<p>Detekcia nešpecifického farbenia pozadia</p>
<p>Negatívna kontrolná vzorka tkaniva:</p> <p>Očakávané negatívne tkanivá alebo bunky (mohli by byť umiestnené v tkanive pacienta alebo v pozitívnej kontrolnej vzorke tkaniva)</p>	<p>Detekcia neúmyselnej krížovej reaktivity protilátok na bunky/bunkové zložky [IHC]</p> <p>Detekcia neúmyselnej krížovej hybridizácie sondy s inými sekvenciami nukleových kyselín alebo bunkami/bunkovými zložkami [ISH]</p>		<p>Detekcia nešpecifického farbenia pozadia</p>
<p>Tkanivo pacienta</p>	<p>Detekcia špecifického farbenia</p>	<p>Posúdenie konzervácie a/alebo získania tkaniva/zachovania nukleovej kyseliny [ISH]</p>	<p>Detekcia nešpecifického farbenia pozadia</p>

14.4 Interpretácia farbenia

Kvalifikovaný patológ, ktorý má skúsenosti s imunohistochemickými a/alebo in situ hybridizačnými postupmi, musí pred interpretáciou výsledkov vyhodnotiť kontrolné vzorky a kvalifikovať farbený produkt.

Špecifickosť a citlivosť detekcie antigénu závisia od použitej špecifickej primárnej protilátky. Na zabezpečenie požadovaného farbenia optimalizujte každú špecifickú protilátku pre systém BOND, prispôbte čas inkubácie a/alebo koncentráciu špecifickej protilátky. Ak nebude optimalizovaná špecifická protilátka, môže to viesť k suboptimálnej detekcii antigénu.

Pozrite si:

- [14.4.1 Pozitívna kontrolná vzorka tkaniva](#)
- [14.4.2 Negatívna kontrolná vzorka tkaniva](#)
- [14.4.3 Tkanivo pacienta](#)

14.4.1 Pozitívna kontrolná vzorka tkaniva

Najskôr skontrolujte pozitívnu kontrolnú vzorku tkaniva a uistite sa, že všetky reagenty fungujú správne.

Pri použití systémov založených na DAB prítomnosť hnedého (3,3' diaminobenzidíntetrachloridu, DAB) reakčného produktu s cieľovými bunkami naznačuje pozitívnu reaktivitu. Pri použití chromogénových systémov RED naznačuje prítomnosť červeného reakčného produktu s cieľovými bunkami pozitívnu reaktivitu. Ak pozitívne kontrolné vzorky tkaniva nepreukážu pozitívne farbenie, výsledky so skúšobnými vzorkami by sa mali považovať za neplatné.

14.4.2 Negatívna kontrolná vzorka tkaniva

Po pozitívnej kontrolnej vzorke tkaniva vyšetrite negatívnu kontrolnú vzorku tkaniva a overte špecifickosť značenia cieľového antigénu/nukleovej kyseliny pomocou primárnej protilátky/sondy.

Nepřítomnosť špecifického farbenia pri negatívnej kontrolnej vzorke tkaniva potvrdzuje nedostatok krížovej reaktivity protilátky/sondy na bunky/bunkové zložky.

Ak sa pri negatívnej kontrolnej vzorke tkaniva vyskytne špecifické farbenie (nesprávne pozitívne farbenie), výsledky by sa mali považovať za neplatné. Nešpecifické farbenie, ak je prítomné, má obvykle rozptýlený vzhľad. Sporadické farbenie spojivového tkaniva sa môže tiež pozorovať v sekciách z tkanív nadmerne fixovaných formalínom. Na interpretáciu výsledkov farbenia použite neporušené bunky. Nekrotické alebo degenerované bunky sa farbja často nešpecificky.

14.4.3 Tkanivo pacienta

Ako posledné vyšetrite vzorky pacienta zafarbené primárnou protilátkou/sondou.

Intenzita pozitívneho farbenia by sa mala hodnotiť v kontexte každého nešpecifického farbenia pozadia negatívnej kontrolnej reagentie. Ako pri každom imunohistochemickom alebo in situ hybridizačnom teste, negatívny výsledok znamená, že antigén/nukleová kyselina neboli detegované, a nie že antigén/nukleová kyselina neboli prítomné v testovaných bunkách alebo tkanivách.

V prípade potreby použite panel protilátok na identifikáciu nesprávne negatívnych reakcií.

14.5 Všeobecné obmedzenia

- Imunohistochemický rozbor a in situ hybridizácia sú viacstupňové diagnostické procesy, ktoré si vyžadujú špecializované školenie o výbere vhodných reagencií, výbere, fixácii a spracovaní tkanív, príprave podložného sklíčka a interpretácii výsledkov farbenia.
- Farbenie tkaniva závisí od manipulácie s tkanivom a jeho spracovania pred farbením. Nesprávna fixácia, zmrazenie, rozmrazenie, premývanie, sušenie, zahrievanie, rozdelenie na sekcie alebo kontaminácia inými tkanivami alebo tekutinami môže spôsobiť artefakty, zachytávanie protilátok alebo nesprávne negatívne výsledky. Nejednotné výsledky môžu byť spôsobené zmenami v metódach fixácie a zaliatia alebo inherentnými nepravidlosťami v tkanive ¹⁸.
- Nadmerné alebo neúplné kontrastné farbenie môže narušiť správnu interpretáciu výsledkov.
- Klinická interpretácia akéhokoľvek zafarbenia alebo jeho neprítomnosti by mala byť doplnená morfológickými štúdiami s použitím vhodných kontrolných vzoriek a mala by byť vyhodnotená v kontexte klinickej anamnézy pacienta a iných diagnostických testov kvalifikovaným patológom.
- Tkanivá od osôb infikovaných vírusom hepatitídy B obsahujúce povrchový antigén hepatitídy B (HbsAg) môžu vykazovať nešpecifické farbenie chrenovou peroxidázou ¹⁹.
- Neočakávané negatívne reakcie v nedostatočne diferencovaných neoplazmách môžu byť spôsobené stratou alebo výrazným znížením expresie antigénu alebo stratou alebo mutáciou v géne kódujúcom antigén. Neočakávané pozitívne farbenie nádorov môže pochádzať z expresie antigénu, ktorý zvyčajne nie je exprimovaný v morfológicky podobných normálnych bunkách, alebo z pretrvávania alebo získania antigénu v neoplazme, ktorá si rozvíja morfológické a imunohistochemické vlastnosti spojené s ďalšou líniou buniek (divergentná diferenciácia). Histopatologická klasifikácia nádorov nie je exaktná veda a niektoré údaje vo vedeckej literatúre o neočakávanom farbení môžu byť kontroverzné.
- Reagentie môžu vykazovať neočakávané reakcie v predtým netestovaných tkanivách. Možnosť neočakávaných reakcií aj v testovaných skupinách tkanív sa nedá úplne vylúčiť v dôsledku biologickej variability expresie antigénu/cieľovej nukleovej kyseliny v neoplazmách alebo iných patologických tkanivách. Kontaktujte miestneho distribútora alebo regionálnu kanceláriu spoločnosti Leica Biosystems a nahláste každú neočakávanú reakciu.

IHC

- Normálne alebo neimunitné séra z toho istého živočíšneho zdroja ako sekundárne antiséra použité v blokovacích krokoch môžu spôsobiť nesprávne negatívne alebo nesprávne pozitívne výsledky v dôsledku autoprotilátok alebo prírodných protilátok.
- Nesprávne pozitívne výsledky pri IHC môžu byť pozorované z dôvodu neimunologickej väzby proteínov alebo produktov reakcie substrátov. Môžu byť tiež spôsobené pseudoperoxidázovou aktivitou (erytrocyty), endogénnou peroxidázovou aktivitou (cytochróm C) alebo endogénnym biotínom (napríklad pečeň, prsia, mozog, obličky) v závislosti od typu použitej imunofarby¹⁶.
- Nesprávne negatívne prípady pri imunohistochemickom rozbere môžu byť dôsledkom rôznych faktorov vrátane skutočného zníženia, straty alebo štrukturálnej zmeny antigénu počas „dediferencovania“ nádoru alebo artefaktovej zmeny počas fixácie alebo spracovania. Ako pri každom imunohistochemickom teste, negatívny výsledok znamená, že antigén nebol detegovaný, a nie že antigén nebol prítomný v testovaných tkanivách.

ISH

- Nesprávne pozitívne výsledky pri ISH sa môžu prejavíť krížovou reaktivitou sondy na iné sekvencie nukleových kyselín, ako aj nešpecifickou väzbou sondy alebo detekčných reagensí na tkanivo alebo zložky tkaniva¹⁸. Do testovania by sa mali zahrnúť negatívne kontrolné vzorky tkanív a reagensí, ktoré pomôžu identifikovať nesprávne pozitívne farbenie.
- DNA a RNA podliehajú degradácii nukleázovou aktivitou^{8,19}. Preto je dôležité testovať pozitívnu kontrolnú sondu na tkanive pacienta paralelne so špecifickou sondou a tkanivom pacienta s cieľom detegovať degradáciu nukleových kyselín. Výber fixačného prípravku vplyva na konzerváciu nukleových kyselín, z toho dôvodu sa odporúča tkanivo fixované v 10 % neutrálnom pufrovanom formalíne¹⁹. Ako pri každom in situ hybridizačnom teste negatívny výsledok znamená, že nukleová kyselina nebola detegovaná, a nie že nukleová kyselina nebola prítomná v testovaných tkanivách.

14.6 Literatúra

- 1 Coons AH et al. Immunological properties of an antibody containing a fluorescent group. *Proc Soc Exp Biol Med* 1941; 47:200-202.
- 2 Nakane PK and Pierce GB Jr. Enzyme labeled antibodies: Preparations and applications for the localizations of antigens. *J Histochem Cytochem* 1967; 14:929-931.
- 3 Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, and Brigati J. Special report: Quality control in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1989; 92:836.
- 4 Nadji M and Morales AR. *Immunoperoxidase techniques: a practical approach to tumor diagnosis*. ASCP Press, Chicago. 1986.
- 5 True LD ed. *Atlas of Diagnostic Immunohistopathology*. Lippincott, Philadelphia. 1990.
- 6 Gall JG, Pardue ML. Formation of RNA-DNA hybrid molecules in cytological preparation. *Proceedings of the National Academy of the Sciences of the United States of America*. 1969;63:378-383.
- 7 Shi S-R, Gu J, and Taylor CR. *Antigen Retrieval Techniques: Immunohistochemistry and Molecular Morphology*. Eaton Publishing, Natick. 2000.
- 8 Miller RT, Swanson PE, and Wick MR. Fixation and epitope retrieval in diagnostic immunohistochemistry: a concise review with practical considerations. *Appl Immunohistochem Mol Morphol*. 2000 Sep;8(3):228-35.
- 9 Bancroft JD and Stevens A. *Theory and Practice of Histological Techniques*. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
- 10 Wolff et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer. *Arch Pathol Lab Med* 2007; 131:18–43.
- 11 Kiernan JA. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice*. New York: Pergamon Press. 1981
- 12 Sheehan DC. and Hrapchak BB. *Theory and Practice of Histotechnology*. St. Louis: C.V. Mosby Co. 1980.
- 13 Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
- 14 O'Leary TJ, Edmonds P, Floyd AD, Mesa-Tejada R, Robinowitz M, Takes PA, Taylor CR. Quality assurance for immunocytochemistry; Proposed guideline. MM4-P. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Wayne, PA. 1997;1-46.
- 15 Battifora H. Diagnostic uses of antibodies to keratins: a review and immunohistochemical comparison of seven monoclonal and three polyclonal antibodies. *Progress in Surg Path* 6:1-15. eds. Fenoglio-Preiser C, Wolff CM, Rilke F. Field Wood, Inc., Philadelphia.
- 16 College of American Pathologists (CAP) Certification Program for Immunohistochemistry. Northfield IL. <https://www.cap.org>
- 17 Wilkinson DG. The theory and practice of in situ hybridisation. In: Wilkinson DG. (ed.) *In Situ Hybridization A practical approach*. 2nd Edition. New York: Oxford University Press, 1998, s.18 – 20.
- 18 Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase, part I: the techniques and pitfalls. *Lab Med* 1983; 14:767.
- 19 Omata M, Liew CT, Ashcavai M, and Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: a possible source of error in immunohistochemistry. *Am J Clin Path* 1980;73:626.
- 20 Wilkinson DG. *In Situ Hybridization A practical approach*. 2nd Edition. Oxford University Press, Oxford. 1998.
- 21 Weiss LM, Chen Y. Effects of different fixatives on detection of nucleic acids from paraffin-embedded tissues by in situ hybridization using oligonucleotide probes. *The Journal of Histochemistry and Cytochemistry*. 1991;39(9):1237-1242.
- 22 Pontius CA, Murphy KA, Novis DA and Hansen AJ. *CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory*. 2nd Edition. Washington G-2 Reports, New York. 2003.

15 Správa systému (na riadiacom zariadení BOND)

15.1 Manažér systému BOND

15.1.1 Prehľad

Manažér systému BOND je obslužný program, ktorý vám umožňuje jednoducho zobraziť aktuálny stav primárnych softvérových služieb, ktoré používa systém BOND, umožňuje zastaviť a spustiť jednotlivé služby, napríklad zaraďovač tlače, alebo zastaviť a spustiť všetky služby.



VÝSTRAHA: Nezastavujte žiadne zo služieb, pretože systém BOND už nebude fungovať správne.

Oddelenie podpory zákazníka vás však môže požiadať, aby ste zastavili a potom reštartovali jednu alebo viac služieb ako súčasť procesu riešenia problémov so systémom.

Ak chcete otvoriť manažéra systému BOND, vyhľadajte ikonu správcu systému BOND  v oblasti oznámení systému Windows a potom na ňu kliknite.




Ikona môže byť skrytá a nemusí sa zobrazovať. V takom prípade kliknite na malú šípku hore a zobrazte ju.


Ak sa vyskytne chyba systému BOND, zobrazí sa oznámenie. Kliknutím na správu ho môžete skryť.





Ak chcete skryť okno manažéra systému BOND, kliknite znova na ikonu v oblasti oznámení systému Windows.

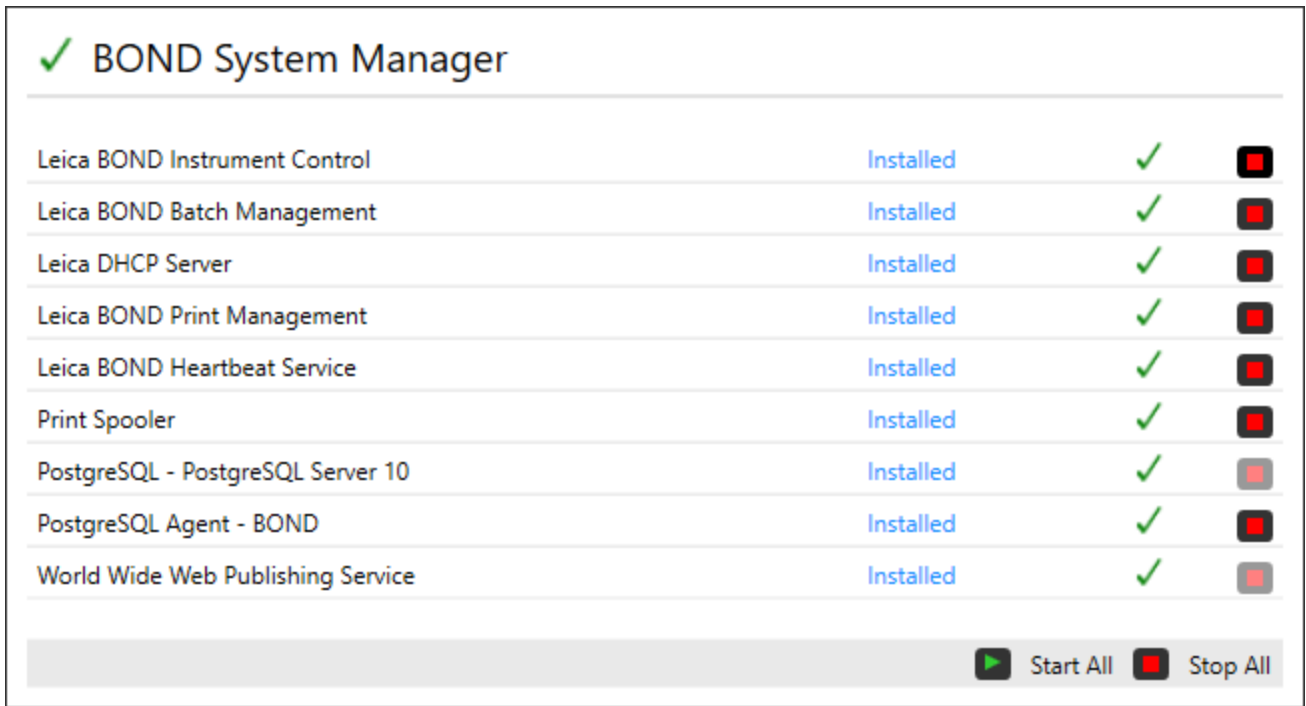15.1.2 Okno manažéra systému BOND



Obrázok 15-1: Okno manažéra systému BOND



Ak sa vyskytne chyba systému BOND, ikona Manažér systému BOND  sa aktualizuje tak, aby indikovala typ chyby, ktorá sa vyskytla:

-  zastavila sa jedna alebo viac služieb (v ľavom hornom rohu obrazovky manažéra systému BOND sa tiež zobrazuje ikona ).
-  nedarí sa pripojiť k systému BOND (v ľavom hornom rohu obrazovky manažéra systému BOND sa tiež zobrazuje ikona ).

V inštalácii BOND-ADVANCE to s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že:


- riadiace zariadenie bolo vypnuté, alebo
 - terminálová sieť bola odpojená alebo
 - prepínač terminálovej siete bol vypnutý.
-  Manažér systému BOND nie je k dispozícii (v ľavom hornom rohu obrazovky manažéra systému BOND sa tiež zobrazuje ikona ).

15.1.3 Zastavenie služieb

Ak chcete zastaviť konkrétnu službu, kliknite na zelené tlačidlo zastavenia úplne vpravo vedľa názvu služby. Ak chcete prípadne zastaviť všetky služby, kliknite na ikonu **Stop All** (Zastaviť všetko) pod zoznamom služieb.

Zobrazí sa dialógové okno so žiadosťou o potvrdenie, že chcete zastaviť služby. Kliknutím na tlačidlo **Yes** (Áno) pokračujte alebo **No** (Nie) zrušte požiadavku.

Obrázok 15-2: Dialógové okno vyžadujúce potvrdenie

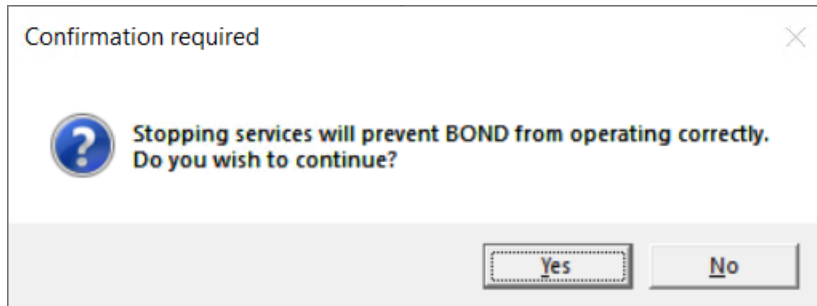

Niektoré služby nemožno zastaviť (službu PostgreSQL – PostgreSQL Server a službu publikovania na webe), pretože na ich fungovanie sa spolieha manažér systému BOND. Ich tlačidlá zastavenia sú preto deaktivované.

15.1.4 Spúšťanie služieb



Vo väčšine prípadov, keď je služba zastavená, softvér BOND automaticky reštartuje túto službu v priebehu niekoľkých minút.

Ak systém BOND nefunguje podľa očakávania a zistíte, že je zastavená jedna alebo viac služieb, môžete použiť manažéra systému BOND na spustenie zastavených služieb.

Ak chcete spustiť konkrétnu službu, kliknite na zelené tlačidlo spustenia úplne vpravo vedľa názvu služby. Ak chcete prípadne spustiť všetky služby, kliknite na ikonu **Start All** (Spustiť všetko) pod zoznamom služieb.






Obrázok 15-3: Manažér systému BOND zobrazujúci výstražný trojuholník (služba zaraďovania tlače zastavená)

✓ BOND System Manager			
Leica BOND Instrument Control	Installed	✓	■
Leica BOND Batch Management	Installed	✓	■
Leica DHCP Server	Installed	✓	■
Leica BOND Print Management	Installed	✓	■
Leica BOND Heartbeat Service	Installed	✓	■
Print Spooler	Installed	⚠	▶
PostgreSQL - PostgreSQL Server 10	Installed	✓	■
PostgreSQL Agent - BOND	Installed	✓	■
World Wide Web Publishing Service	Installed	✓	■

▶ Start All ■ Stop All

15.2 Redundancia pevného disku

Všetky riadiace zariadenia a terminály BOND zahŕňajú redundanciu pevného disku na ochranu systému BOND v prípade zlyhania pevného disku. Tento systém ochrany nepretržite monitoruje pevné disky systému a ikona v oblasti oznámení systému Windows zobrazuje aktuálny stav.

Ikona	Význam
	<p>Normálny stav – pevné disky fungujú správne.</p>
	<p>Výstraha – vyskytol sa problém s pevnými diskami systému. Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.</p>
	<p>Chyba – došlo k zlyhaniu pevného disku. Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.</p>
	<p>Zaneprázdnený – tento stav sa môže zobrazit' pri overovaní pevných diskov, napríklad po neočakávanom vypnutí. Počas overovania môže riadiace zariadenie alebo terminál fungovať pomaly, čo zvyčajne trvá 2 až 3 hodiny. Systém BOND môže byť počas tohto obdobia nepoužiteľný.</p> <p>Po overení by sa ikona mala vrátiť do normálneho stavu a obnovia sa normálne operácie pevného disku. Ak však ikona označuje stav výstrahy alebo chyby, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.</p>
	<p>Služba nie je spustená – softvérová služba používaná na monitorovanie ochrany pevného disku nie je spustená. Ikona na začiatku zobrazuje tento stav pri spustení riadiaceho zariadenia alebo terminálu. Ak ikona nesignalizuje normálny stav po uplynutí niekoľkých minút, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka.</p>

16 Operácie systému BOND-ADVANCE

16.1 Reštartovanie systému BOND-ADVANCE



Tento postup by ste mali vykonať, iba ak:

- vám to poradilo oddelenie podpory zákazníka Leica Biosystems alebo
- ak sa pripravujete na plánovaný výpadok energie.

Použite nasledujúci spôsob reštartovania celého systému BOND:

- 1 Uistite sa, že všetky moduly spracovania sú nečinné (to znamená, že nie sú uzamknuté žiadne podnosy na sklíčka).
- 2 Vypnite **všetky** moduly spracovania.
- 3 Vypnite **všetky** terminály (kliknite na tlačidlá **Start** (Štart) > **Shut down** (Vypnúť)).
- 4 Vypnite sekundárne riadiace zariadenie (ak je k dispozícii) krátkym stlačením vypínača (pozrite si príklad nižšie).
- 5 Vypnite primárne riadiace zariadenie krátkym stlačením tlačidla napájania (pozrite si **Obrázok 16-1**).



Tlačidlo napájania sa môže nachádzať za odnímateľným predným krytom riadiaceho zariadenia, ktorý môže byť zamknutý. V takom prípade musíte najskôr získať kľúč od určeného držiteľa kľúča.


Ak sa proces vypínania zastaví na prihlasovacej obrazovke systému Windows, počas vypínania sledujte obrazovku ovládacieho panela. Možno bude potrebné druhé stlačenie tlačidla napájania. Ak k tomu dôjde, počkajte najmenej 90 sekúnd a potom znova krátko stlačte tlačidlo napájania.



Po opätovnom stlačení tlačidla napájania sa riadiace zariadenie začne vypínať. **Nedržte** ho dlhšie ako 2 sekundy, pretože to môže spôsobiť „tvrdý“ reštart a okamžité vypnutie riadiaceho zariadenia. Vypnutie riadiaceho zariadenia môže trvať až 45 sekúnd (kontrolka tlačidla napájania zhasne).

- 6 Počkajte 2 minúty a potom zapnite primárne riadiace zariadenie.
Ak sa zobrazí okno „Sledovač udalostí vypínania“, zatvorte ho stlačením klávesu **Cancel** (Zrušiť) alebo stlačením klávesu **<Esc>**.
- 7 Počkajte 30 sekúnd a potom zapnite sekundárne riadiace zariadenie (ak je k dispozícii).
- 8 Po úplnom reštarte riadiacich zariadení zapnite všetky terminály.
- 9 Zapnite všetky moduly spracovania.
- 10 Prihláste sa na každom termináli.

Obrázok 16-1: Umiestnenie vypínača na prednom paneli riadiaceho zariadenia (zobrazené s odstráneným krytom)

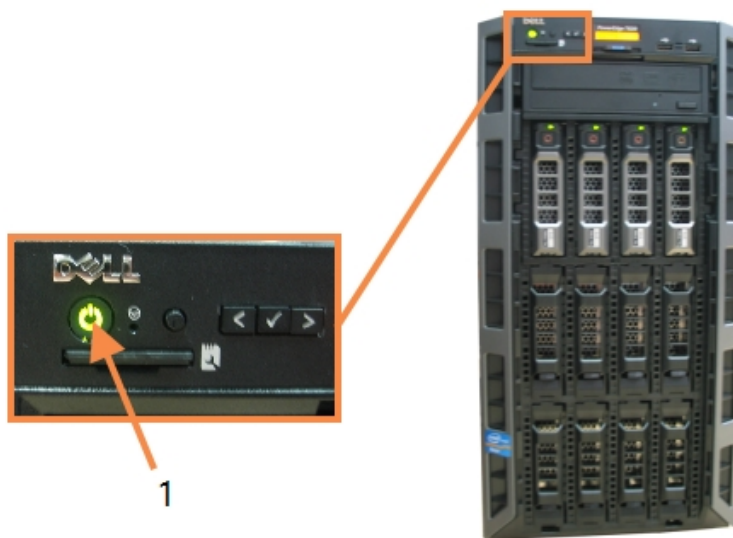

Legenda

- 1 Vypínač

16.2 Prepínanie na sekundárne riadiace zariadenie



Tieto pokyny sa vzťahujú iba na systémy BOND-ADVANCE, ktoré obsahujú sekundárne (záložné) riadiace zariadenie. Tento postup by ste mali vykonať, iba ak:

- vám to poradilo oddelenie podpory zákazníka Leica Biosystems alebo
- primárne riadiace zariadenie nie je funkčné.

Sekundárne riadiace zariadenie potom bude pracovať v samostatnom režime a váš systém už nebude mať redundantnú záložnú kapacitu. Po dokončení tohto postupu však systém BOND bude pokračovať v spracovaní obvyklým spôsobom.




Počas procesu prepínania sa môžu stratiť údaje zo spracovania za posledných 5 minút. Môžu sa stratiť aj všetky správy LIS, ktoré boli odoslané počas procesu prepnutia. Preto po úspešnom prepnutí skontrolujte, či nechýbajú nejaké sklíčka. Ak áno, odošlite údaje zo sklíčka znova pomocou systému LIS alebo ručne vytvorte chýbajúce sklíčka v systéme BOND.

- 1 Na všetkých termináloch BOND-ADVANCE zatvorte všetky prípady klinických klientov a klientov správy.
- 2 Odpojte kábel siete terminálu z portu označeného ako **T1** alebo **T2** na primárnom riadiacom zariadení a potom znova pripojte kábel k rovnakému portu na sekundárnom riadiacom zariadení.

Pozrite si časť [Obrázok 16-2](#).


Obrázok 16-2: Porty terminálu riadiaceho zariadenia

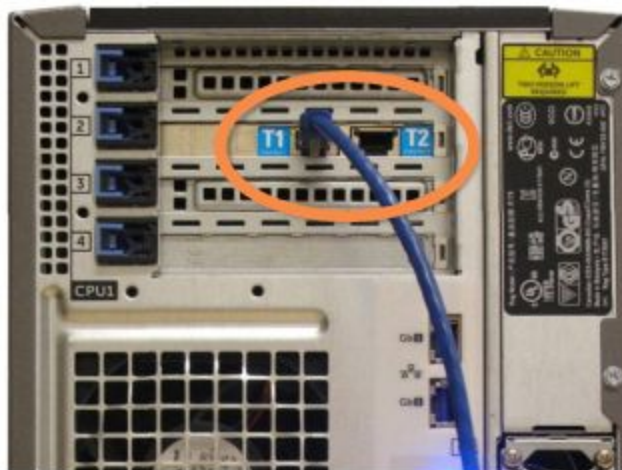

- 3 Odpojte kábel siete modulu spracovania z portu označeného ako **I1** alebo **I2** na primárnom riadiacom zariadení a potom znova pripojte kábel k rovnakému portu na sekundárnom riadiacom zariadení.

Pozrite si časť [Obrázok 16-3](#).


Obrázok 16-3: Porty riadiaceho zariadenia modulu spracovania

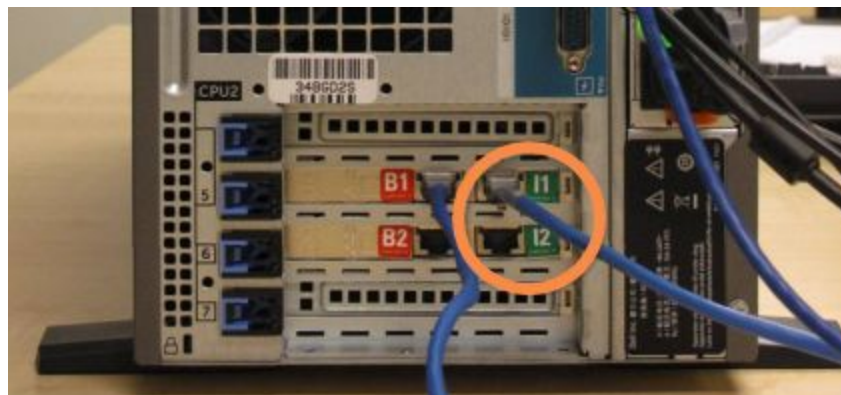

- 4 Odpojte sieťový kábel mostíka od portu **B1** alebo **B2** na primárnom riadiacom zariadení.

Pozrite si časť **Obrázok 16-4**.

Obrázok 16-4: Porty mostíka riadiaceho zariadenia

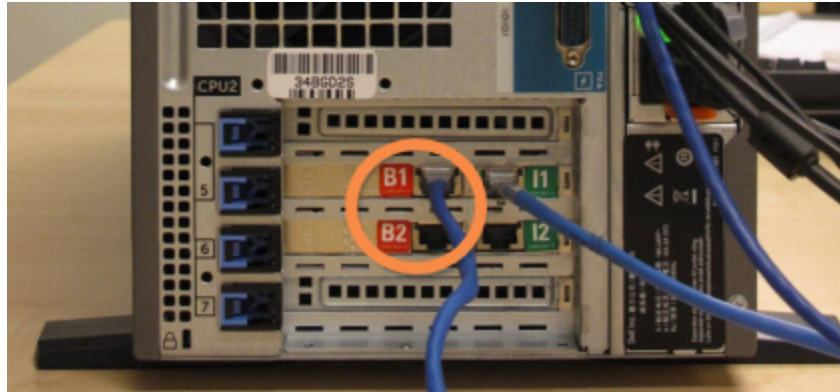

- 5 Ak je k dispozícii ethernetový kábel (používa sa pre voliteľné pripojenie RemoteCare systému), na porte **Gb(1)** alebo **Gb(2)** na primárnom riadiacom zariadení, odpojte a potom znovu pripojte tento kábel k rovnakému portu na sekundárnom riadiacom zariadení.

Pozrite si časť **Obrázok 16-5**.

Obrázok 16-5: Ethernetové porty používané pre pripojenie LIS



Systém BOND-ADVANCE zistí, že ste pripojili sieťové káble k sekundárnemu riadiacemu zariadeniu, a zobrazí potvrdzovacie dialógové okno na všetkých termináloch.

Pozrite si časť **Obrázok 16-6**.

Obrázok 16-6: Dialóg – pripojený sekundárne (záložné) riadiace zariadenie



Prepnutie nie je reverzibilné bez podpory na mieste zo strany zástupcu spoločnosti Leica Biosystems.


- 6 Na potvrdenie, že chcete pokračovať v prepnutí:
 - a do príslušných polí uveďte svoje používateľské meno a heslo.
 - b Kliknutím na tlačidlo **OK** potvrdíte.



Ak sa iný používateľ rozhodne pokračovať v prepínaní predtým, ako to urobíte vy, vyššie uvedené dialógové okno sa zatvorí.

- 7 Po potvrdení prepnutia vypnite primárne riadiace zariadenie.
- 8 Počkajte, kým systém nezobrazí výzvu na úspešné prepnutie do samostatného stavu (pozrite si **Obrázok 16-7**), potom reštartujte klinického klienta a prihláste sa do systému obvyklým spôsobom.

Obrázok 16-7: Dialógové okno – prechod na samostatný režim bol úspešný

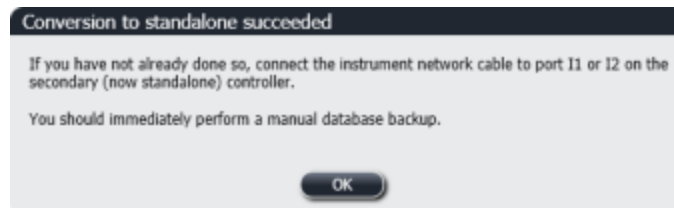

- 9 Okamžite otvorte klienta správy a vykonajte manuálnu zálohu databázy. Pozrite si časť **10.5.1 Laboratórne nastavenia**.

Po dokončení prepnutia na sekundárne riadiace zariadenie by sa mal automaticky aktualizovať stav všetkých sklíčok a modulov spracovania, aby odrážal najnovší stav systému. Ak však boli niektoré cykly ukončené v čase, keď boli moduly spracovania odpojené od riadiaceho zariadenia, stav chodu sa bude stále zobrazovať ako **In Progress** (Prebieha). V takom prípade musíte odomknúť dotknutý podnos na sklíčka, aby ste mohli aktualizovať stav zostavy na farbenie sklíčok.



Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníka a dohodnite si servis odpojeného riadiaceho zariadenia. Je potrebné, aby opravu alebo výmenu odpojeného riadiaceho zariadenia vykonal zástupca servisu spoločnosti Leica Biosystems.

17 Výmena tlačiarnej značkovača sklíčok

17.1 Výmena tlačiarne Cognitive Cxi systému s jednou stanicou

Pri výmene tlačiarne Cognitive za novú tlačiareň Cognitive použite nasledujúci postup.

- 1 Vypnite hlavný vypínač na bočnej strane starej tlačiarne.
- 2 Odpojte kábel USB a napájací kábel zo zadnej časti starej tlačiarne.
- 3 Pripojte kábel USB a napájací kábel k novej tlačiarne.
- 4 Zapnite hlavný vypínač na bočnej strane novej tlačiarne.

Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej ploche zobrazí správa, že sa našla tlačiareň.

- 5 Prejdite na nasledujúce položky: Tlačidlo **Start (Štart) systému Windows** > **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne) a nájdite novo pridanú tlačiareň.
- 6 Pravým tlačidlom myši kliknite na túto tlačiareň a vyberte položku **Properties** (Vlastnosti). Potom skopírujte názov tlačiarne.
- 7 Otvorte klienta správy, obrazovku **Hardware configuration** (Hardvérová konfigurácia), kartu **Slide labelers** (Značkovač sklíčok), ako je to opísané v časti **10.6.3 Značkovače sklíčok**. Vyberte starú tlačiareň, ktorú ste nahradili.
- 8 Vložte (prepísaním existujúceho názvu) do poľa **Printer name** (Názov tlačiarne), aby sa zmenila napríklad na „Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)“.
- 9 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).
- 10 Vytlačte skúšobný štítok, aby ste si overili fungovanie tlačiarne.

17.2 Výmena tlačiarne Cognitive Cxi systému BOND-ADVANCE

Pred pripojením novej tlačiarne k systému BOND-ADVANCE je potrebné nastaviť statickú IP adresu novej tlačiarne na rovnakú hodnotu, ako mala stará tlačiareň.

IP adresy tlačiarň začínajú od 192.168.5.101. Pri každej tlačiarňi sa líši iba posledná číslica. Napríklad IP adresa tlačiarne pre tlačiareň 2 je 192.168.5.102.

V postupoch uvedených nižšie je vysvetlené, ako zistiť statickú IP adresu starej tlačiarne a ako nastaviť túto hodnotu v novej tlačiarňi.

Predný panel tlačiarne Cognitive

Na [Obrázok 17-1](#) je znázornená klávesnica a LCD displej na tlačiarňi Cognitive Cxi.

Obrázok 17-1: LCD displej a klávesnica tlačiarne Cognitive







Zobrazenie IP adresy starej tlačiarne








Na starej tlačiarňi vykonajte nasledujúci postup, aby ste zistili IP adresu, ktorú chcete použiť v prípade novej tlačiarne:



Ak z nejakého dôvodu nemôžete používať displej na starej tlačiarňi, použite postup [Vyhľadanie IP adresy tlačiarne](#), aby ste zistili IP adresu na riadiacom zariadení.

- 1 Stlačte .

Zobrazí sa obrazovka **Main Menu: Language Menu** (Hlavná ponuka: ponuka jazykov).
- 2 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Printer Setup** (Nastavenie tlačiarne).
- 3 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Printer Setup: Comm. Menu** (Nastavenie tlačiarne: ponuka komunikácie).
- 4 Stlačte tlačidlo  na zobrazenie položky **Comm. Menu: Timeout** (Ponuka komunikácie: časový limit).









- 5 Stlačením tlačidla  dvakrát zobrazte možnosť **Ethernet** (Eternet).
- 6 Stlačte .
Zobrazí sa obrazovka **Ethernet - DHCP** (Eternet – DHCP).
- 7 Stlačte .
Zobrazí sa obrazovka **DHCP Off** (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazí možnosť **DHCP On** (DHCP zap.), stlačením tlačidla  zmeňte hodnotu.)
- 8 Stlačte .
Na obrazovke sa zobrazí správa: **Value has been set** (Hodnota bola nastavená).
- 9 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Set Static IP** (Nastaviť statickú IP).
- 10 Stlačením tlačidla  zobrazte aktuálne nastavenie.
- 11 Poznačte si statickú IP adresu.
- 12 Vypnite tlačiareň a odpojte ju od zdroja napájania a od siete.

Nastavenie IP adresy tlačiarnie

Ak chcete nastaviť novú tlačiareň na správnu statickú IP adresu, vykonajte nižšie uvedený postup.



POZOR: Nepripájajte novú tlačiareň k sieti BOND, kým nevykonáte postup uvedený nižšie.

- 1 Pripojte novú tlačiareň k napájaciemu zdroju a zapnite hlavný vypínač na bočnej strane tlačiarnie.
- 2 Stlačte .
Zobrazí sa obrazovka **Main Menu: Language Menu** (Hlavná ponuka: ponuka jazykov).
- 3 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Printer Setup** (Nastavenie tlačiarnie).
- 4 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Printer Setup: Comm. Menu** (Nastavenie tlačiarnie: ponuka komunikácie).
- 5 Stlačte tlačidlo  na zobrazenie položky **Comm. Menu: Timeout** (Ponuka komunikácie: časový limit).
- 6 Stlačením tlačidla  dvakrát zobrazte možnosť **Ethernet** (Eternet).
- 7 Stlačte .
Zobrazí sa obrazovka **Ethernet - DHCP** (Eternet – DHCP).
- 8 Stlačte .
Zobrazí sa obrazovka **DHCP Off** (DHCP vyp.). (Ak sa zobrazí možnosť **DHCP On** (DHCP zap.), stlačením tlačidla  zmeňte hodnotu.)

9 Stlačte .

Na obrazovke sa zobrazí správa: **Value has been set** (Hodnota bola nastavená).


10 Stlačením tlačidla  zobrazte možnosť **Set Static IP** (Nastaviť statickú IP).

11 Stlačením tlačidla  zobrazte aktuálne nastavenie.

12 Zadaťte IP adresu, ktorú ste si poznamenali zo starej tlačiarnie. Pomocou ľavého a pravého tlačidla posuňte kurzor doľava alebo doprava a pomocou tlačidiel hore a dole hodnotu zmeňte.

13 Stlačte .

Na obrazovke sa zobrazí správa: **Value has been set** (Hodnota bola nastavená)..

14 Stlačením tlačidla  niekoľkokrát za sebou sa vrátte na hlavnú obrazovku -- **COGNITIVE** --.

15 Prepnete hlavný vypínač na bočnej strane tlačiarnie do polohy OFF (Vyp.). Potom prepnete späť do polohy ON (Zap.).

16 Pripojte ethernetový kábel k novej tlačiarni a pripojte ho k sieti BOND.

Obrázok 17-2: Ethernetový konektor




17 Otvorte klienta správy a vytlačte štítok testu.

Vyhľadanie IP adresy tlačiarnie

Ak nie je možné zobraziť IP adresu na starej tlačiarni, pomocou nasledujúceho postupu určíte IP adresu pre novú tlačiareň.


1 Prihláste sa do riadiaceho zariadenia systému BOND-ADVANCE ako BONDDashboard.

2 Stlačením klávesov s logom Windows  + **M** minimalizujte obrazovku panela nástrojov.

3 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Start** (Štart) a vyberte možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarnie).

- Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušnú ikonu tlačiarne Cognitive a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne), ako je to znázornené na **Obrázok 17-3**.


Obrázok 17-3: Vyberte položku Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne)

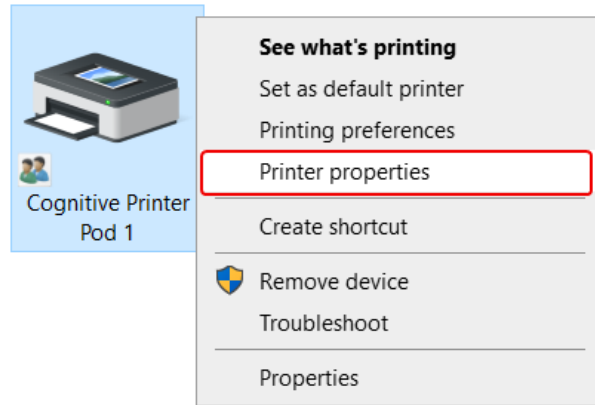

System zobrazí dialógové okno **Properties** (Vlastnosti).

- Vyberte kartu **Ports** (Porty).

Obrázok 17-4: Vlastnosti tlačiarne – karta Porty

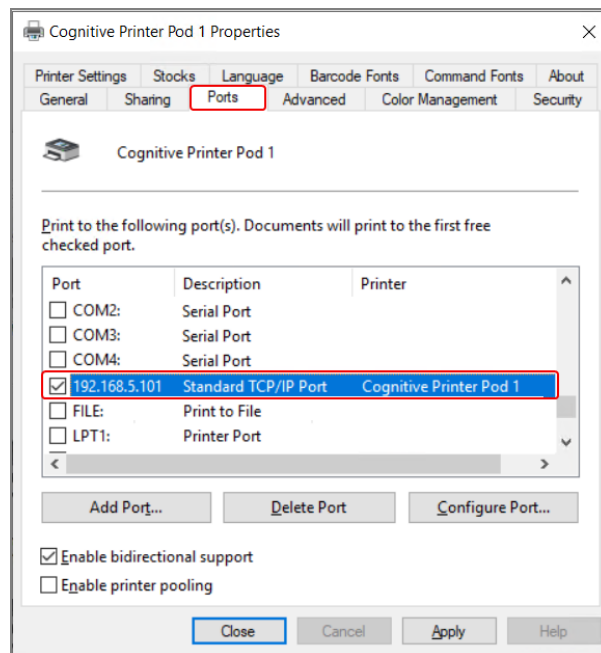

- Zaznačte IP adresu do stĺpca **Port** pre vybranú tlačiareň. (Možno budete musieť rozšíriť stĺpec **Port** presunutím hranice stĺpca.)
- Kliknutím na **Cancel** (Zrušiť) zatvorte dialógové okno.
- Zatvorte okno **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).
- Stlačte **Alt + Tab** na zobrazenie ovládacieho panelu systému BOND.
- Na vykonanie postupu **Nastavenie IP adresy tlačiarne** použite adresu IP z kroku 6.

17.3 Výmena tlačiarne Zebra za tlačiareň Cognitive Cxi systému s jednou stanicou

Ak chcete tlačiareň Zebra TLP 3842 alebo GX430t nahradiť tlačiarňou Cognitive Cxi, použite nasledujúci postup.



Ak bola tlačiareň Zebra pripojená „paralelným“ káblom, môžete ju od riadiaceho zariadenia systému BOND odpojiť. Na pripojenie tlačiarne Cognitive k internetu potrebujete kábel USB riadiaceho zariadenia systému BOND.

- 1 Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane tlačiarne Zebra.
- 2 Odpojte paralelný kábel alebo kábel USB a napájací kábel zo zadnej časti starej tlačiarne.
- 3 Odpojte napájanie tlačiarne Zebra zo sieťového napájania.
- 4 Pripojte napájanie tlačiarne Cognitive k sieťovému napájaniu.
- 5 Pripojte kábel USB a napájací kábel k tlačiarňi Cognitive.
- 6 Zapnite hlavný vypínač na bočnej strane tlačiarne.
Na obrazovke riadiaceho zariadenia BOND sa v oznamovacej oblasti (vpravo dole) na pracovnej ploche zobrazí správa, že sa našla tlačiareň.
- 7 Na paneli úloh systému Windows kliknite na ikonu **Start** (Štart) a vyberte možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).
- 8 Skontrolujte, či sa tlačiareň zobrazuje ako „Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT“.
- 9 Prihláste sa do klienta správy BOND.
- 10 Otvorte obrazovku Hardware (Hardvér), kartu Slide labelers (Značkovače sklíčok).
- 11 Kliknite na tlačidlo **Add printer** (Pridať tlačiareň) (vľavo dole na obrazovke).
- 12 Na pravom paneli na obrazovke zadajte:
 - **Display name** (Názov displeja): použite názov tlačiarne: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
 - **Printer name** (Názov tlačiarne): znovu rovnaký názov
 - **Host name** (Názov hostiteľa): nechajte toto pole prázdne.
 - **Printer type** (Typ tlačiarne): vyberte model tlačiarne: Cognitive Cxi
- 13 Kliknite na položku **Save** (Uložiť).
- 14 V zozname kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň Zebra.
- 15 V rozbaľovacej ponuke stlačte možnosť **Delete** (Vymazať).
- 16 Systém zobrazí správu: „Are you sure you want to delete the printer?“ (Naozaj chcete odstrániť tlačiareň?)
- 17 Kliknite na možnosť **Yes** (Áno).

18 Technické údaje



Táto časť sa nevzťahuje na modul spracovania BOND-PRIME. Pozrite si samostatnú používateľskú príručku systému BOND-PRIME.

- 18.1 Špecifikácie systému
- 18.2 Fyzické špecifikácie
- 18.3 Požiadavky na elektrické napájanie a zdroj UPS
- 18.4 Špecifikácie prostredia
- 18.5 Prevádzkové špecifikácie
- 18.6 Mikroskopické sklíčka
- 18.7 Doprava a skladovanie

18.1 Špecifikácie systému

Požiadavky na sieťové pripojenie	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
Sieťové káble	Tienené káble CAT5e alebo CAT6 s konektormi RJ-45
Požiadavky na ethernetový prepínač:	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
Jednomiestny	8-portový ethernetový prepínač (podporuje až 5 modulov spracovania)
BOND-ADVANCE	8- alebo 16-portové ethernetové prepínače (môžu byť spolu spojené, aby podporovali až 30 modulov spracovania)
Technické údaje zariadenia	Riadiace zariadenia BOND a terminály musí dodávať spoločnosť Leica Biosystems

18.2 Fyzické špecifikácie

	BOND-III	BOND-MAX
Rozmery	Š – 790 mm (31,10 palca) V – 1378 mm (54,25 palca) H – 826 mm (32,4 palca)	Š – 760 mm (29,9 palca) V – 703 mm (27,6 palca) H – 800 mm (31,49 palca)
Hmotnosť (suchá)	238 kg	120 kg
Požiadavky na vzdialenosť	600 mm (24 palcov) nad 0 mm vľavo 150 mm (6 palcov) vpravo 0 mm vzadu, používatelia však musia byť schopní odpojiť sieťový napájací kábel bez posunutia modulu spracovania.	
Maximálna vzdialenosť od vonkajšej nádoby na hromadný odpad (len systém BOND-MAX)	~	1 meter

18.3 Požiadavky na elektrické napájanie a zdroj UPS

	BOND-III	BOND-MAX
Prevádzkové napätie (pre moduly spracovania so starými napájacími zdrojmi s jedným ventilátorom na zadnom obale)	103,4 V až 127,2 V (pre menovité napätie 110 V až 120 V) alebo 206,8 V až 254 V (pre menovité napätie 220 V až 240 V)	
Prevádzkové napätie (pre moduly spracovania s novými napájacími zdrojmi s dvomi ventilátormi na zadnom obale)	90 V až 264 V (pre menovité napätie 100 V až 240 V)	
Sieťová frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Spotreba energie	1 200 VA	1 000 VA

18.4 Špecifikácie prostredia

	BOND-III	BOND-MAX
Maximálna prevádzková teplota	35°C	35°C

	BOND-III	BOND-MAX
Minimálna prevádzková teplota	5°C	5°C
Teplota potrebná na splnenie požiadaviek na farbenie	18 – 26°C	18 – 26°C
Prevádzková vlhkosť (bez kondenzácie)	30 až 80 % relatívna vlhkosť	30 až 80 % relatívna vlhkosť
Maximálna prevádzková nadmorská výška	0 až 1 600 m nad morom	0 až 1 600 m nad morom
Výstupná hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 1 m)	< 85 dBA maximálne < 65 dBA normálna prevádzka	< 85 dBA maximálne < 65 dBA normálna prevádzka
Maximálny tepelný výkon	1 200 VA	1 000 VA

18.5 Prevádzkové špecifikácie




	BOND-III	BOND-MAX
Kapacita sklíčok	30 súčasne. Hotové zásobníky (10 sklíčok) je možné priebežne vymieňať.	
Objem nádoby na reagentie	7ml a 30ml	7ml a 30ml
Mŕtvy objem nádoby na reagentie	555µl (7ml) a 1 618µl (30ml)	
Rezervný objem nádoby na reagentie	280µl (7ml) a 280µl (30ml)	
Objem titračnej nádoby	6 ml	6 ml
Mŕtvy objem titračnej nádoby	300 µl	300 µl
Rezervný objem titračnej nádoby	280 µl	280 µl
Počet nádob na reagentie	36	36
Kapacita nádoby na nebalené reagentie	2 l alebo 5 l	1 l alebo 2 l
Kapacita nádoby na nebezpečný odpad	5 l	2 l
Kapacita nádoby na štandardný odpad	2 x 5l	~
Vonkajšia kapacita nádoby na hromadný odpad	~	9 l
Chemická kompatibilita	Všetky reagentie BOND 70 % roztok etanolu (na čistenie)	
Indikácia teploty	Predvolené hodnoty (môžu byť zmenené zástupcami servisu): Teplé: 35 °C, horúce: 80 °C	

	BOND-III	BOND-MAX
Maximálny povolený tlak pre prípojky plynu a kvapaliny	1.0 bar	2.5 bar
Životnosť	7 rokov	7 rokov
BOND Skončenie platnosti certifikátu kybernetickej bezpečnosti	10 rokov	10 rokov

18.6 Mikroskopické sklíčka

Rozmery	Šírka: 24,64 – 26,0 mm (0,97 – 1,02 palca) Dĺžka: 74,9 – 76,0 mm (2,95 – 2,99 palca) Hrúbka: 0,8 – 1,3 mm (0,03 – 0,05 palca)
Oblasť štítkov	Šírka: 24,64 – 26,0 mm (0,97 – 1,02 palca) Dĺžka: 16,9 – 21,0 mm (0,67 – 0,83 palca)
Materiál	sklo, ISO 8037/1
Úžitková plocha	Pozrite si nasledujúce schémy. Dávkovací objem sa týka nastavení, ktoré môžete zvoliť pri nastavovaní sklíčok pomocou softvéru BOND (pozrite si časť 6.3 Práca s prípadmi).

Obrázok 18-1: Užitočné oblasti sklíčok pre moduly spracovania BOND

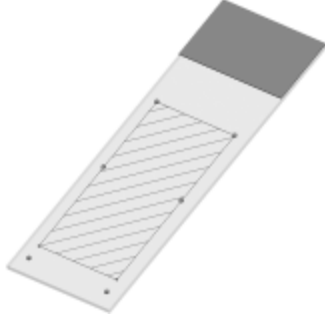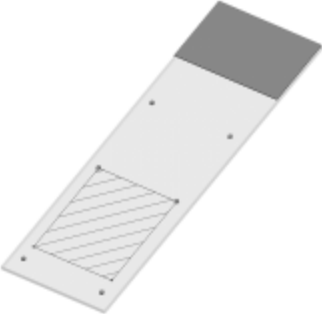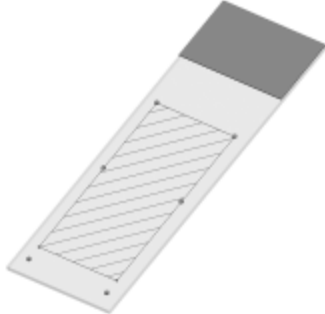	100µl	150µl
BOND-III		
BOND-MAX		

18.7 Doprava a skladovanie

Teplota skladovania	-20 až +55°C
Vlhkosť pri skladovaní (bez kondenzácie)	< 80 % relatívna vlhkosť
Spôsoby dopravy	Kompatibilné pre cestnú, leteckú a námornú dopravu.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené informácie sa týkajú iba zabalených modulov spracovania.

Informácie o rozbalených moduloch spracovania nájdete v časti [18.4 Špecifikácie prostredia](#).

Index

A

aktualizácia databázy	248
aktualizovať údaje z databázy	248
aktualizuje sa softvér	91
alarmy	86
architektúra systému BOND	74
automatická identifikácia sklíčok	123

B

balík integrácie LIS	274
chyby	280
konfigurácia v systéme BOND	239
licencia	240
názvy verejných značkovačov	278
prioritné sklíčka	278
prípady	276
pripojenie a inicializácia	279
sklíčka	277
stavový panel	276
štítky sklíčok	283
terminológia	275
Údaje o prípade a sklíčku	281
vlastnosti LIS	279
získať údaje LIS	279
bezpečnostné symboly	19
BOND	364
BOND-ADVANCE, opis	75
BOND Polymer Refine Detection System	331

C

CISPR 11 (EN 55011)	12
---------------------------	----

copyright	1
-----------------	---

Č

červená, zvýraznené na obrazovke zásob reagensí	213
červený, detekčný systém	332
čistenie	286
čistenie fluidiky, postup údržby	308
čítačka čiarových kódov, ručná opis	66
čítačka identifikátorov, ručná registrácia reagensí	216
čítačka, ručná opis	66
zaregistrovať detekčný systém	215

D

databáza	90
záloha	253
dátové polia sklíčka v LIS	240
dátové polia, sklíčka v LIS	240
dávkovania sondy	170
deaktivovať nádoby na nebalený materiál	257
denník, servisný	90
detekčné systémy BOND Polymer Refine	331
BOND Polymer Refine Red	332
BOND, prehľad	331
opis	71
registrácia	215
správa o zásobách	218
dohliadajúci, úloha používateľa nastavenie	237

opis	80
dokončenie cyklu	104
doplniť otvorenú nádobu	214
dôležité informácie pre všetkých používateľov	1
duplicitné kroky súvisiace s reagenciami (v protokole)	182
duplicitný identifikátor prípadu	
prípady BOND	143
prípady LIS	240

E

elektrické nebezpečenstvá	8
exportovať správy	87
exportovať údaje o sklíčku	233
exspirovaný prípad	143

F

farbenie	
interpretácia	343
FCC	11

H

heslo, BOND	238
história sklíčok	222
definovanie časového intervalu	225
obrazovka	222
horná doska, výmena	304

C

chyby ohrievača	110
-----------------------	-----

I

identifikácia produktu	1
identifikácia sklíčok	
automatická	123
manuálna v systéme	123
manuálne	153
identifikácia, produkt	1
identifikátor prípadu	
LIS, duplicitný	240
v. číslo prípadu	142
identifikátor sklíčka	158
identifikátor štítka	158
IEC 60417	15
IHC, princíp	330
improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu	160
Informácie o BOND, dialógové okno	89
injekčná striekačka	61
čistenie a údržba	317
ISH, princíp	331
ISO 15223-1	13
ISO 7000	15
ISO 7010	19

K

karty, modul spracovania, na stavovej obrazovke	
systému	108
klasifikácia zariadení	12
klient správy	236
kompatibilita	
nebalené reagenty s pomocnými reagentami	207
sklíčka	164
konfigurácia hardvéru	255
konfigurácia laboratória	250

konfigurovať systém BOND	236
kontrola kvality	337
výhody	342
kontrolné vzorky	
negatívna reagentia pre IHC	340
práca s	139
reagentia pre ISH	341
tkanivo	339
kroky súvisiace s reagentami (v protokole)	
duplikácia	182
krycie sklíčka Covertile	69
čistenie a údržba	300
kryty	
čistenie	312

L

licencia, LIS-ip	240
LLS (snímanie hladiny kvapaliny)	211

M

Maintenance report (Správa o údržbe)	135
Manažér systému BOND	347
manuálna identifikácia sklíčok	153
mechanické nebezpečenstvá	7
metódy farbenia	168
modul spracovania	
čistenie a údržba	286
doprava a skladovanie	368
inicializácia	44
karty	108
konfigurácia	255
opis	39
reštartovať	308
stavy	109

technické údaje	365
montáž s jednou stanicou	74
montáž s viacerými stanicami	74-75
možnosť celodenného prípadu	146
mŕtvy objem	57
multiplexové farbenie	168

N

nádoba na odpad	
čistenie a údržba	298
opis	72
stav	116
nádoby na nebalený materiál	50
čistenie a údržba	291
deaktivácia	257
stav	116
nahradenie reagentií	202
nasávací sonda	
čistenie	309
opis	57
nastavenie	
reagentie	100
sklíčka	94
nastavenie minimálnych zásob	213
názvy verejných značkovačov	278
nebezpečenstvá	
elektrické	8
inštalácia	9
prevádzka	9
prevádzka prístroja	5
reagentia	9
nebezpečenstvá pri inštalácii	9
nebezpečenstvá pri montáži a preprave	9
nebezpečenstvá súvisiace s prevádzkou prístroja	5

nebezpečenstvo	
elektrické	8
chemické	6
mechanické	7
montáž a preprava	9
prevádzka	9
nebezpečenstvo súvisiace s reagentami	9
nebezpečný odpad	208
nekompatibilné sklíčka	122

O

objem dávkovania	154
obnoviť	
prípád BOND	143
prípád LIS	240
obnoviť databázu	253
obráťte sa na spoločnosť Leica Biosystems	3
Obrazovka údržby	133
obrazovka zásob, reagentí	209
odkvapkávacie podnosy	313
nádobu na nebalený materiál	313
podnos modulu spracovania	315
odložený štart	131
odvokovanie	157, 336
ohrievače	46
ochranné známky	1
operátor, úloha používateľa	
nastavenie	237
opis	80
otvorené nádoby	71
doplniť	214
overenie testu	338
ovládací panel	84
ovládač systému BOND	74

Označenie CE	11
oznámenia	86

P

panel	
obrazovka	220
pridávanie	153
úprava	221
vytvoriť	220
panel funkcií	81
paralelné multiplexové farbenie	168
PDF, správy	87
plán	
čistenie a údržba	287
plán čistenia	287
plán údržby	287
podnosy na reagentie	
opis	70
podnosy na sklíčka	70
poistky	321
poistky napájania	321
pokyny pre diagnostické vybavenie in vitro na profesionálne použitie	11
Pomocník	88
hodnotenie	31
potrebné materiály	334
používateľ, úloha	80
nastavenie	237
používateľa, vytvoriť a upraviť	237
používateľské meno	238
pracovná bunka	75
pracovný postup	
improvizované sklíčko a vytvorenie prípadu	160
možnosť celodenného prípadu	146

právne vyhlásenia	1
prázdne, označiť balenie reagentie ako	214
predný kryt	47
predvolené nastavenia prípadu a sklíčka	252
premyvacie blok	58
prevádzka modulu spracovania	5
prevádzkové nebezpečenstvá	9
preventívna údržba	286
pridávanie	
panel	153
prípád	142
reagencia	206
sklíčko	149
prioritné sklíčka, LIS	278
prípady	
duplikácia	143
exspirácia	143-144
identifikácia	142
improvizované vytváranie	160
kopírovanie	145
LIS (laboratórny informačný systém)	276
obnovenie	143
predvolené nastavenia	252
pridávanie	142
úprava	144
vymazávanie	145
zadávanie detailov, rýchly štart	95
príprava tkaniva	336
protokol	167
dokončenie cyklu	104
farbenie	195
import	190
obrazovka nastavenia	167
prebiehajúce	103
predbežné farbenie	197
príprava	197
segment reagentie, opis	177

správy	194
spustenie prehľadu	33
stavová obrazovka	132
úprava	177, 248
úprava pre multiplexové farbenie	171
zobrazovanie	174
zoznam	172, 239
zoznam vopred definovaných protokolov	195
prvé kroky	32

R

reagencia	198
doplniť otvorenú nádobu	214
identifikácia	201
manuálna identifikácia	217
náhrada	202
obrazovka nastavenia	204
obrazovka panelov	220
obrazovka zásob	209
prázdne balenie	214
pridávanie/úprava	206
registrácia	215
riešenie problémov	114
správa	198
správa o použití	219
správa o zásobách	218
stanovenie objemu	211
vkladanie	100
vymazávanie	208
registrácia reagentií a detekčných systémov	215
regulačné symboly	13
regulačné vyhlásenia	11
režim farbenia	149, 168
riadiace zariadenie, pozrite si BOND riadiace zariadenie	74
robot	
čistenie a údržba hlavného robota	312

hlavný robot a snímač identifikátorov	45
nebalená tekutina	59
vodiaca koľajnica na nebalenú tekutinu	59
robot na nebalenú tekutinu, opis	59
rozloženie, štítok	241
ručná čítačka čiarových kódov	
opis	66
zaregistrovať detekčný systém	215
ručná čítačka čiarových kódov, pozrite si časť Ručná čítačka čiarových kódov	215
Rýchly štart	92

S

segment reagentie	
opis	177
úprava	179
segment, reagentia	
úprava	179
segment, reagentia v protokole, opis	177
sekvenčné multiplexové farbenie	168
servisný denník	90
sklenené sklíčka	
technické údaje	367
sklíčka, sklenené, typy a rozmery	68
sklíčko	
automatická identifikácia	123
exportovať údaje	233
identifikácia, manuálna	153
identifikácia, manuálna v systéme	123
improvizované vytváranie	160
kompatibilita	164
kopírovanie	152
nastavenie	147
nastavenie, prehľad	137
nastavenie, rýchly štart	94

nekompatibilné	122
oblasť použitia	154
obrazovka nastavenia	138
odvoskovanie sklíčok	157
predvolené nastavenia	252
pridávanie	149
správy o nastavení	159
stav po zobrazovaní	120
úprava	152
vkladanie	99
vymazávanie	152
zadávanie detailov, rýchly štart	96
slovník symbolov	13
Snímač identifikátorov	45
čistenie a údržba	312
softvér	
aktualizácie	91
prehľad	73
spúšťanie	77
vypínanie	77
sondy na nebalenú tekutinu	
čistenie	316
správca, úloha používateľa	
nastavenie	237
opis	80
správy	87
detaily cyklu	228
exportovať sklíčka	233
nastavenie sklíčka	159
použitie reagentie	219
prípady	230
protokol	194
stručná história sklíčok	235
systém	90
udalosti cyklu	227
zhrnutie spracovania sklíčka	232
spustenie a vypnutie softvéru	77

spustenie cyklu	130
odložený štart	131
spustenie protokolu, stručný prehľad	33
spustenie systému	
kontroly	93
staré správy	87
stav hardvéru	109
stav reagentie	111
stavové obrazovky	106
LIS (laboratórny informačný systém)	276
nádoby na nebalený materiál	116
protokol	132
stav hardvéru	109
stav reagentie	111
stav sklíčka	120
systém	107
súbor	
opis	74-75
správa	258
symboly	
bezpečnosť	19
symboly a označenia	17
systém	
architektúra	74
opis	37
správa	90
stavová obrazovka	107
technické údaje	364
systém BOND	37
systém BOND Aspirating Probe Cleaning System	309
Systém osvetlenia nádob na nebalený materiál	53

Š

šablóna, štítok	241
štítky sklíčok, pozrieť štítok	155

štítok	
a LIS[[štítok	
LIS]	283
konfigurácia	241
prehľad	155
Rýchly štart	98
tlač	156
typy informácií	246

T

tabuľky, zoradenie	83
technické údaje	
modul spracovania	365
sklenené sklíčka	367
teploty, indikácia	111
terminály	74
testovanie namočením	211
titračná súprava	335
titračné nádoby	71
tlačiareň	
značkovač sklíčok	67
transport	368
typ dávkovania	194

U

údržba	286
údržba, preventívna	286
úloha používateľa	80
nastavenie	237
UPI (jedinečný identifikátor balenia)	201
upozornenia	8
úroveň prístupu, pozrite si úlohy používateľa	80, 237

V

veko	44
čistenie	312
vkladanie sklíčok	99
vyhlásenie o plánovanom použití	11
vymazávanie	
prípád	145
reagencia	208
sklíčko	152
súbor	259
Výmena tlačiarne Cognitive Cxi systému	358-359
Výmena tlačiarne Zebra systému	363
vypínač	62
výrobca	1
výstrahy	5, 86
vytlačiť správy	87
vytlačiť štítky sklíčok	156

Z

zadný obal, opis	63
zahrievanie	336
zálohovať databázu	253
zariadenie, nastavenie	251
zastavenie cyklu	130
záznam revízie	4
záznam z auditu	250
zhrnutie spracovania sklíčka	232
získavanie	337
získavanie epitopov	157
zmiešavacia stanica	58
značkovač sklíčok	67
čistenie a údržba	317

zostava na farbenie sklíčok	46
čistenie a údržba	301
indikácia teploty	111
manuálne odistenie	304
ohrievače	46, 110
stavy	108
zoznam lekárov	147

Ž

životnosť spracovaného prípadu	144
životnosť, prípad	144